SIS Radiance: 742.00000 nm, Collect 2
SIS Radiance
Measurements
0.1220
0.1218
0.1216
0.1214
0.1212
0.1210
0.1208
0.1206
0.1204
0
5
10
15
20
25
Monitor 1
Monitor 2
Average

SIS Radiance: 742.00000 nm, Collect 5
SIS Radiance
Measurements
0.1225
0.1220
0.1215
0.1210
0
5
10
15
20
25
Monitor 1
Monitor 2
Average

SIS Radiance Standard Deviation: 742.00000 nm
SIS Radiance Standard Deviation
4.0×10⁻⁴
3.5×10⁻⁴
3.0×10⁻⁴
2.5×10⁻⁴
2.0×10⁻⁴
1.5×10⁻⁴
0
2
4
6
8
Collects
Monitor 1
Monitor 2
Average

Collimator Irradiance: 742.00000 nm, Collect 1
Irradiance
Measurements
5.12
5.10
5.08
5.06
5.04
0
5
10
15
20
25

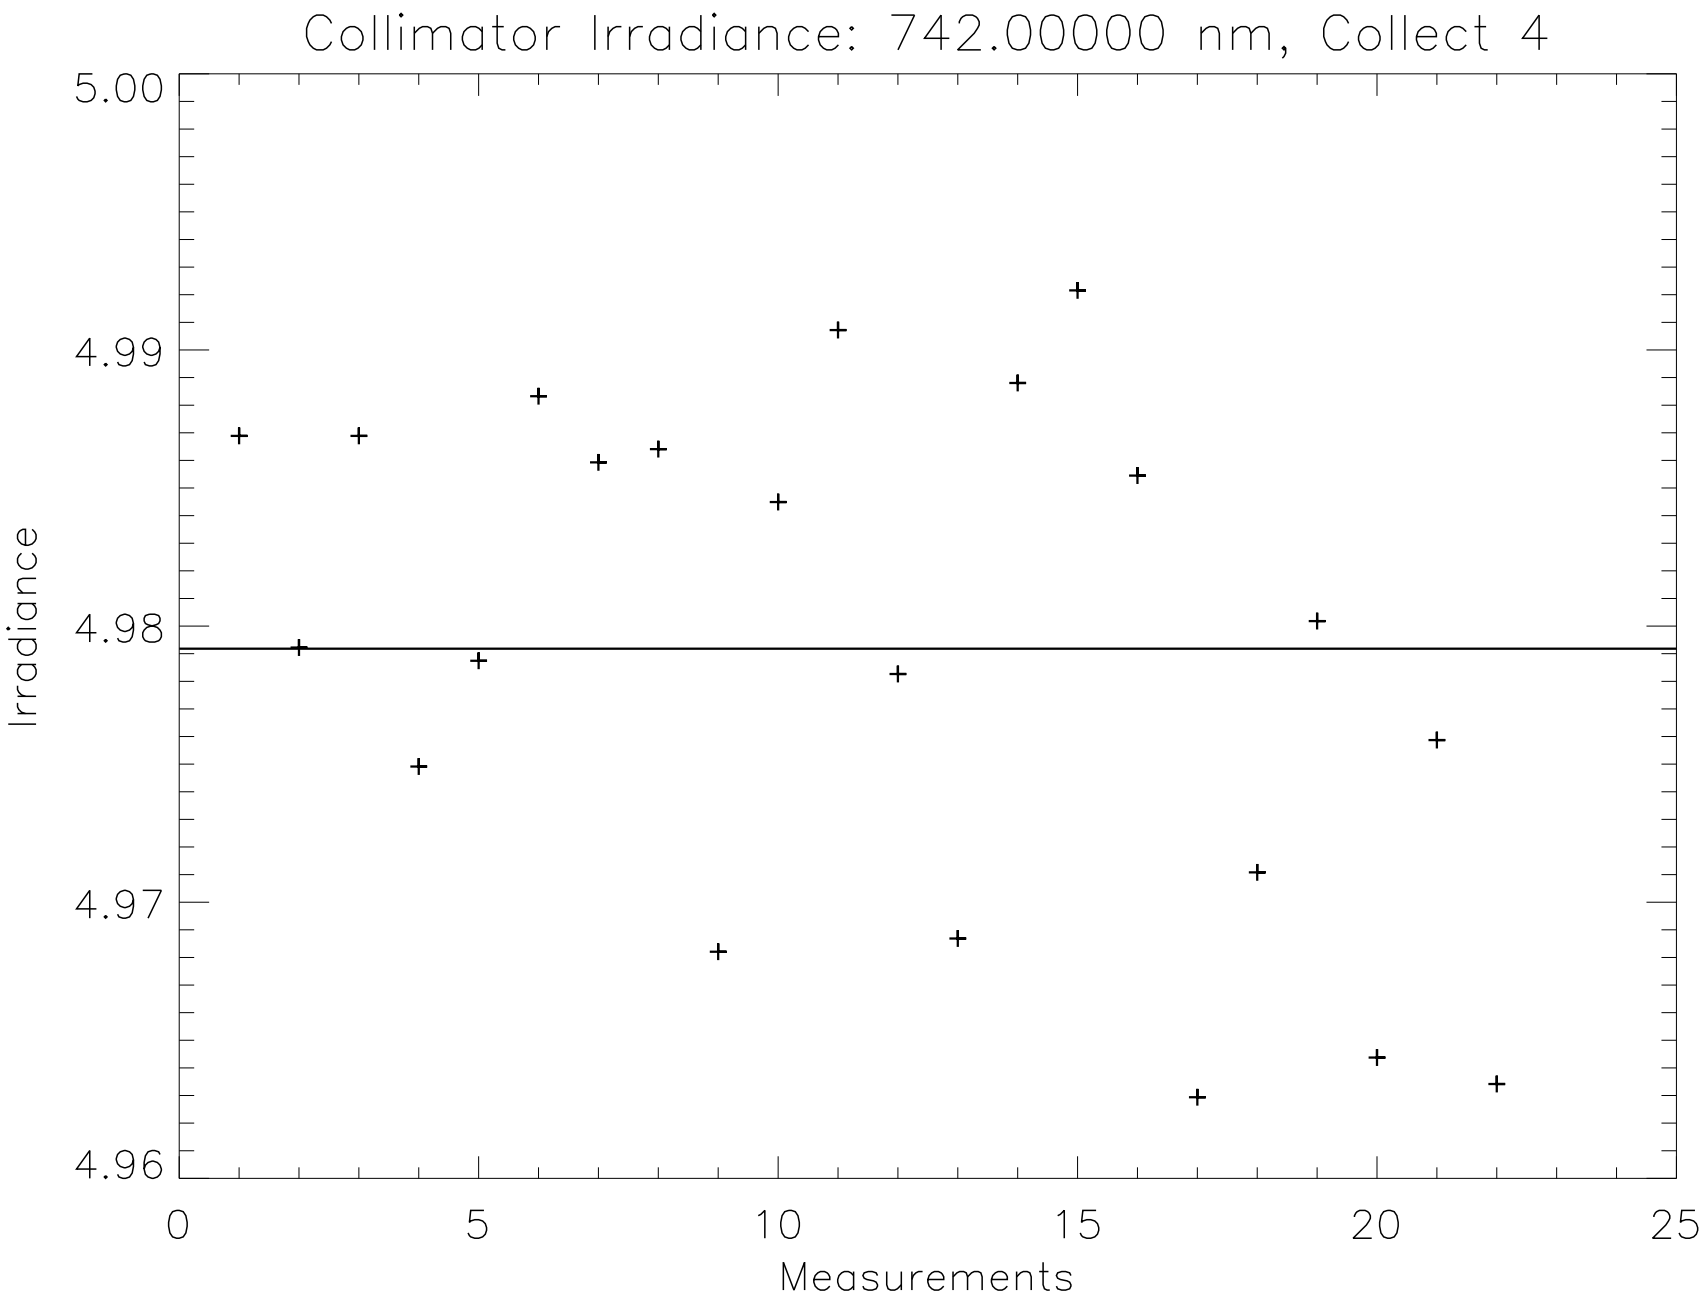
Collimator Irradiance: 742.00000 nm, Collect 4
5.00
4.99
4.98
4.97
4.96
Irradiance
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance Standard Deviation: 742.00000 nm
Irradiance Standard Deviation
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0
2
4
6
8
Collects