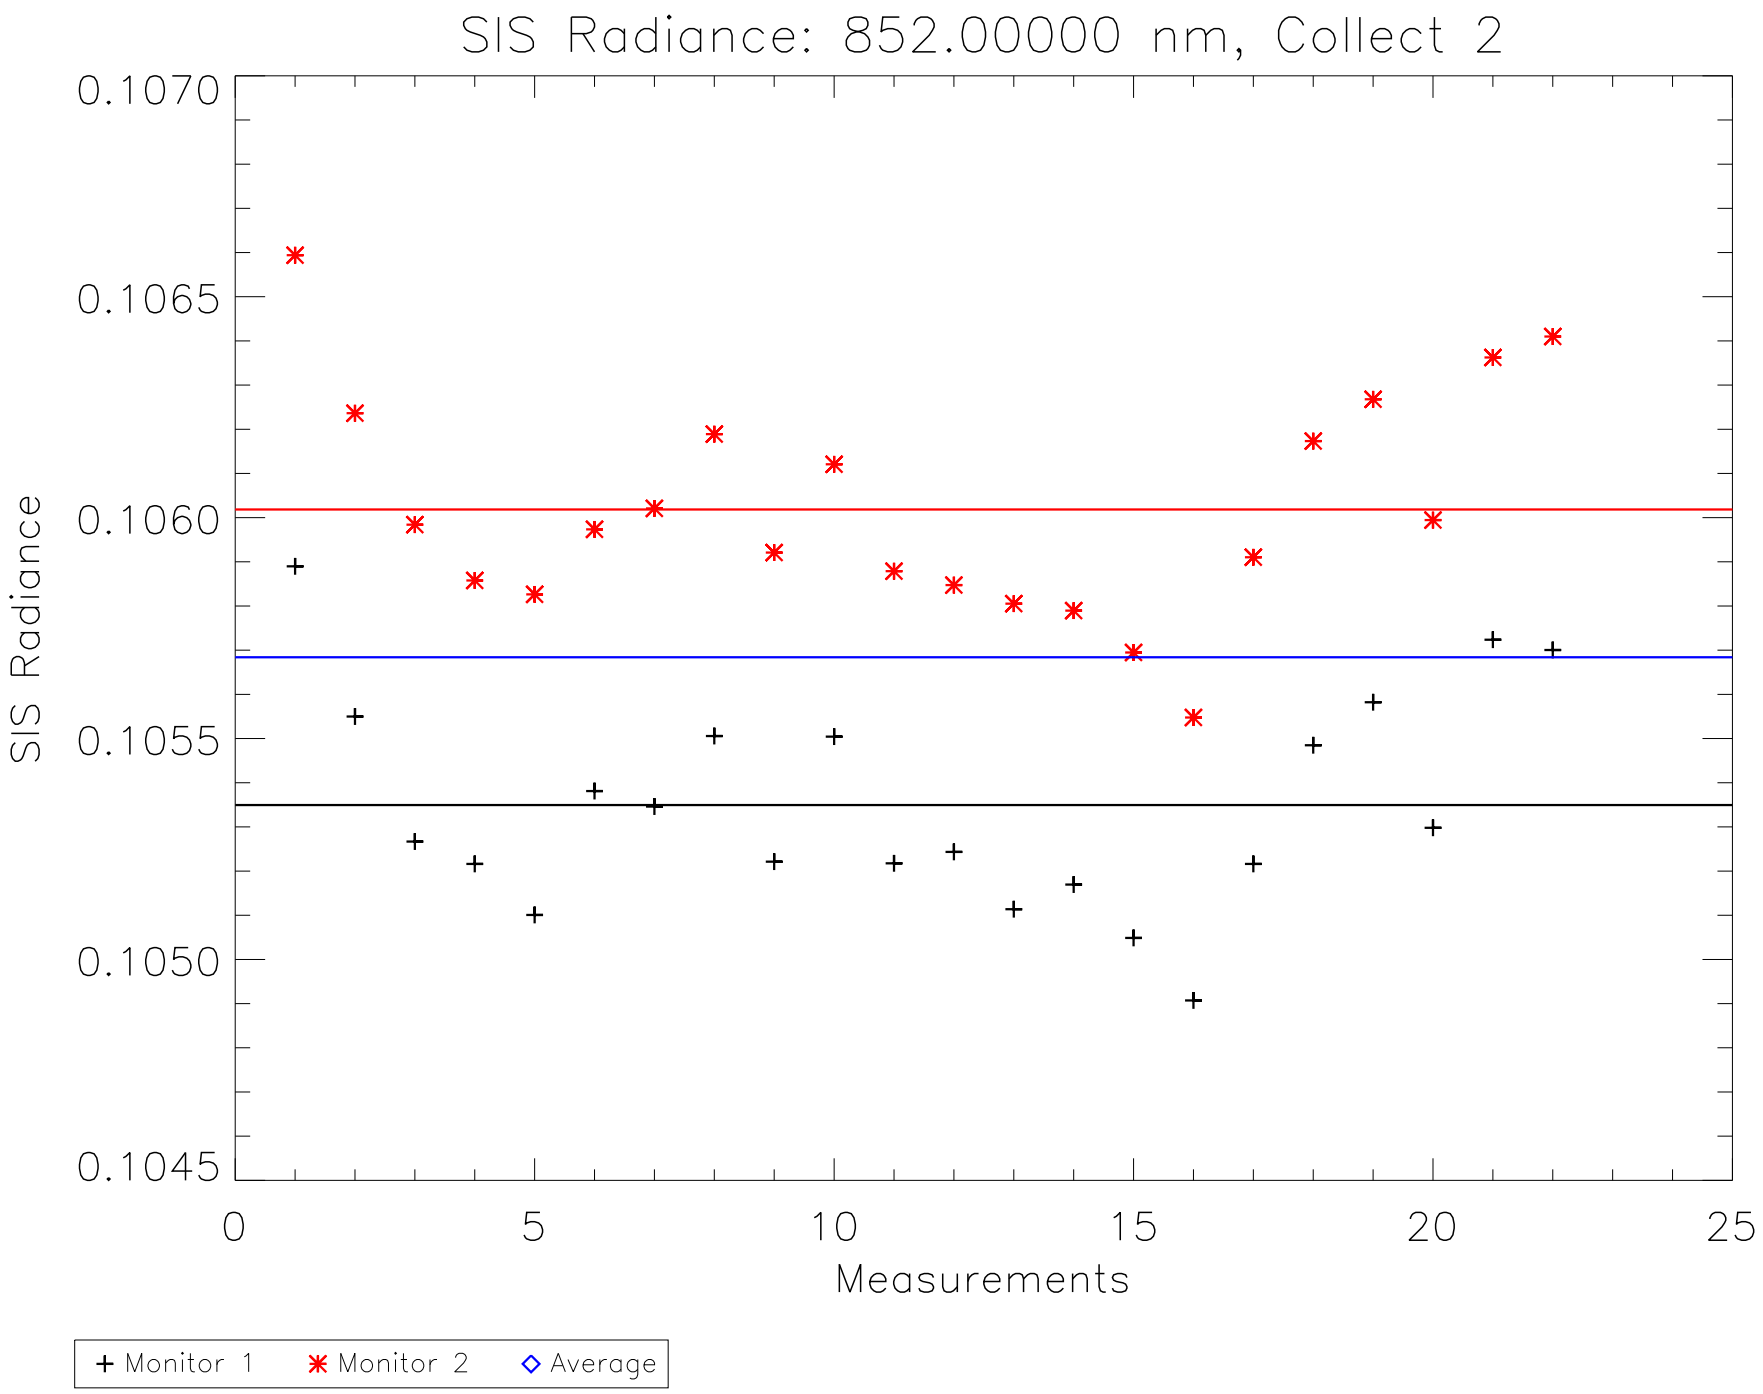
SIS Radiance: 852.00000 nm, Collect 2
SIS Radiance
0.1070
0.1065
0.1060
0.1055
0.1050
0.1045
0
5
10
15
20
25
Measurements
Monitor 1
Monitor 2
Average

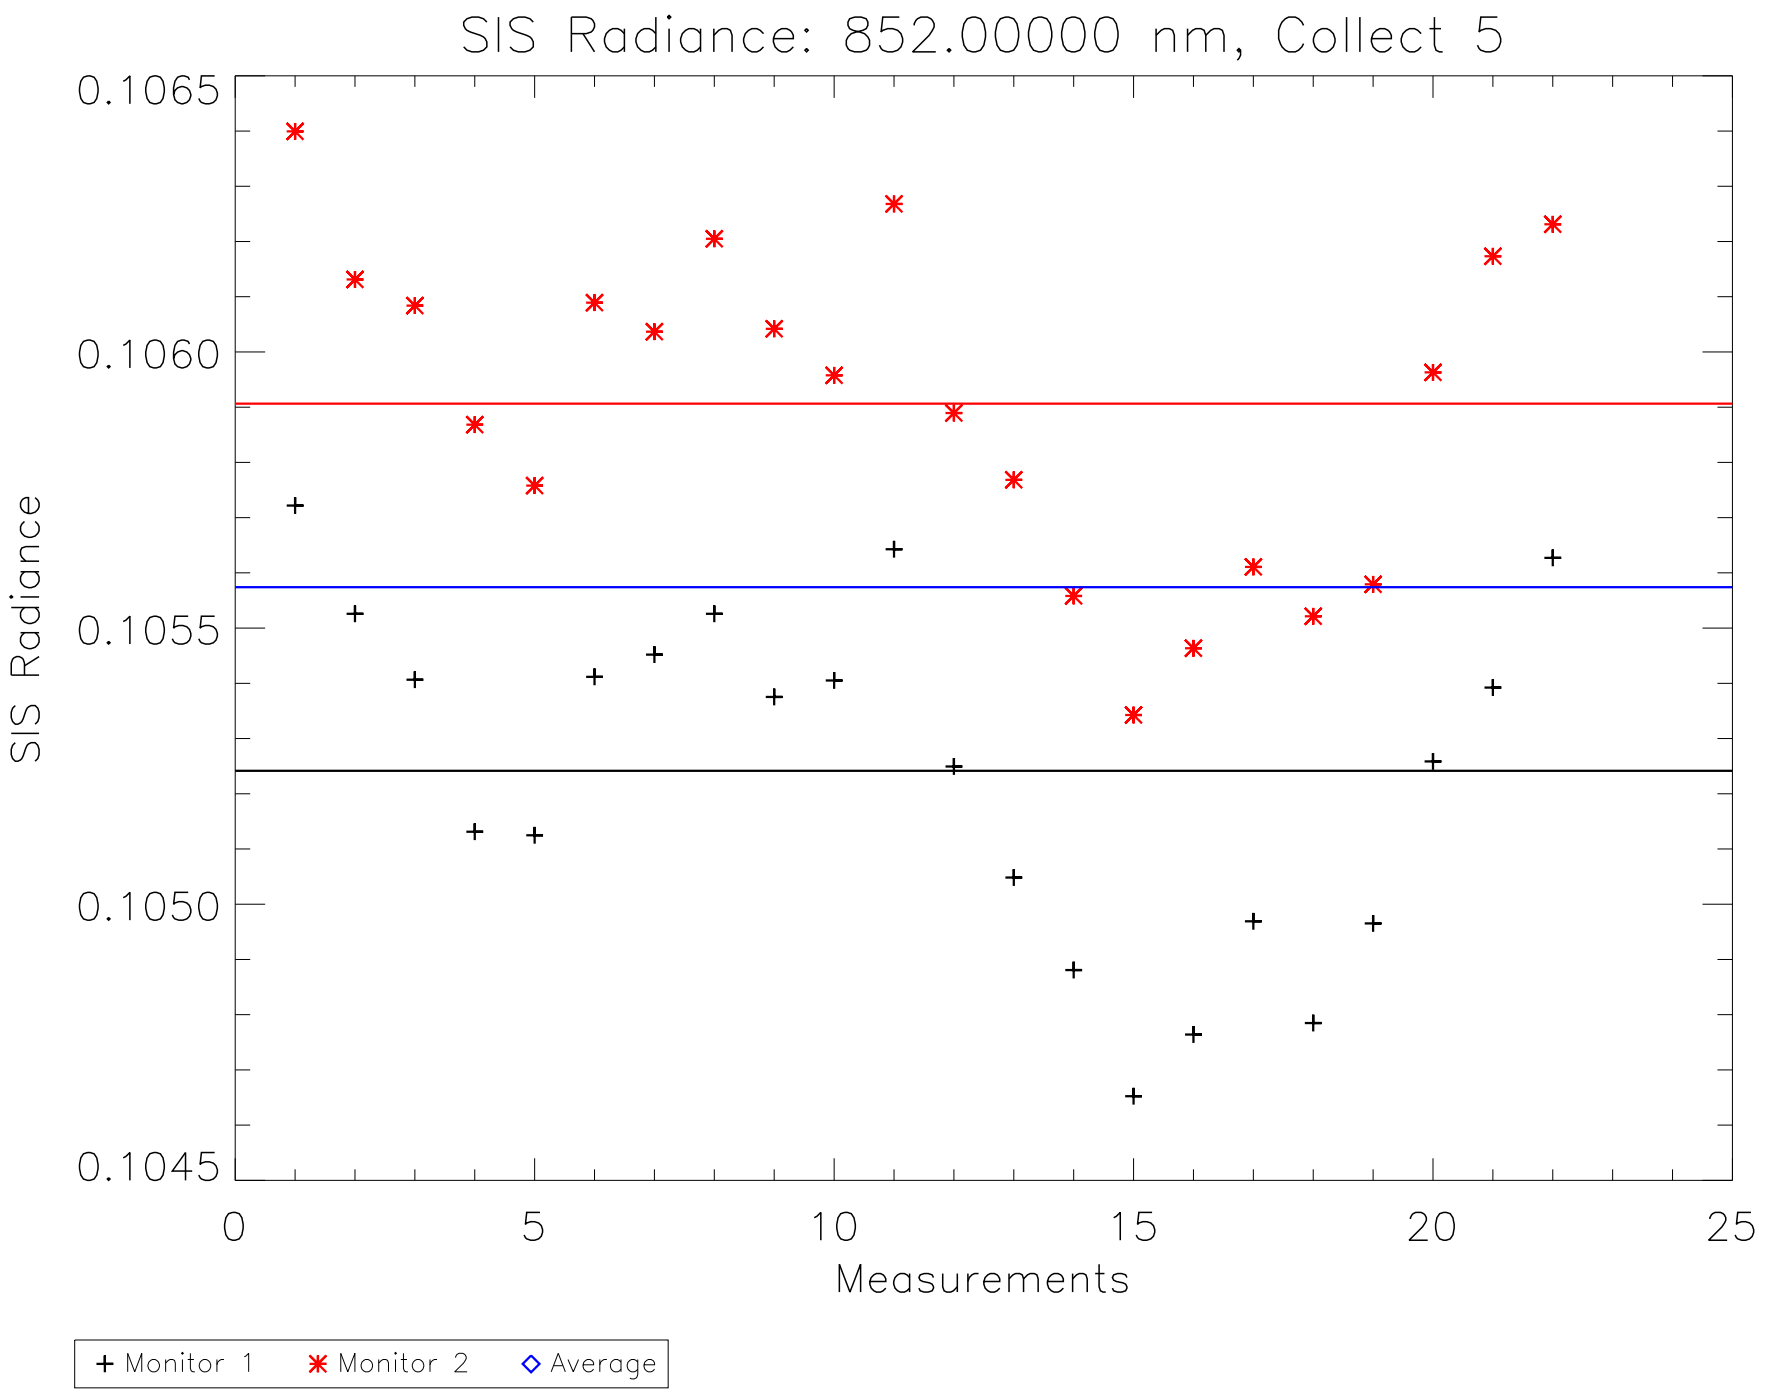
SIS Radiance: 852.00000 nm, Collect 5
SIS Radiance
0.1065
0.1060
0.1055
0.1050
0.1045
0
5
10
15
20
25
Measurements
Monitor 1
Monitor 2
Average

SIS Radiance Standard Deviation: 852.00000 nm

SIS Radiance Standard Deviation

4.5×10^{-4}
4.0×10^{-4}
3.5×10^{-4}
3.0×10^{-4}
2.5×10^{-4}
2.0×10^{-4}

0 2 4 6 8

Collects

+ Monitor 1 * Monitor 2 ◇ Average

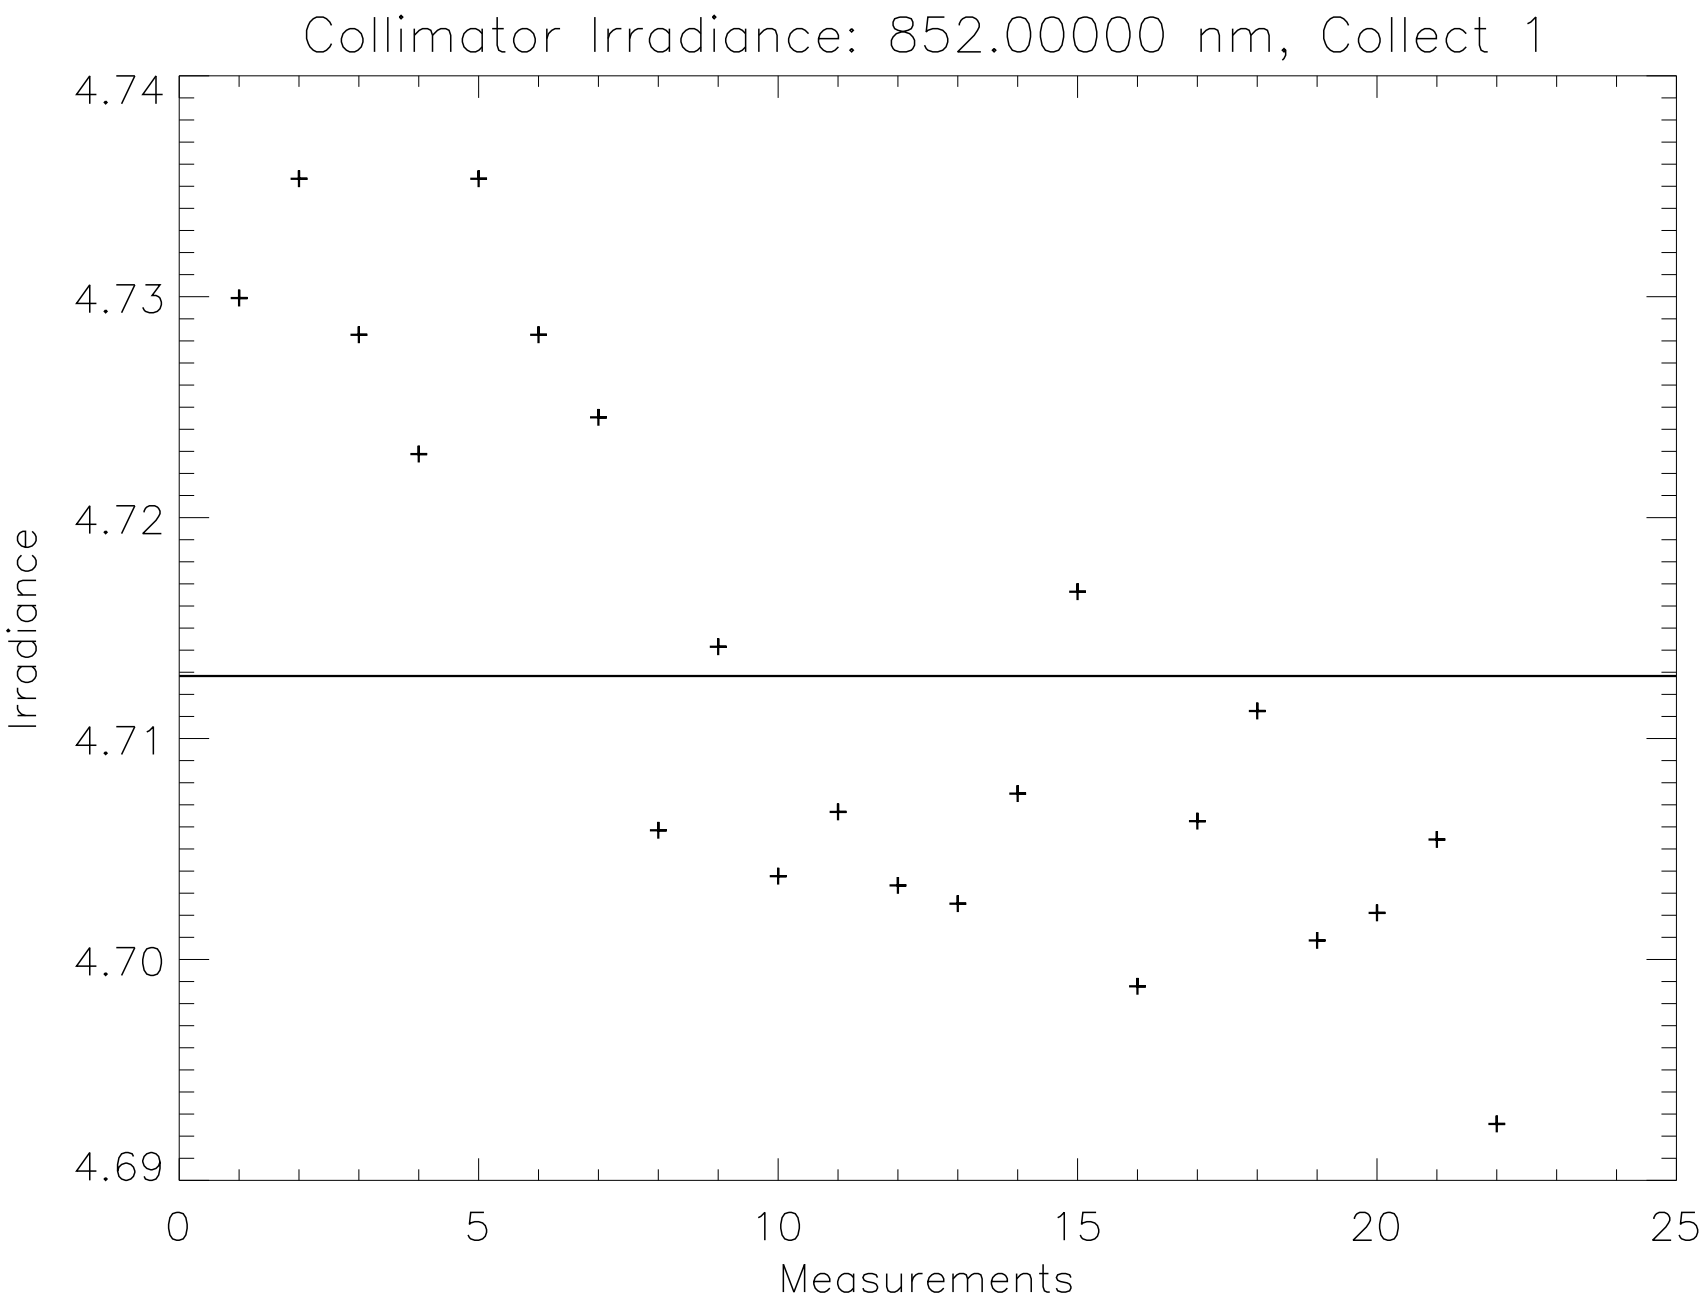
Collimator Irradiance: 852.00000 nm, Collect 1
Irradiance
4.74
4.73
4.72
4.71
4.70
4.69
0
5
10
15
20
25
Measurements

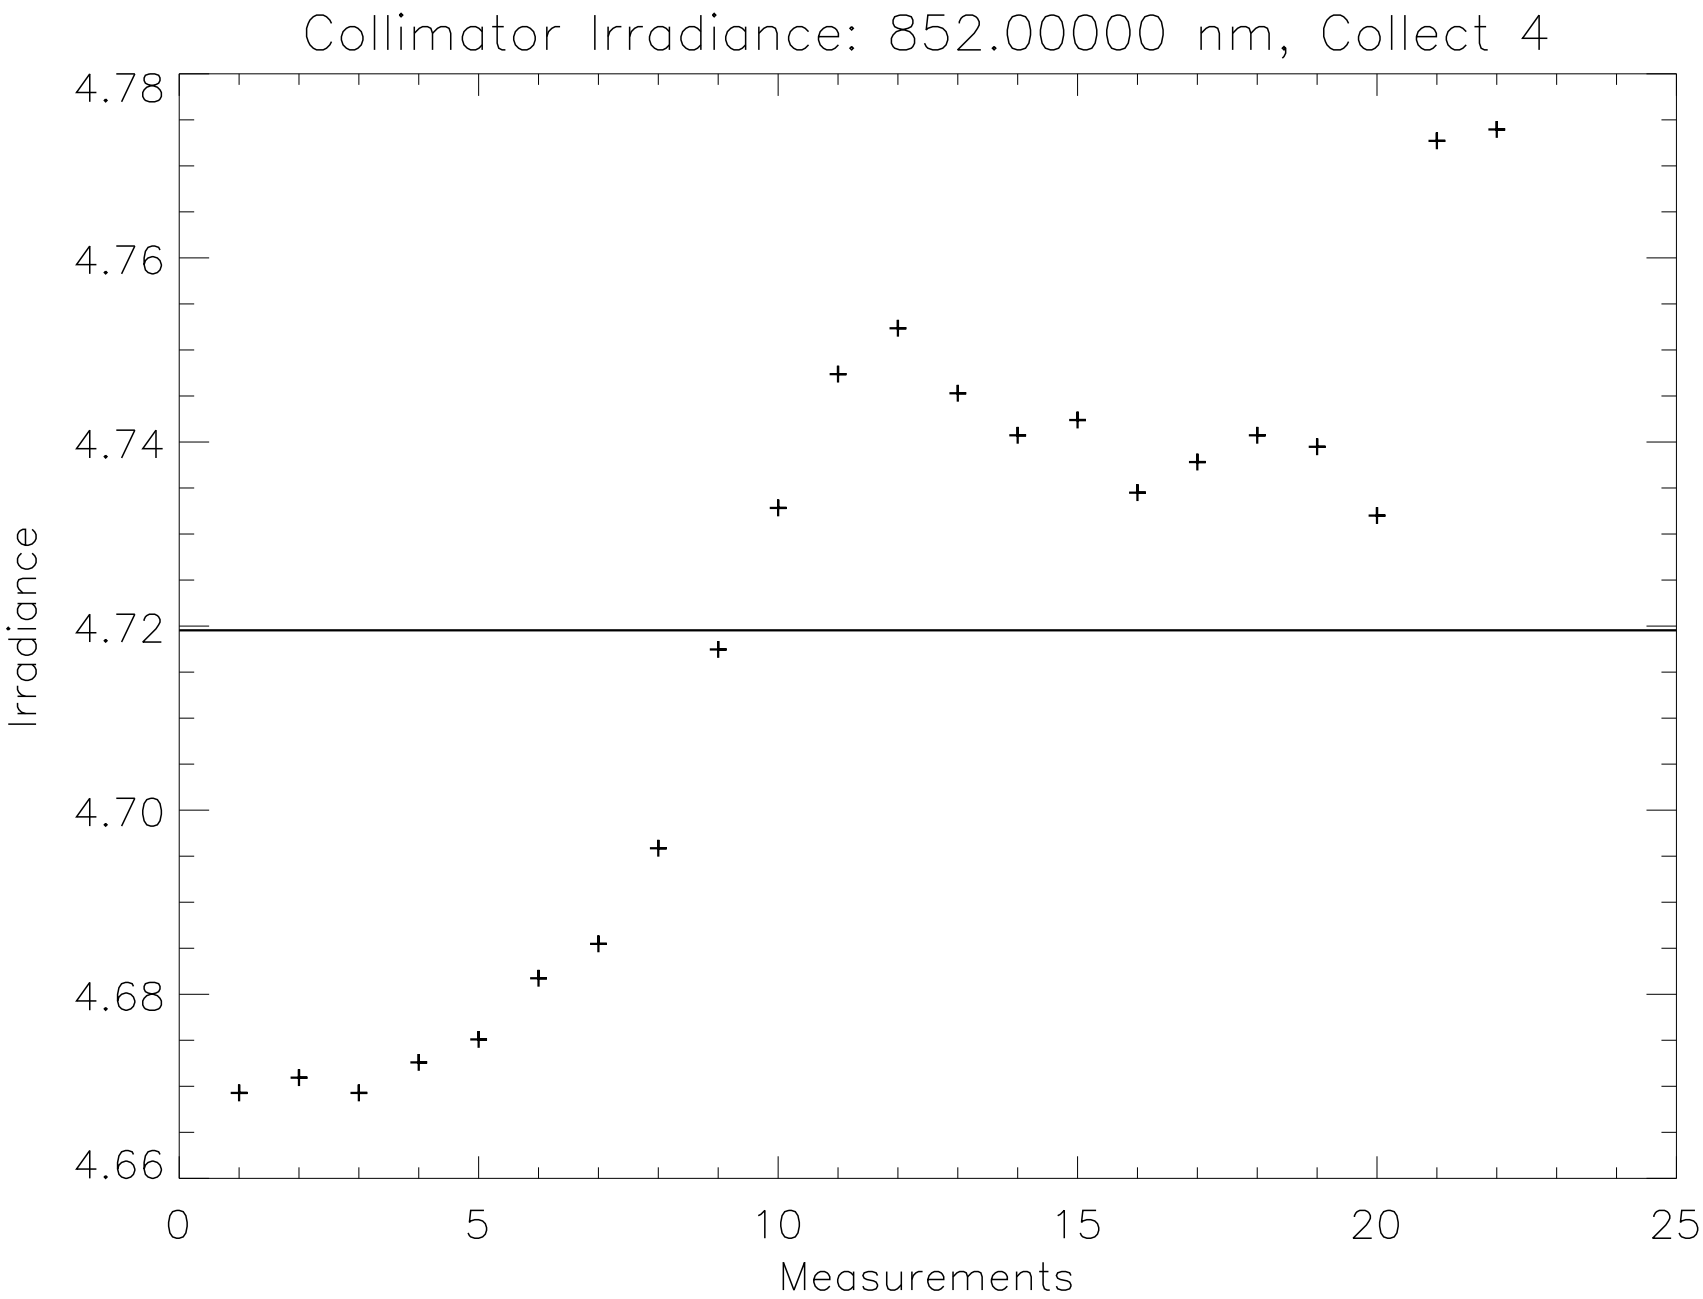
Collimator Irradiance: 852.00000 nm, Collect 4
Irradiance
4.78
4.76
4.74
4.72
4.70
4.68
4.66
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance Standard Deviation: 852.00000 nm
Irradiance Standard Deviation
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0
2
4
6
8
Collects