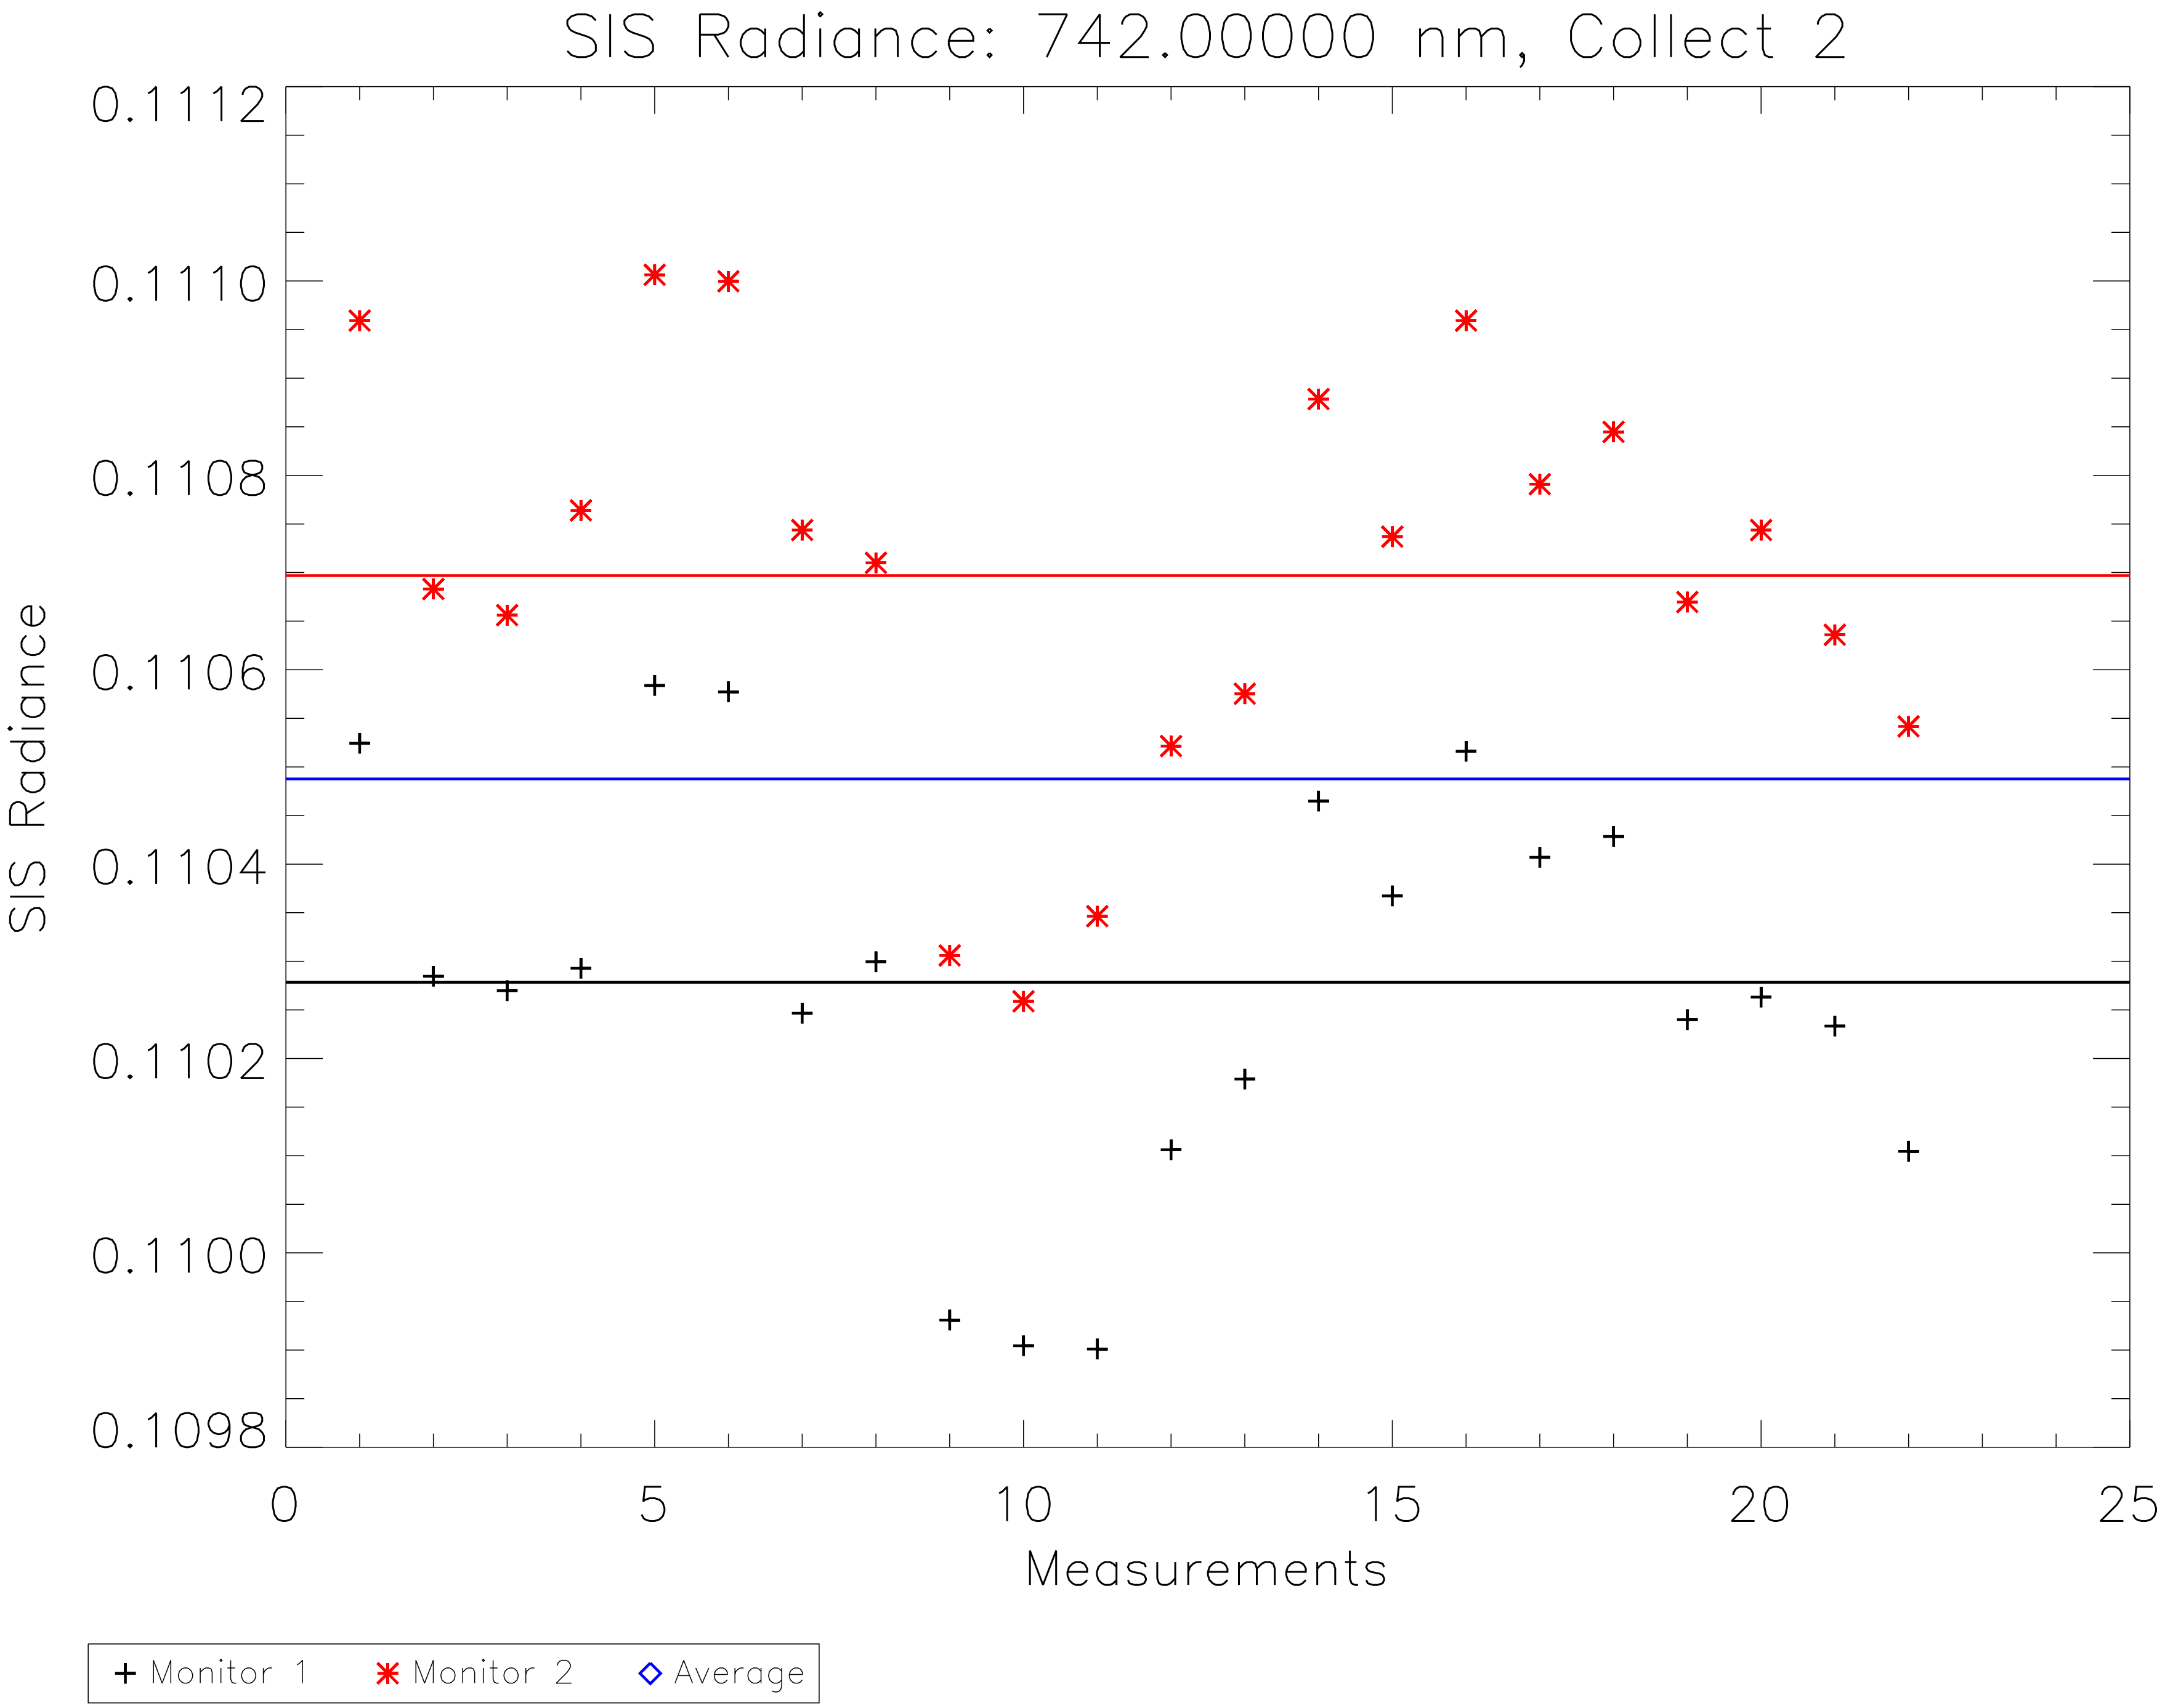

SIS Radiance: 742.00000 nm, Collect 2

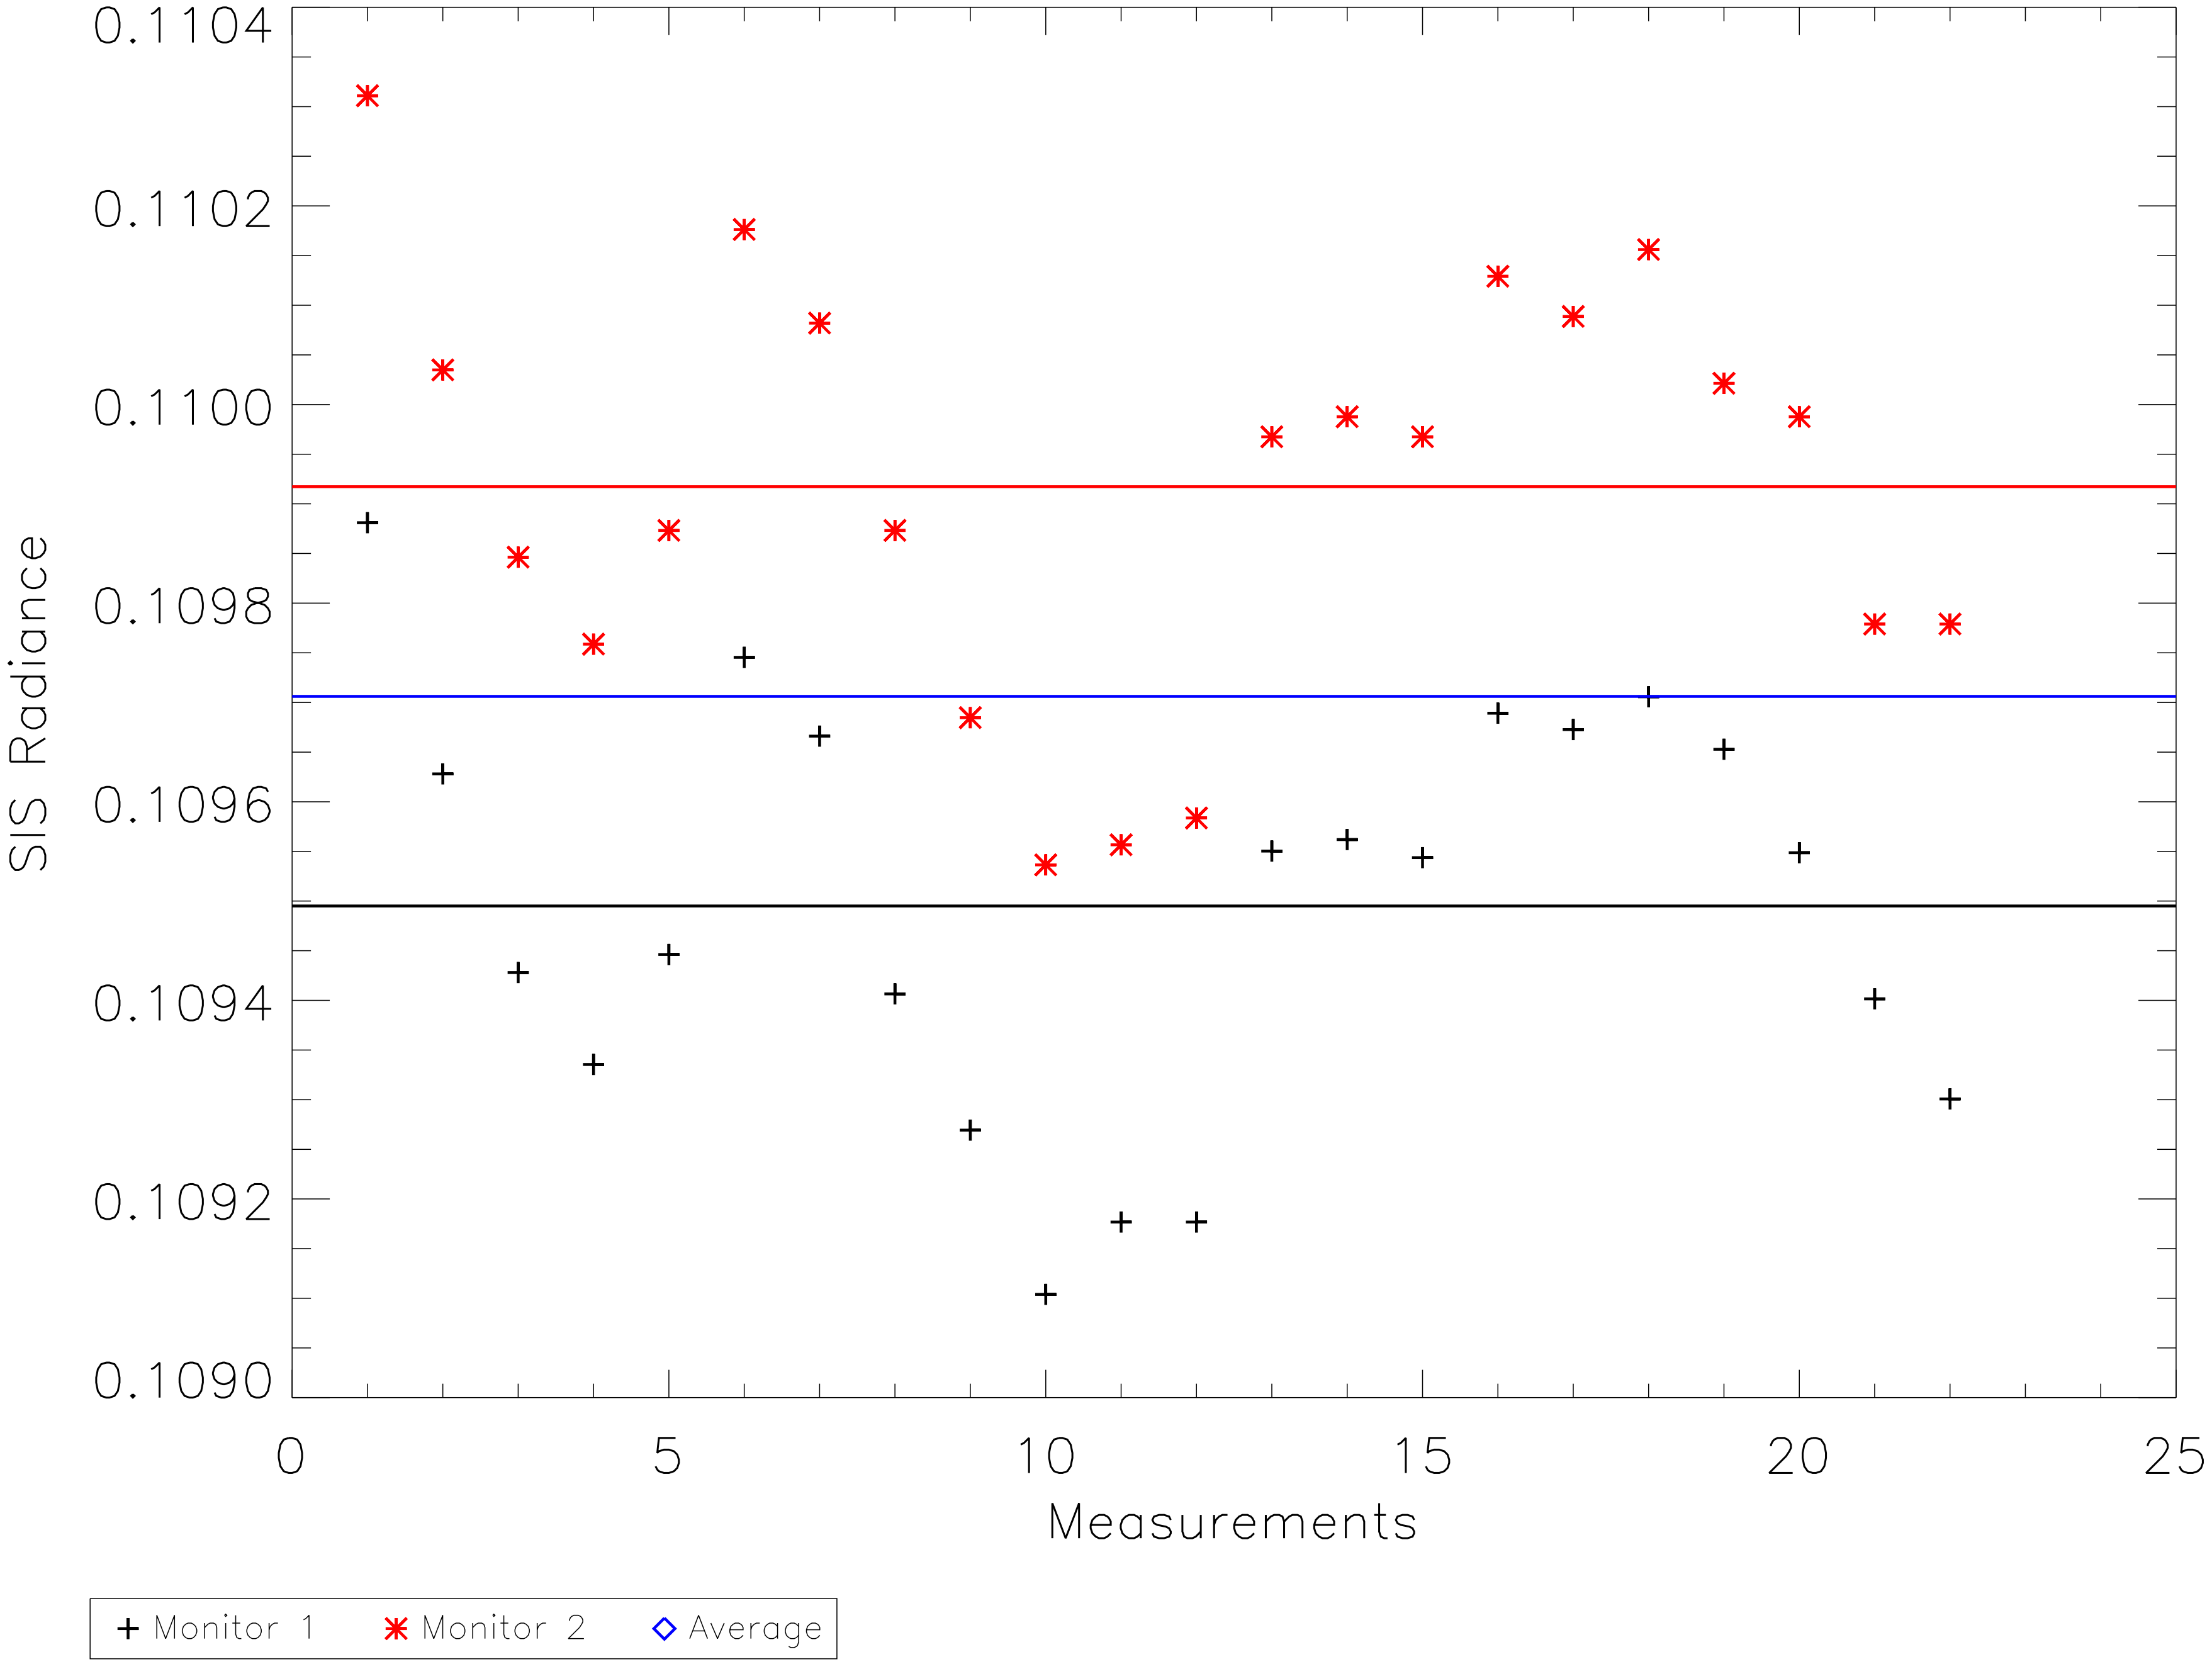
SIS Radiance: 742.00000 nm, Collect 5

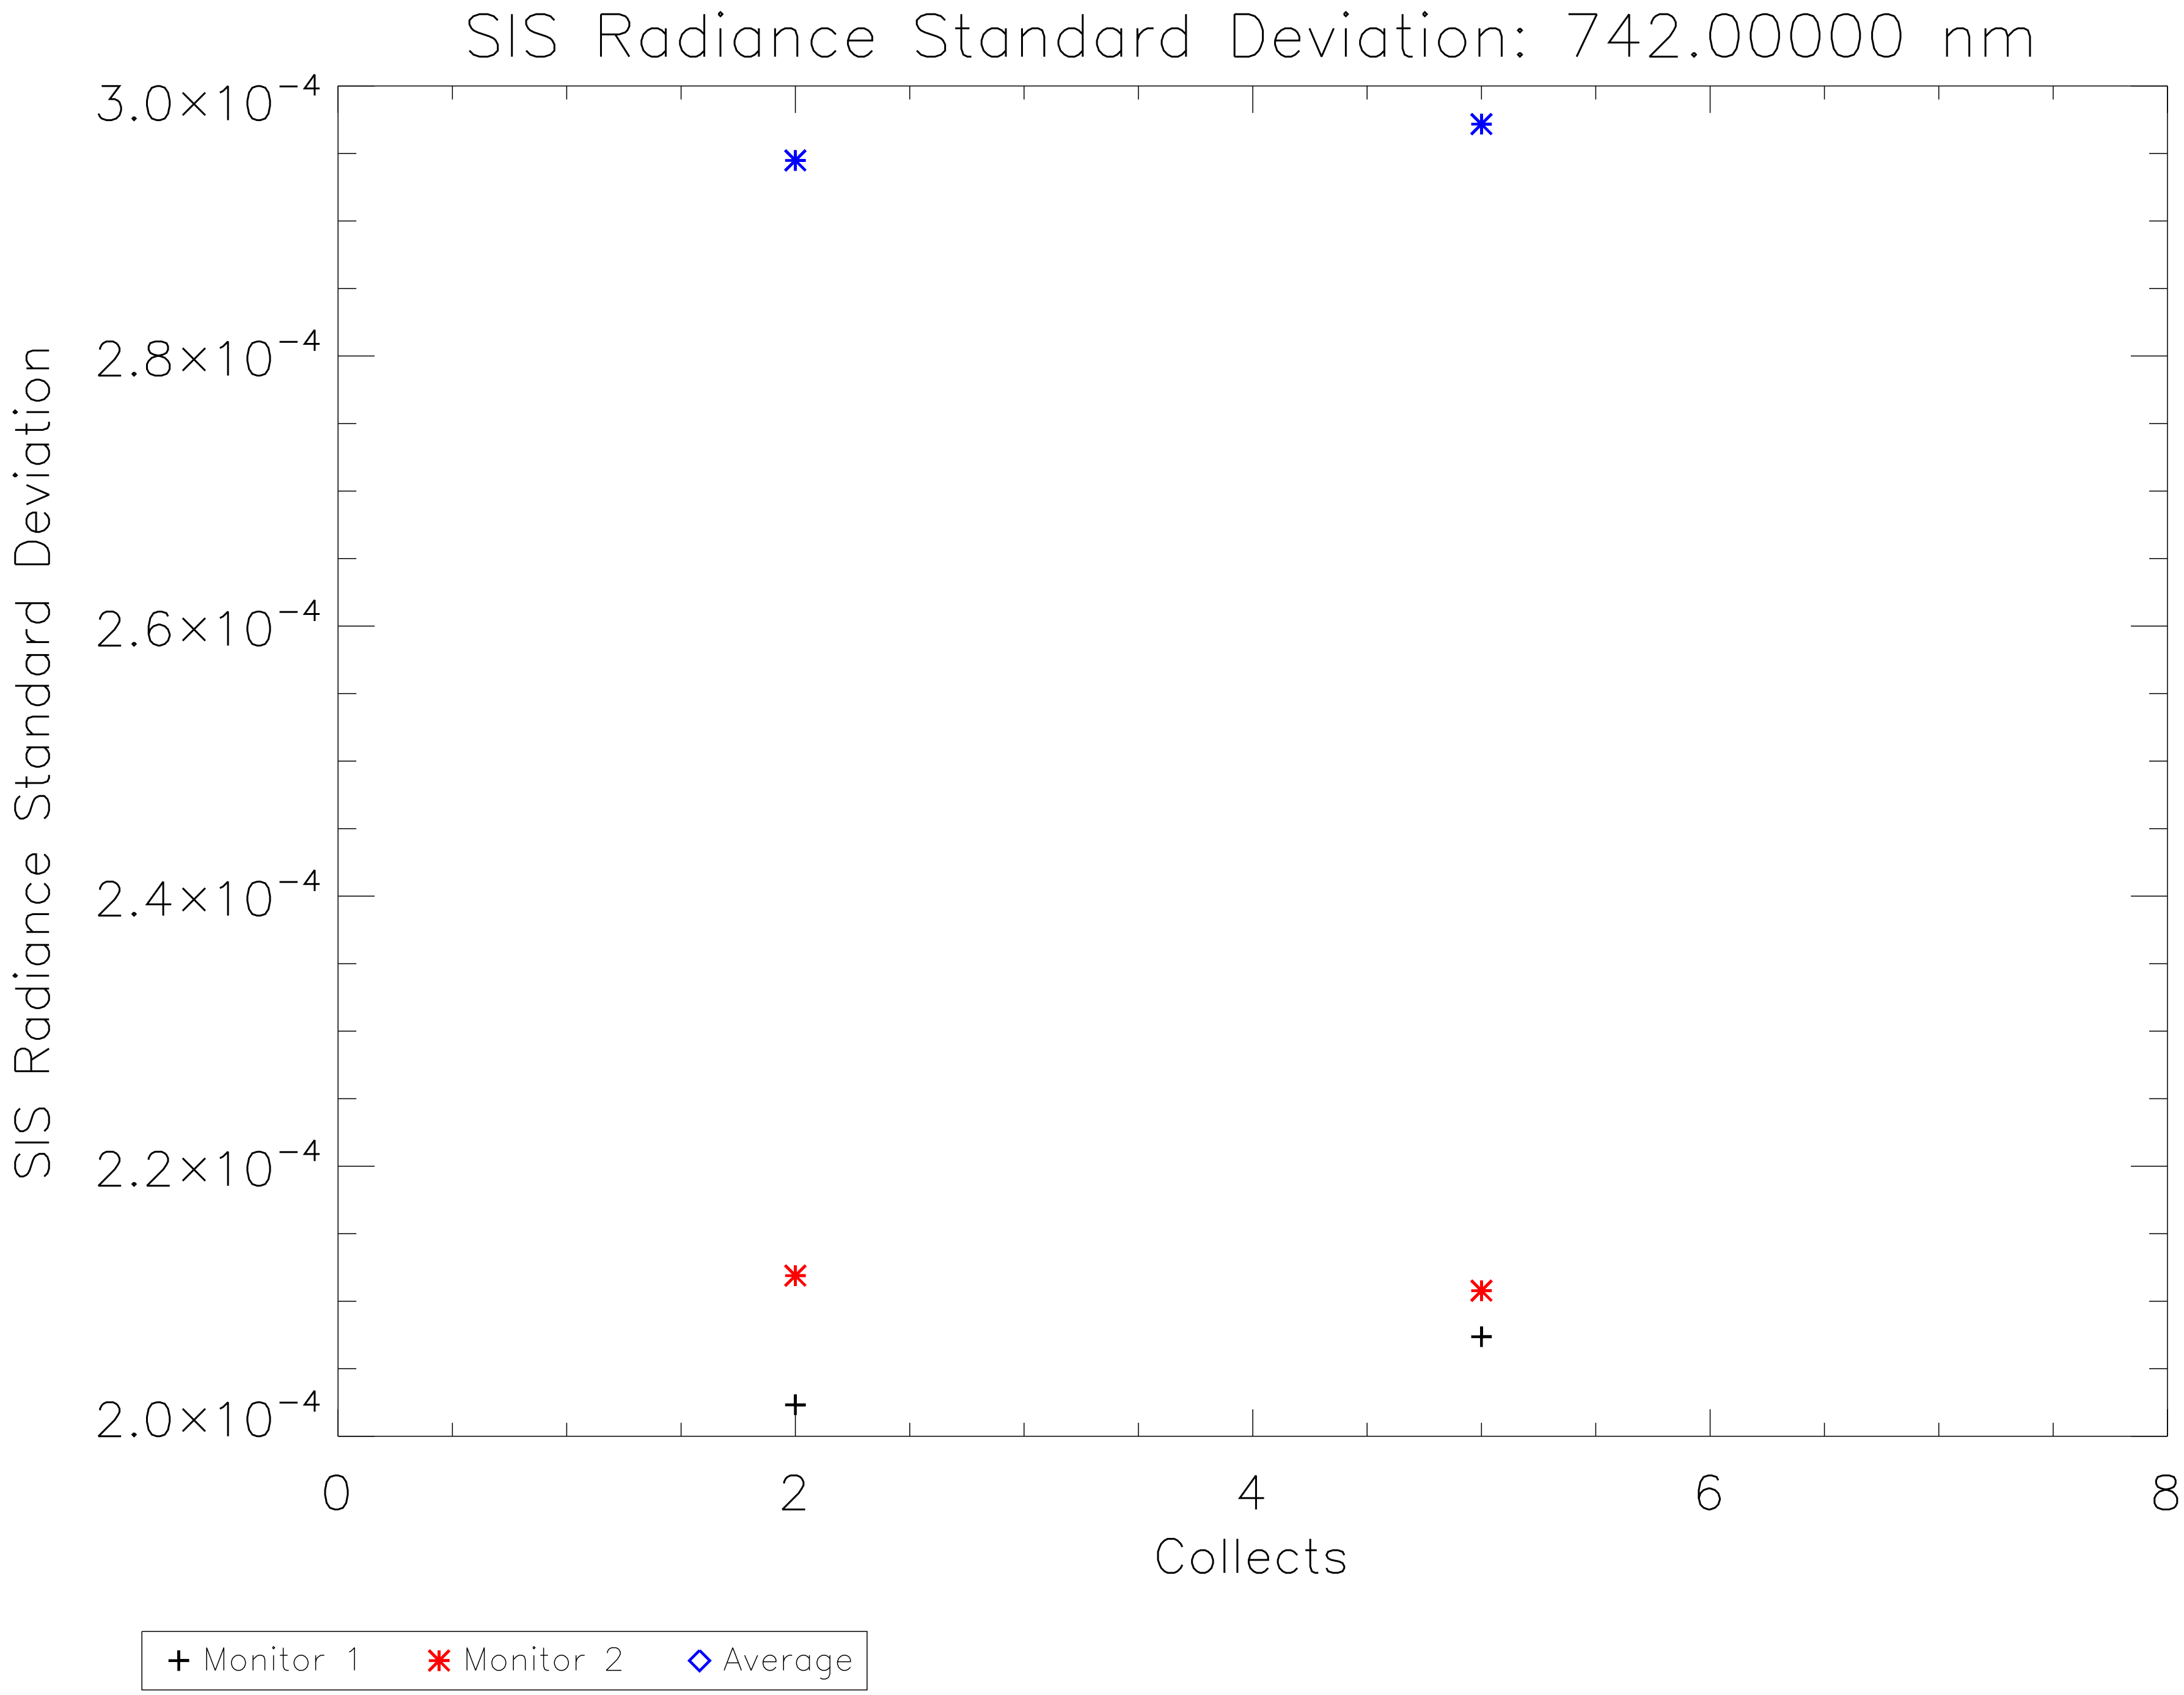
SIS Radiance Standard Deviation: 742.00000 nm
SIS Radiance Standard Deviation
3.0×10⁻⁴
2.8×10⁻⁴
2.6×10⁻⁴
2.4×10⁻⁴
2.2×10⁻⁴
2.0×10⁻⁴
0
2
4
6
8
Collects
+ Monitor 1
✳ Monitor 2
◇ Average

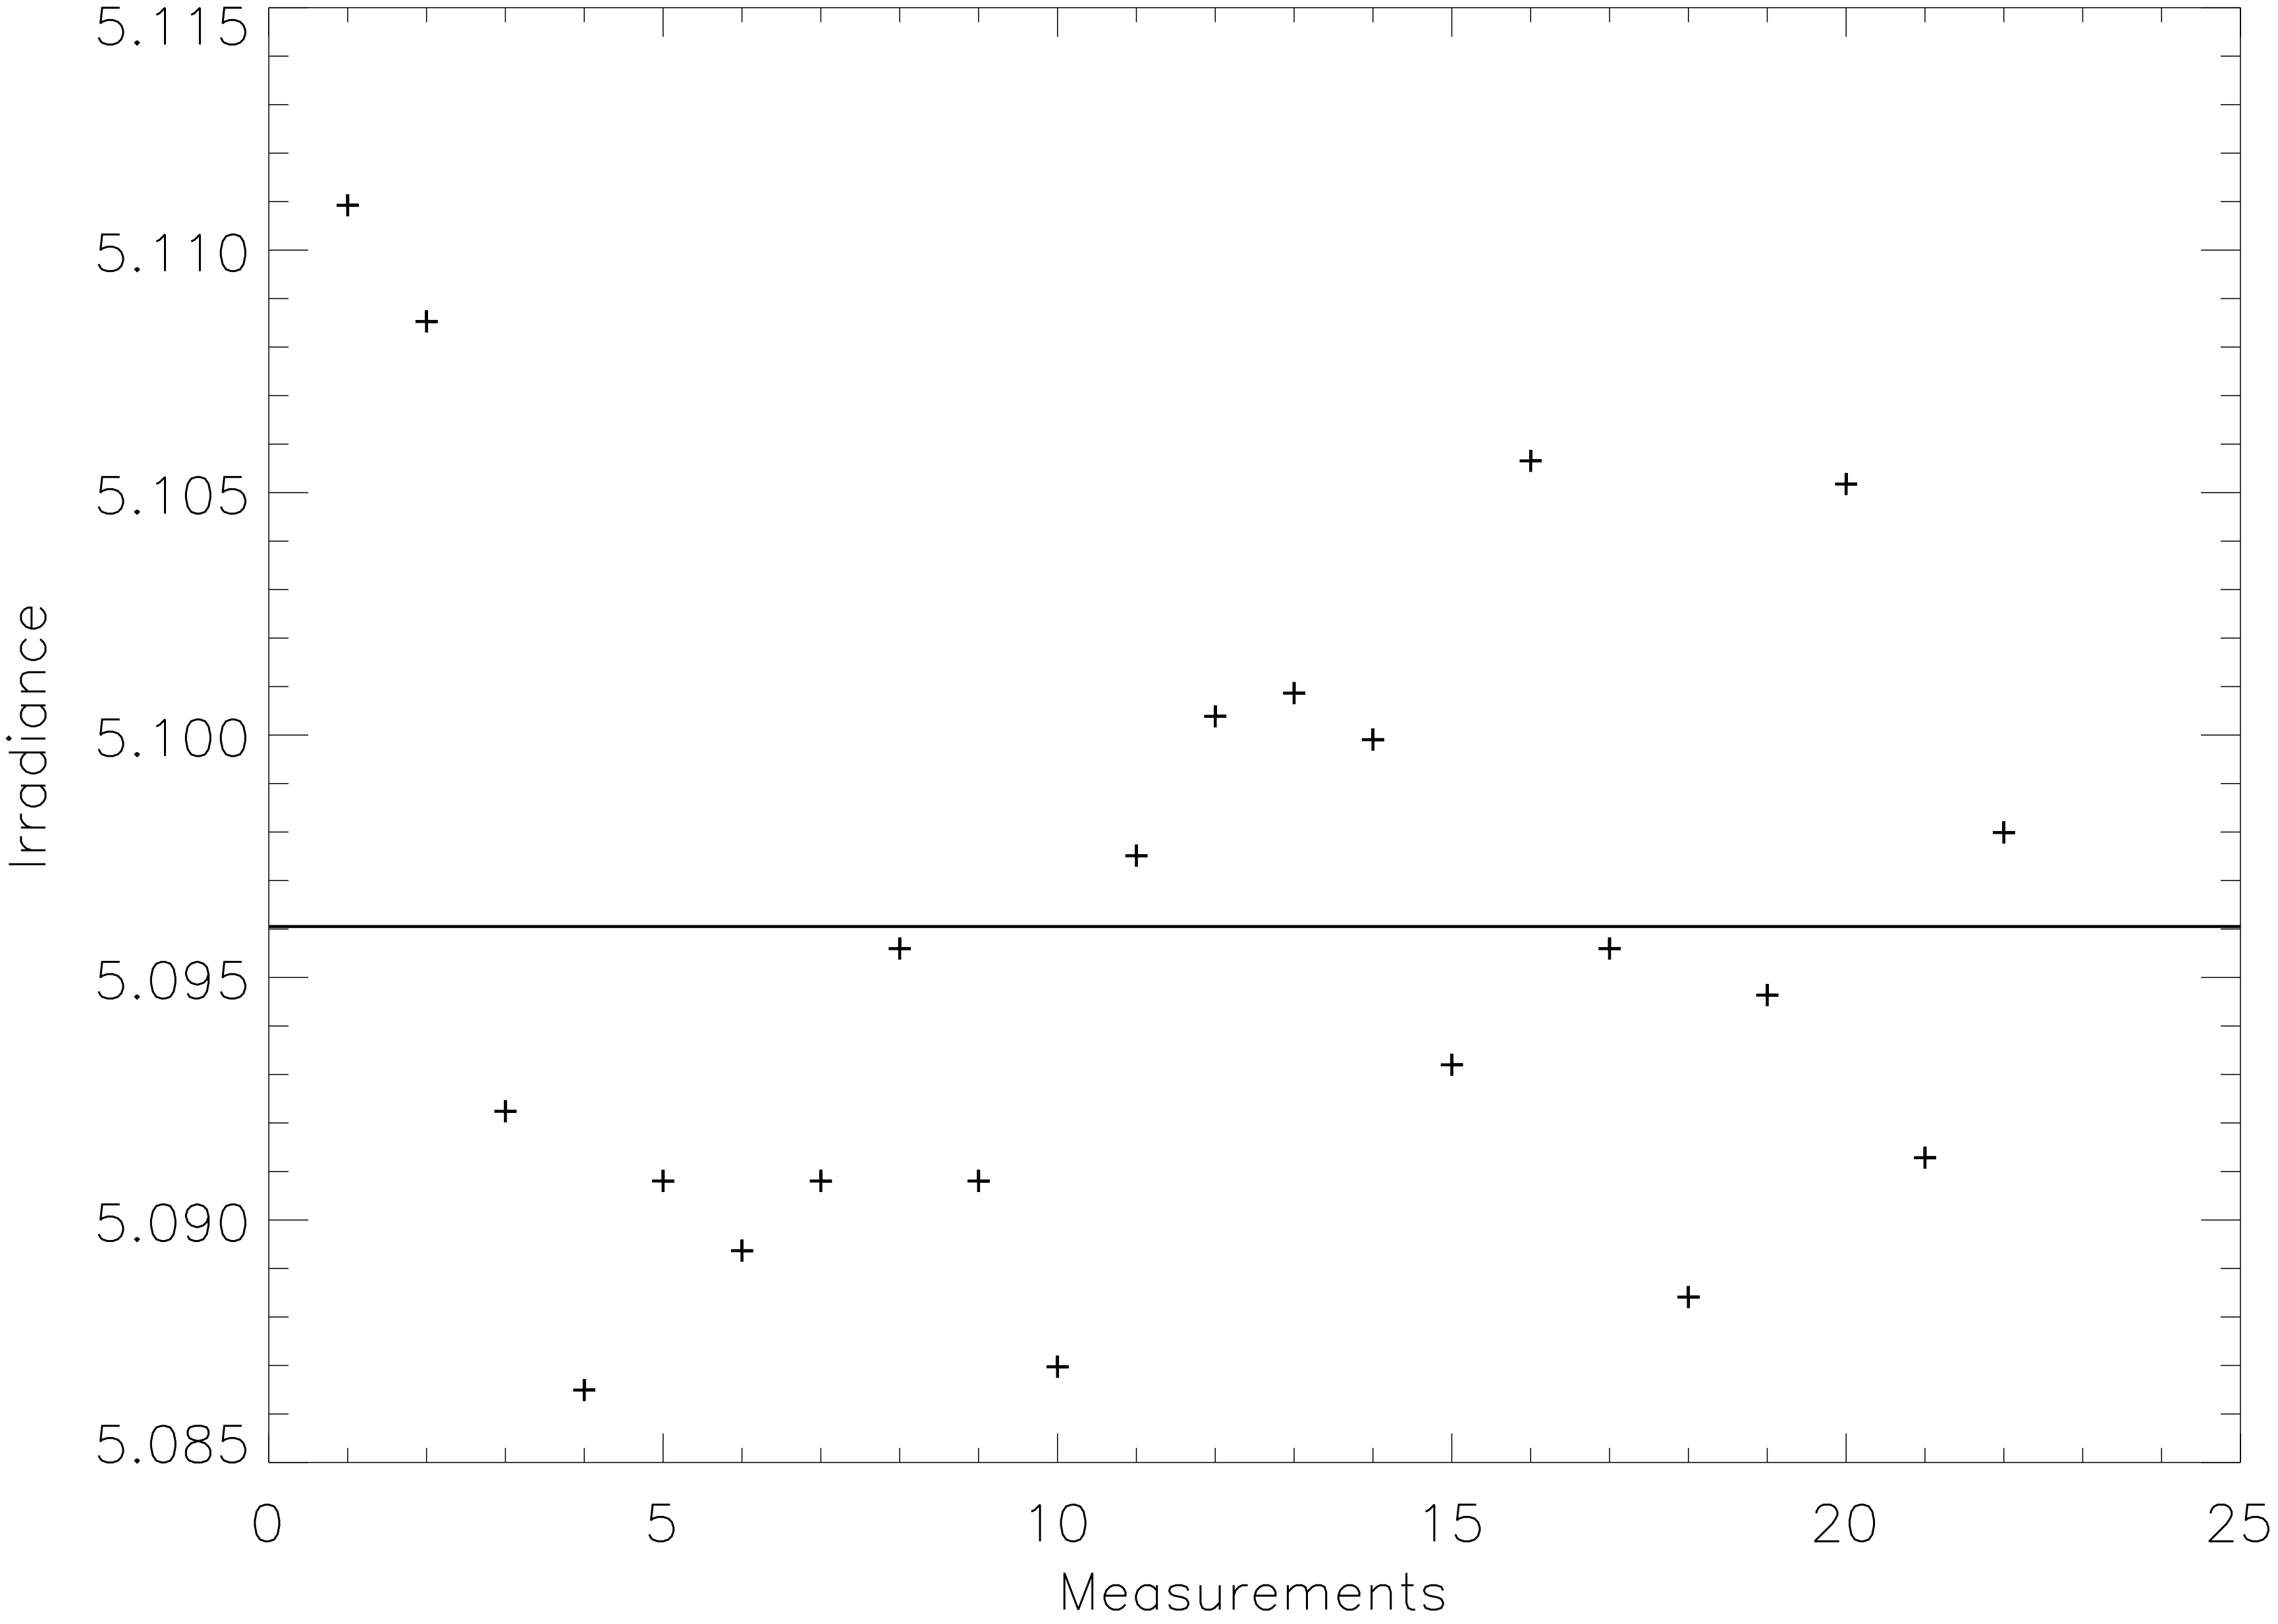

Collimator Irradiance: 742.00000 nm, Collect 1

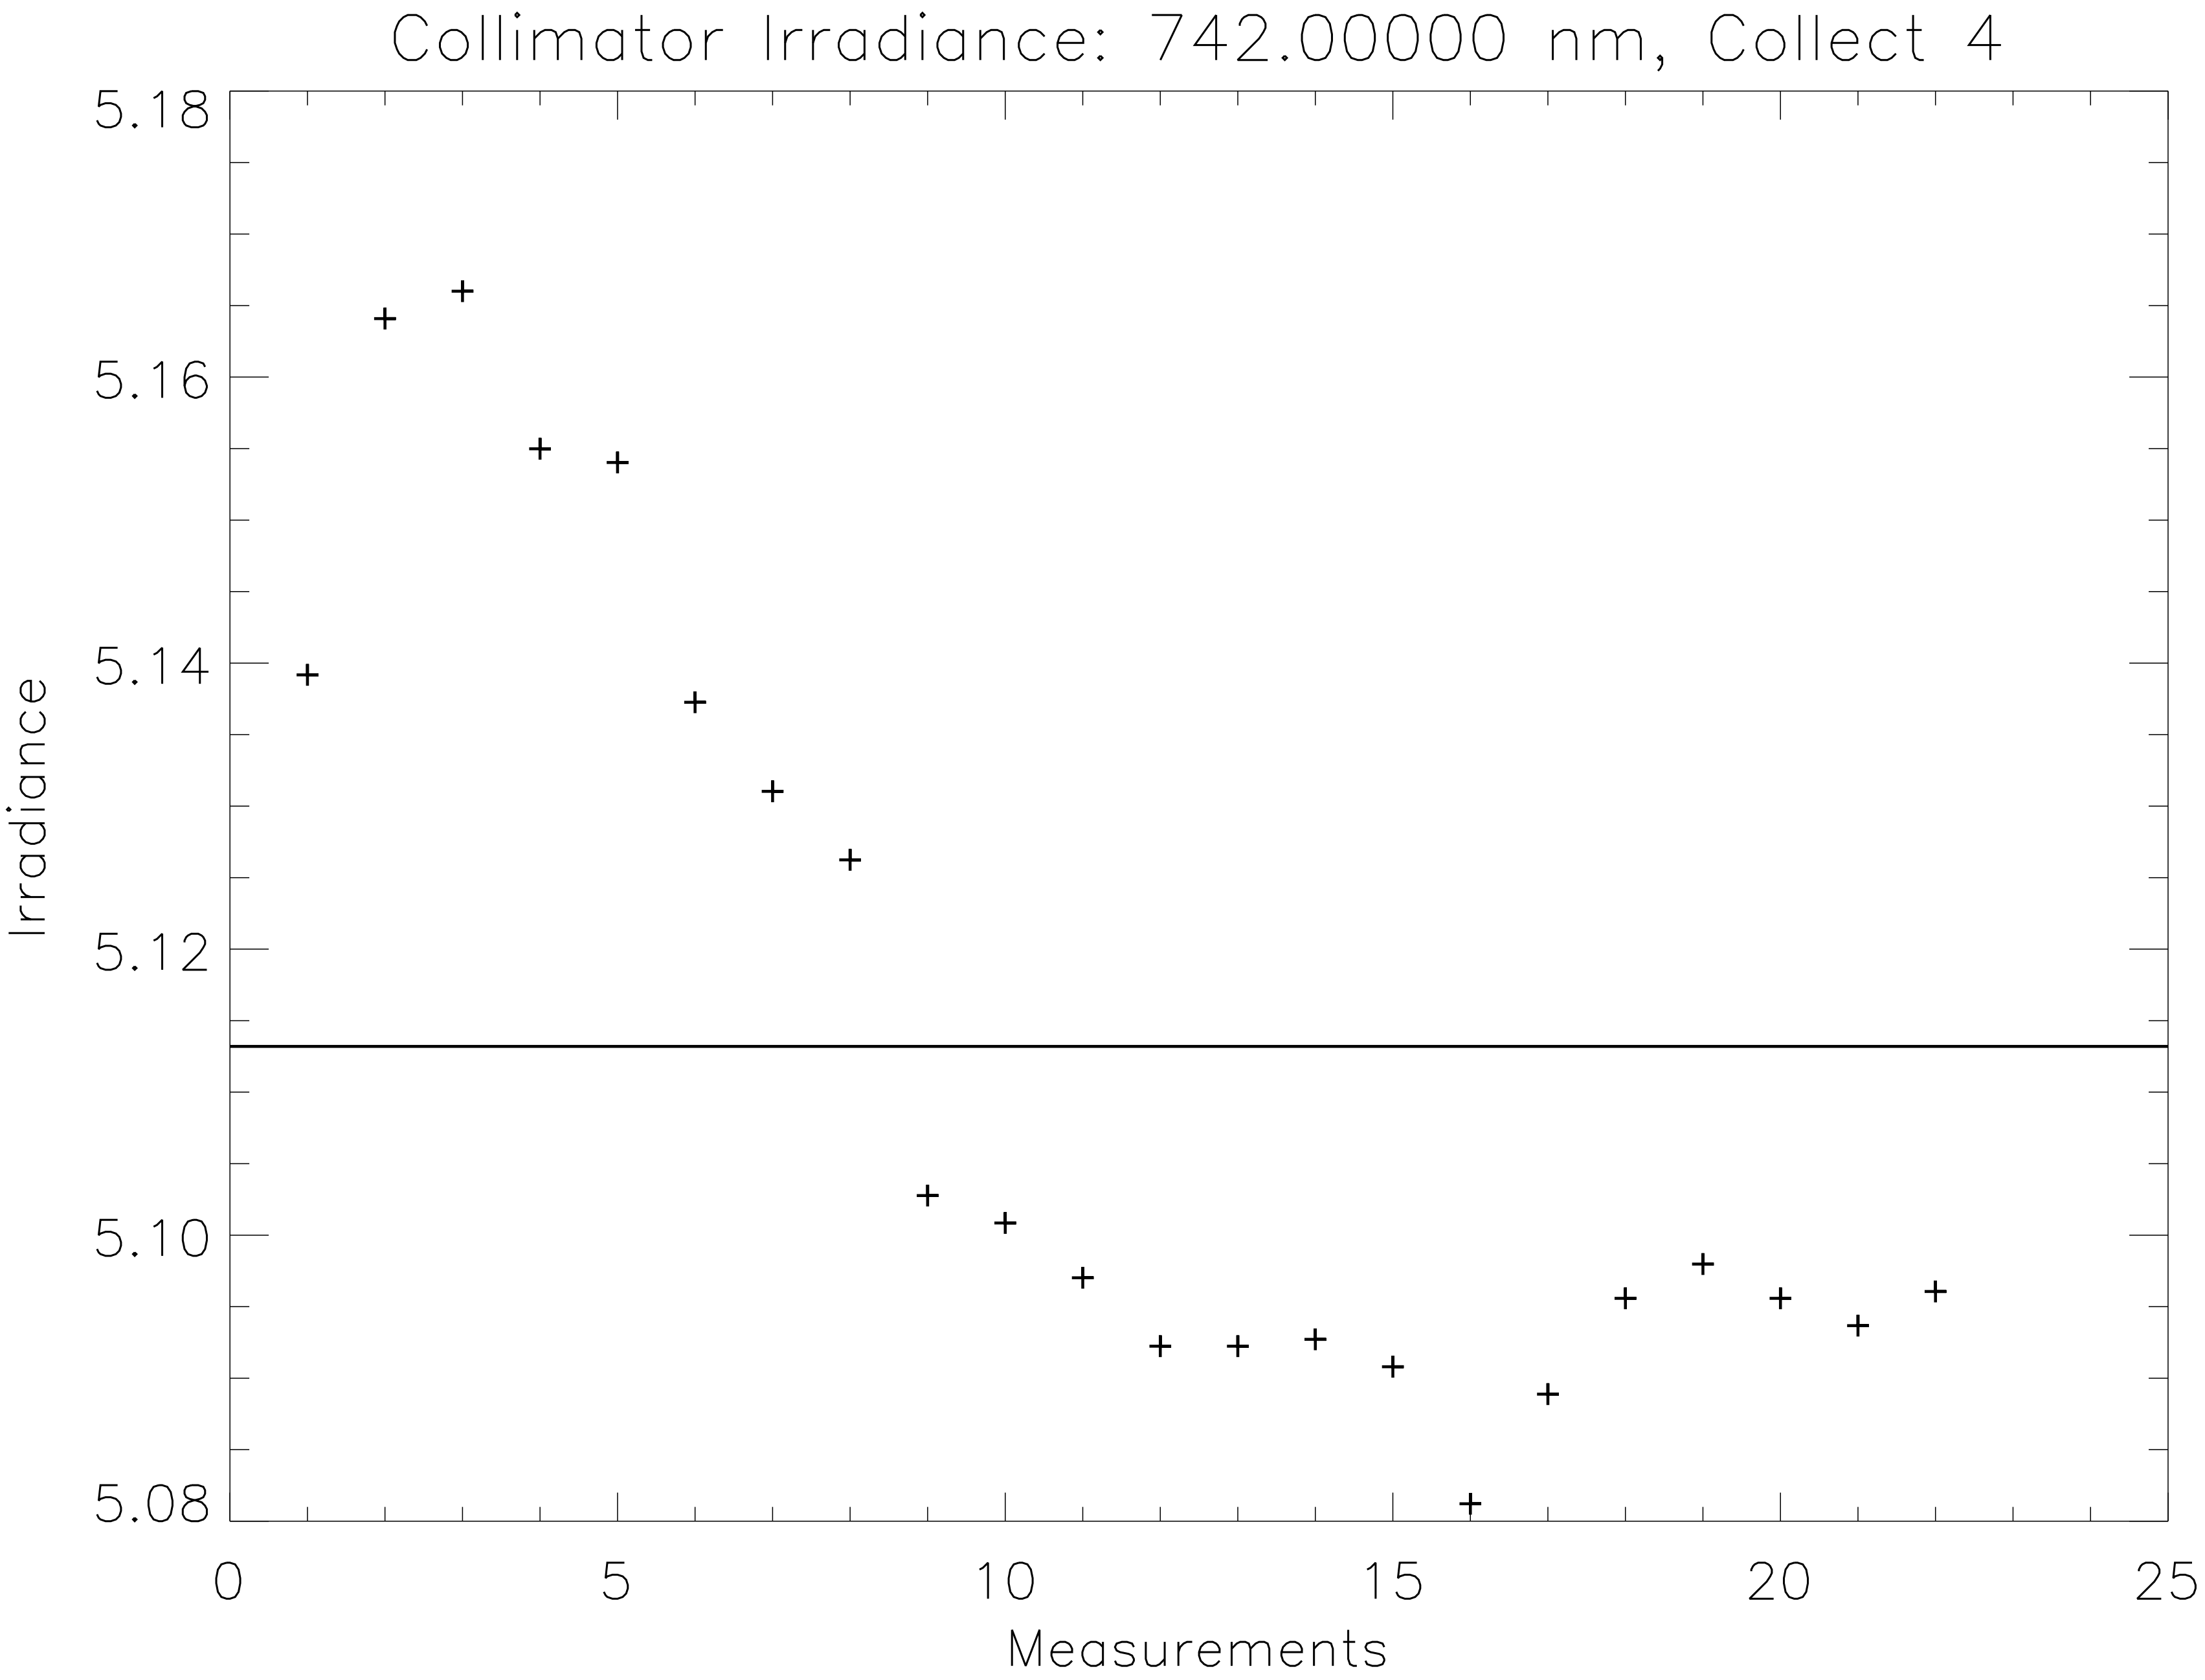
Collimator Irradiance: 742.00000 nm, Collect 4
Irradiance
5.18
5.16
5.14
5.12
5.10
5.08
0
5
10
15
20
25
Measurements

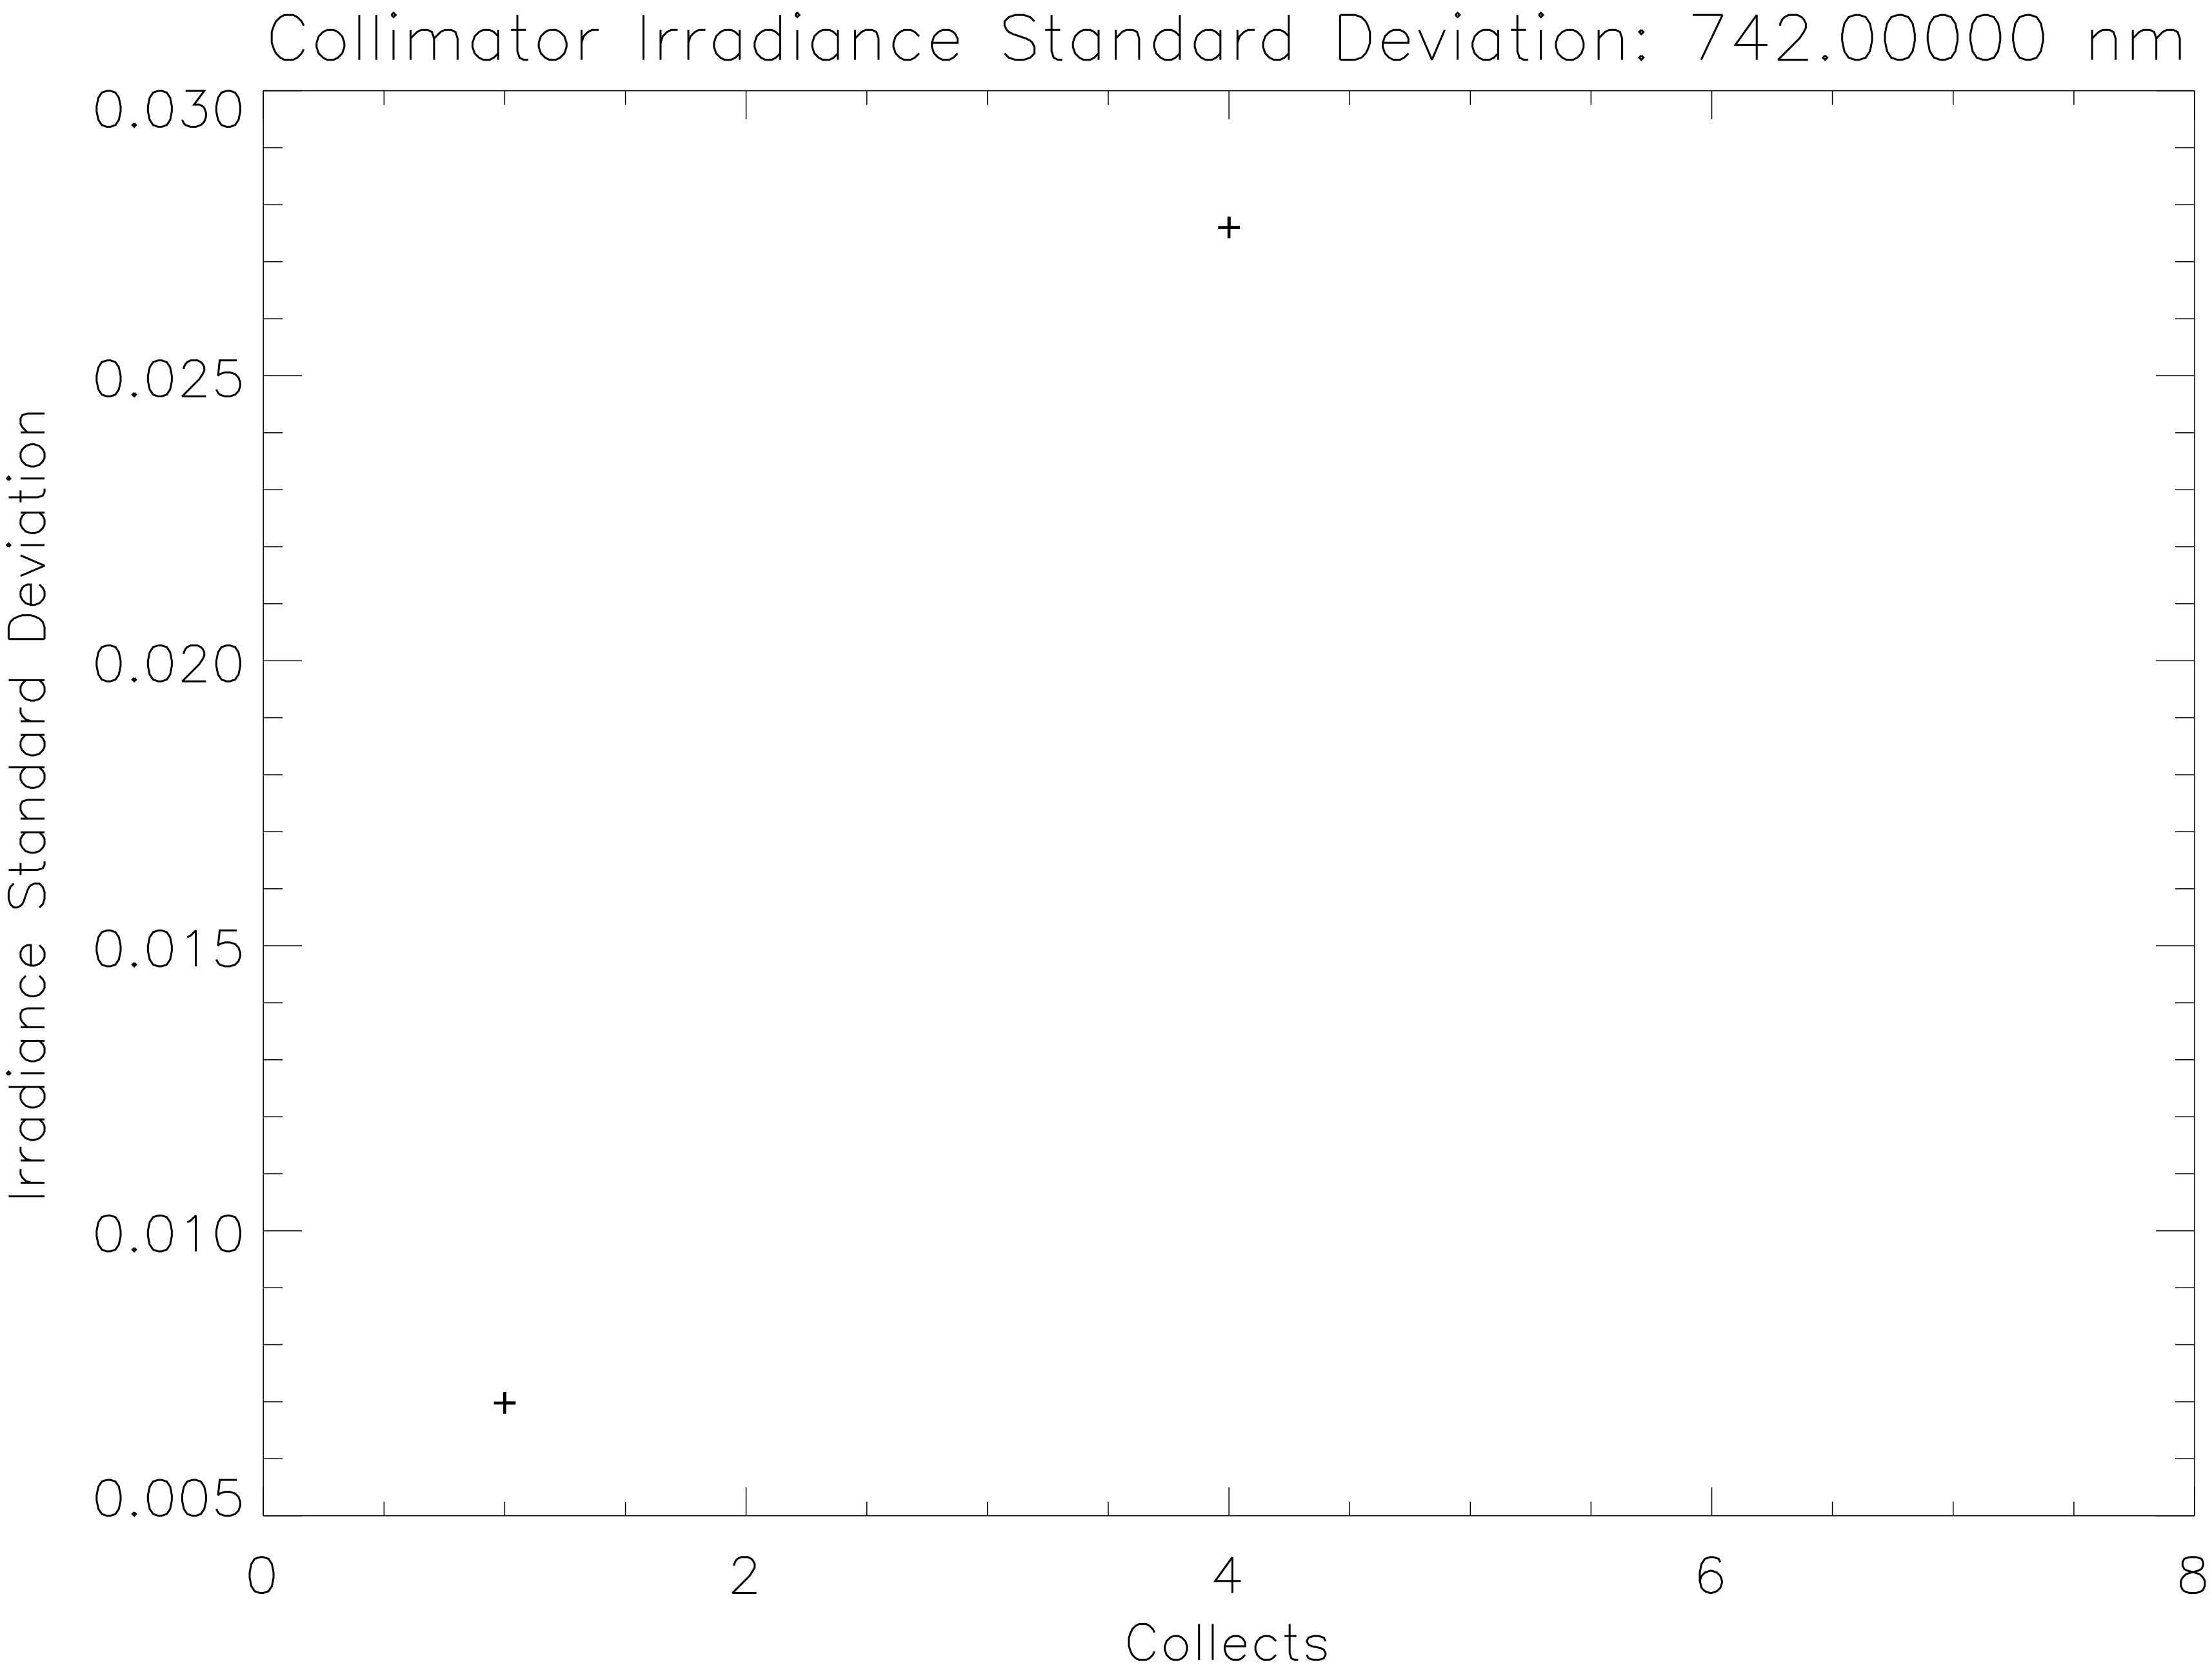
Collimator Irradiance Standard Deviation: 742.00000 nm