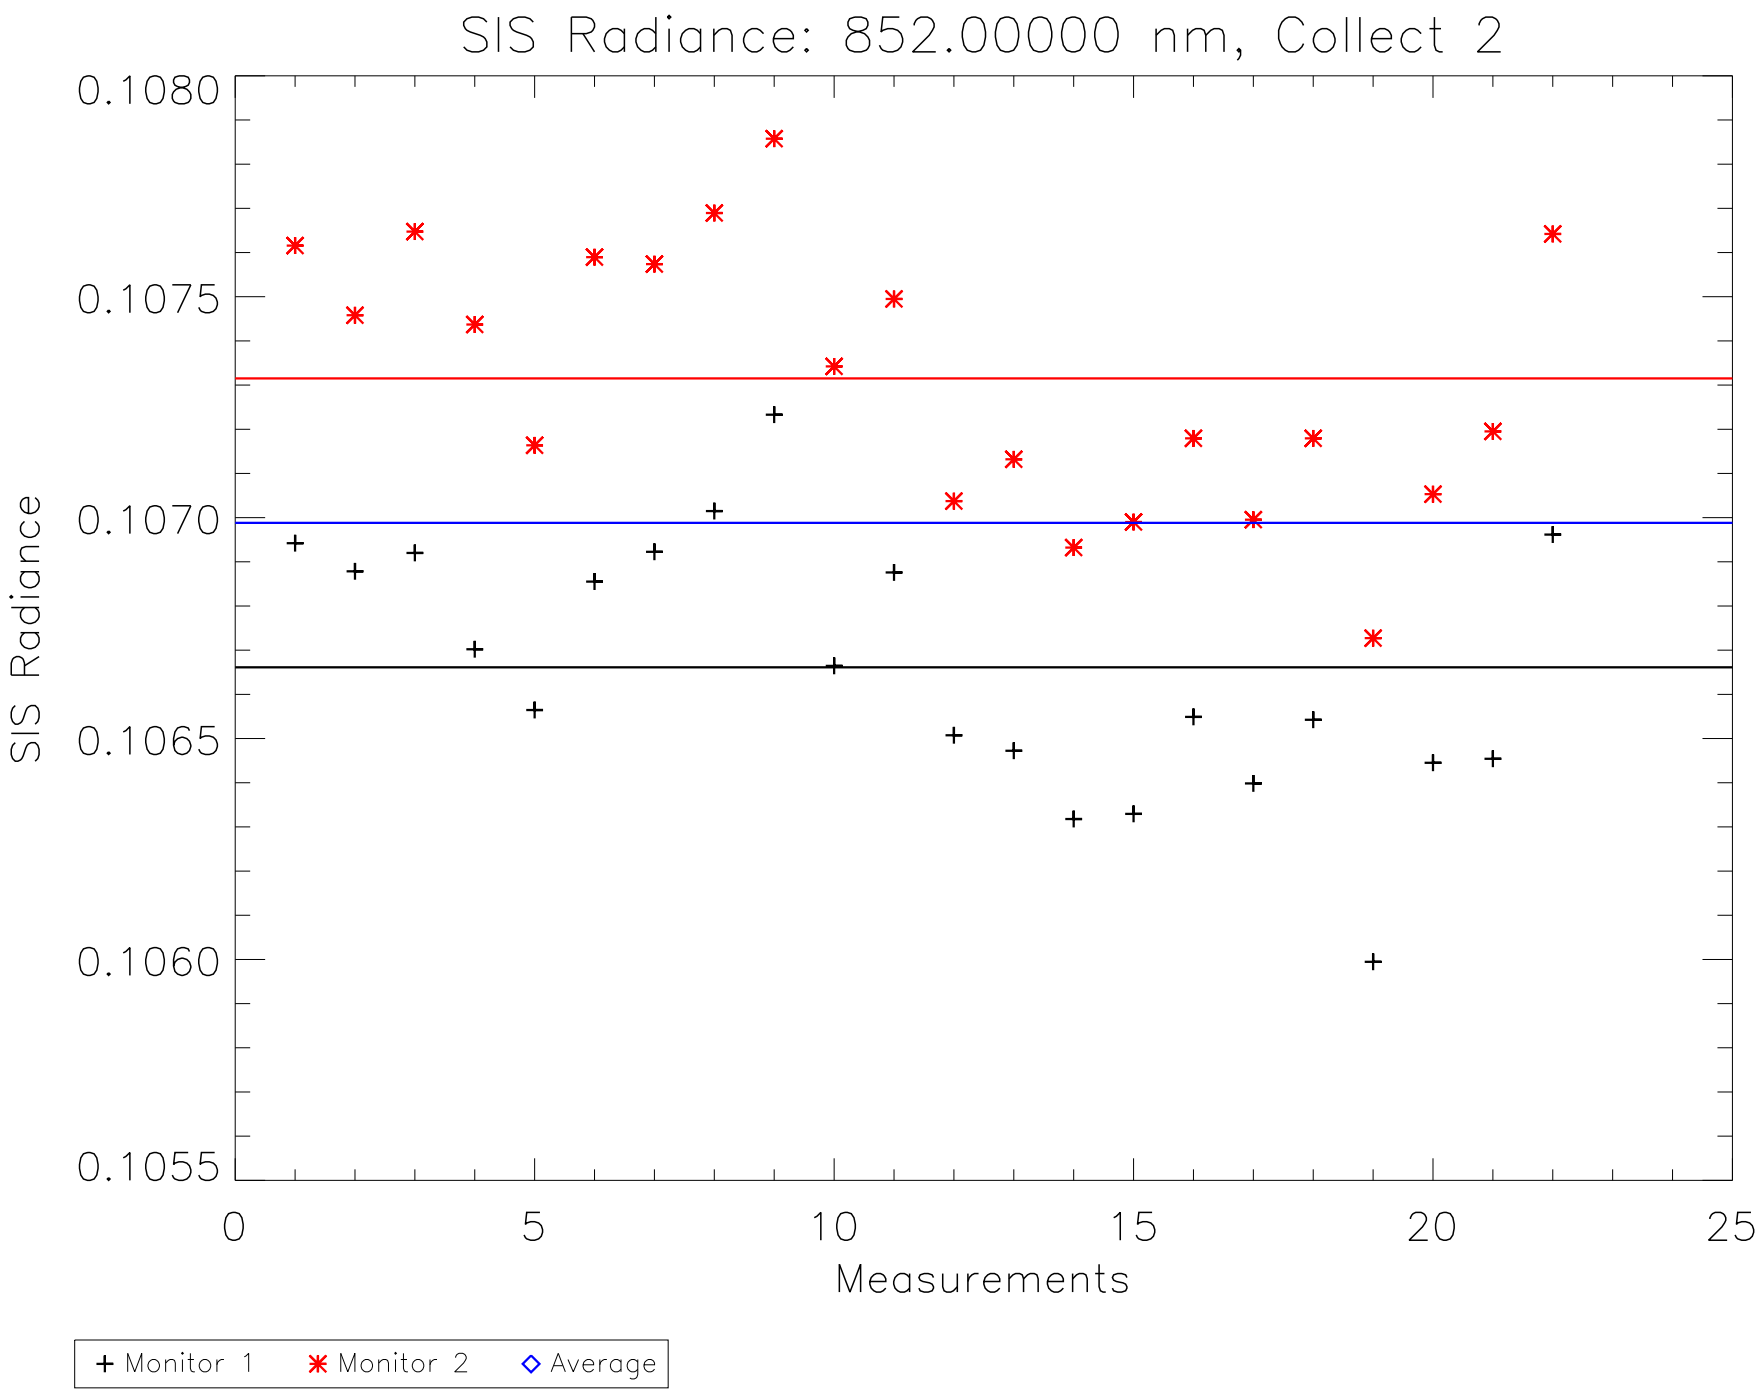
SIS Radiance: 852.00000 nm, Collect 2
SIS Radiance
0.1080
0.1075
0.1070
0.1065
0.1060
0.1055
0
5
10
15
20
25
Measurements
Monitor 1
Monitor 2
Average

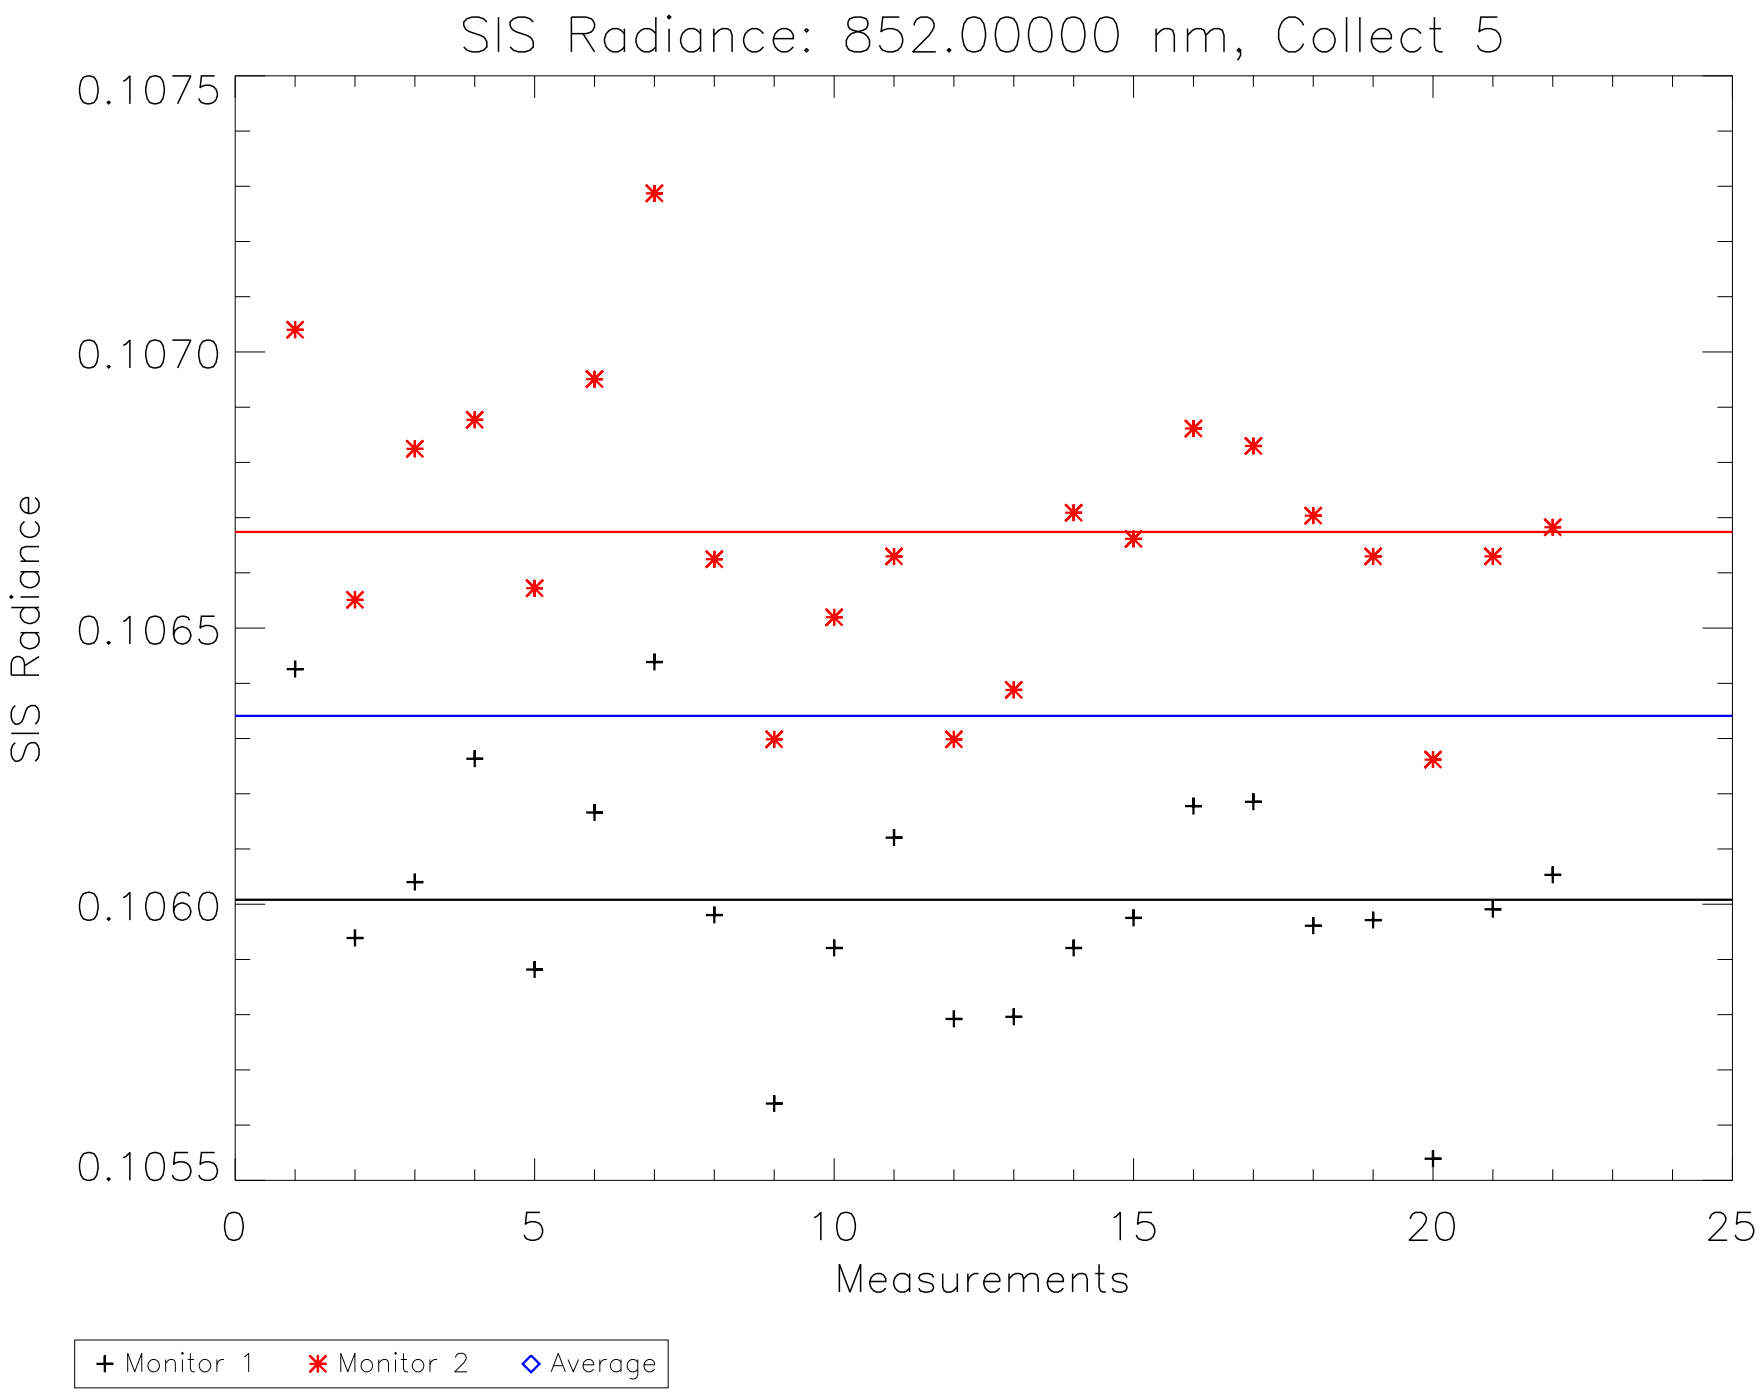
SIS Radiance: 852.00000 nm, Collect 5
SIS Radiance
0.1075
0.1070
0.1065
0.1060
0.1055
0
5
10
15
20
25
Measurements
Monitor 1
Monitor 2
Average

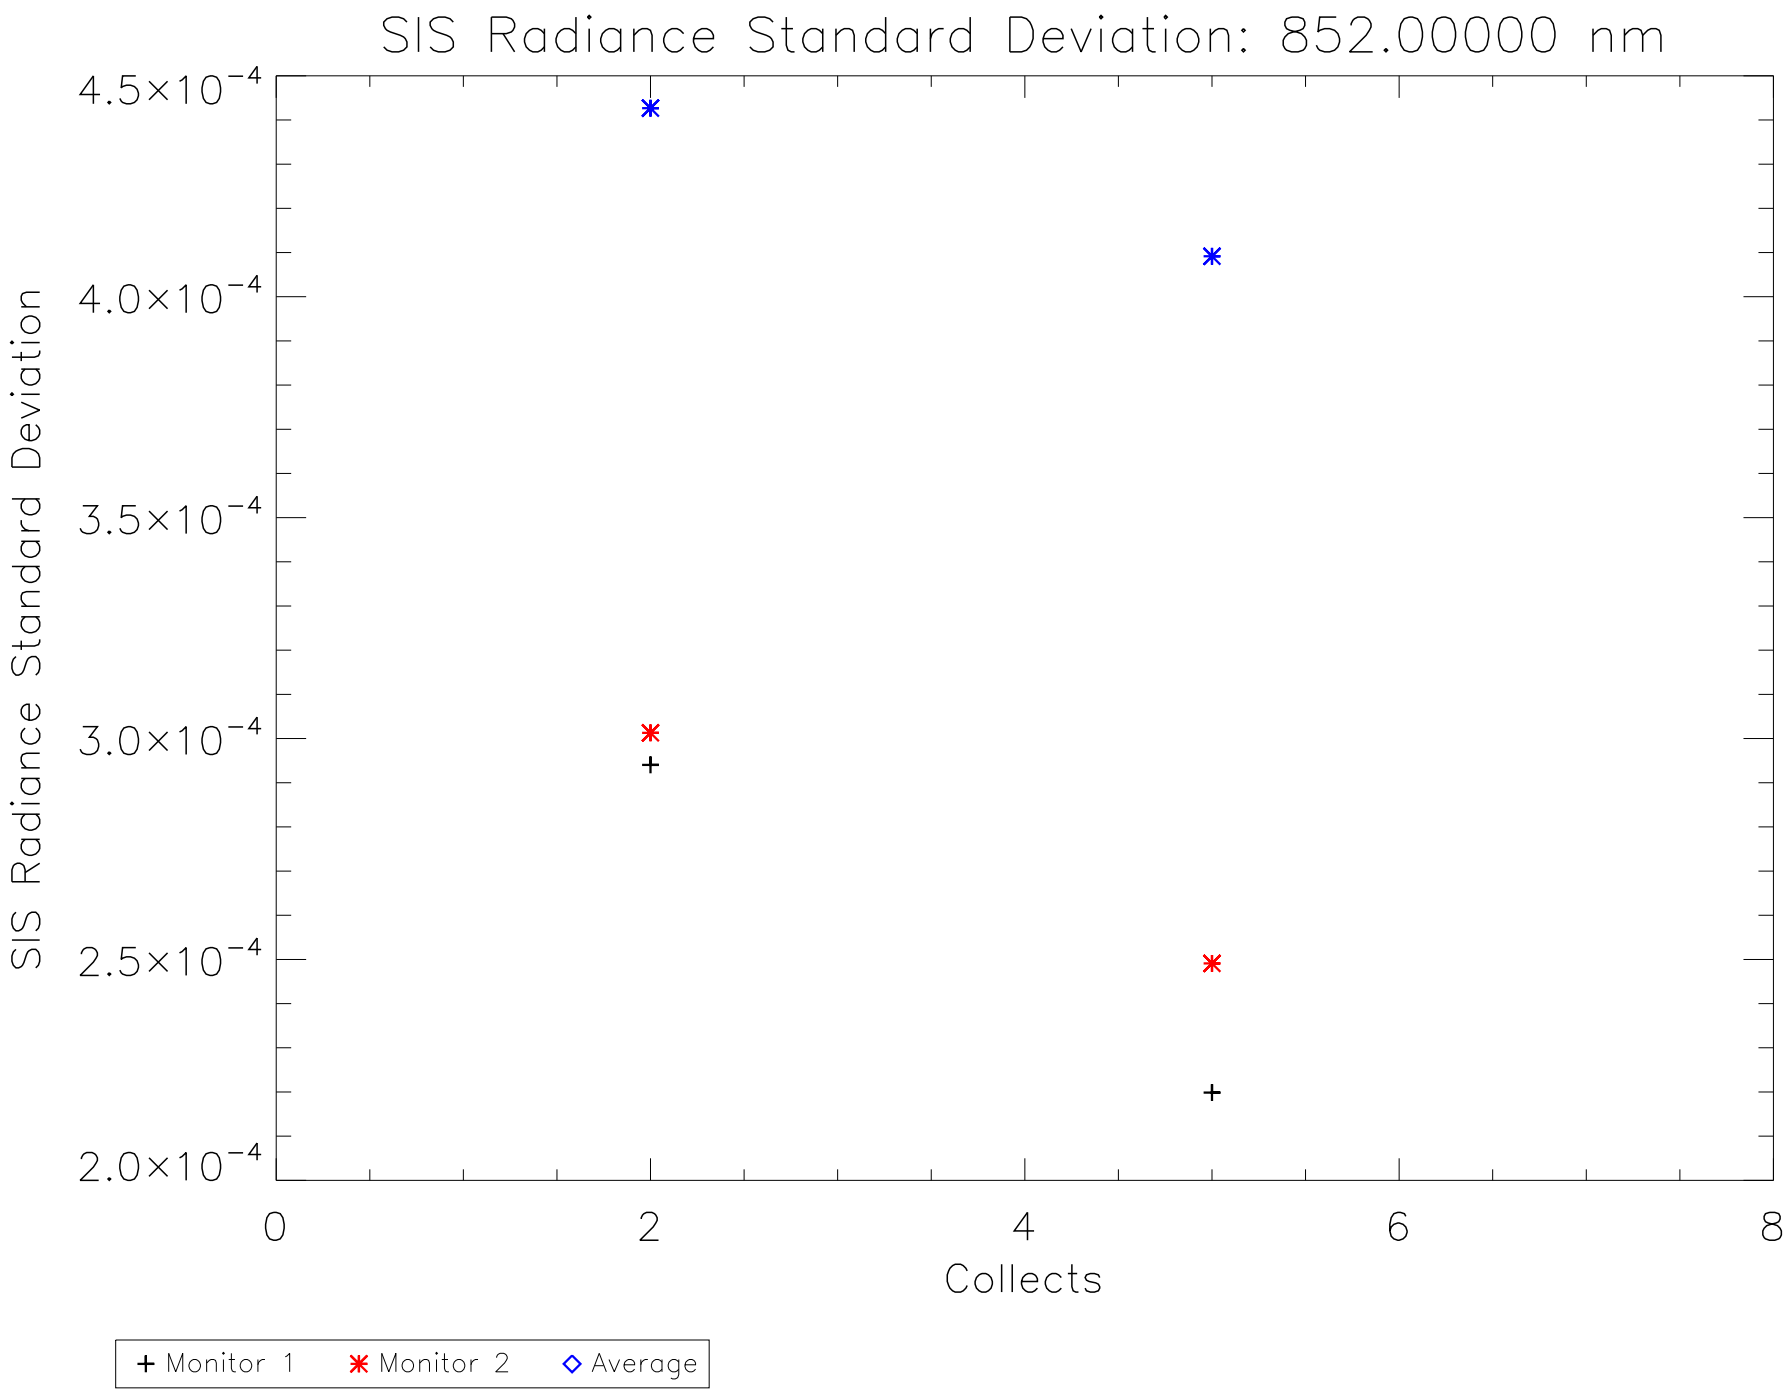
SIS Radiance Standard Deviation: 852.00000 nm
SIS Radiance Standard Deviation
4.5×10⁻⁴
4.0×10⁻⁴
3.5×10⁻⁴
3.0×10⁻⁴
2.5×10⁻⁴
2.0×10⁻⁴
0
2
4
6
8
Collects
Monitor 1
Monitor 2
Average

Collimator Irradiance: 852.00000 nm, Collect 1
Irradiance
4.78
4.76
4.74
4.72
4.70
4.68
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance: 852.00000 nm, Collect 4
Irradiance
4.76
4.74
4.72
4.70
4.68
4.66
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance Standard Deviation: 852.00000 nm
Irradiance Standard Deviation
0.034
0.032
0.030
0.028
0.026
0.024
Collects
0
2
4
6
8