SIS Radiance: 742.00000 nm, Collect 2
SIS Radiance
Measurements
0.1330
0.1325
0.1320
0.1315
0.1310
0
5
10
15
20
25
Monitor 1
Monitor 2
Average

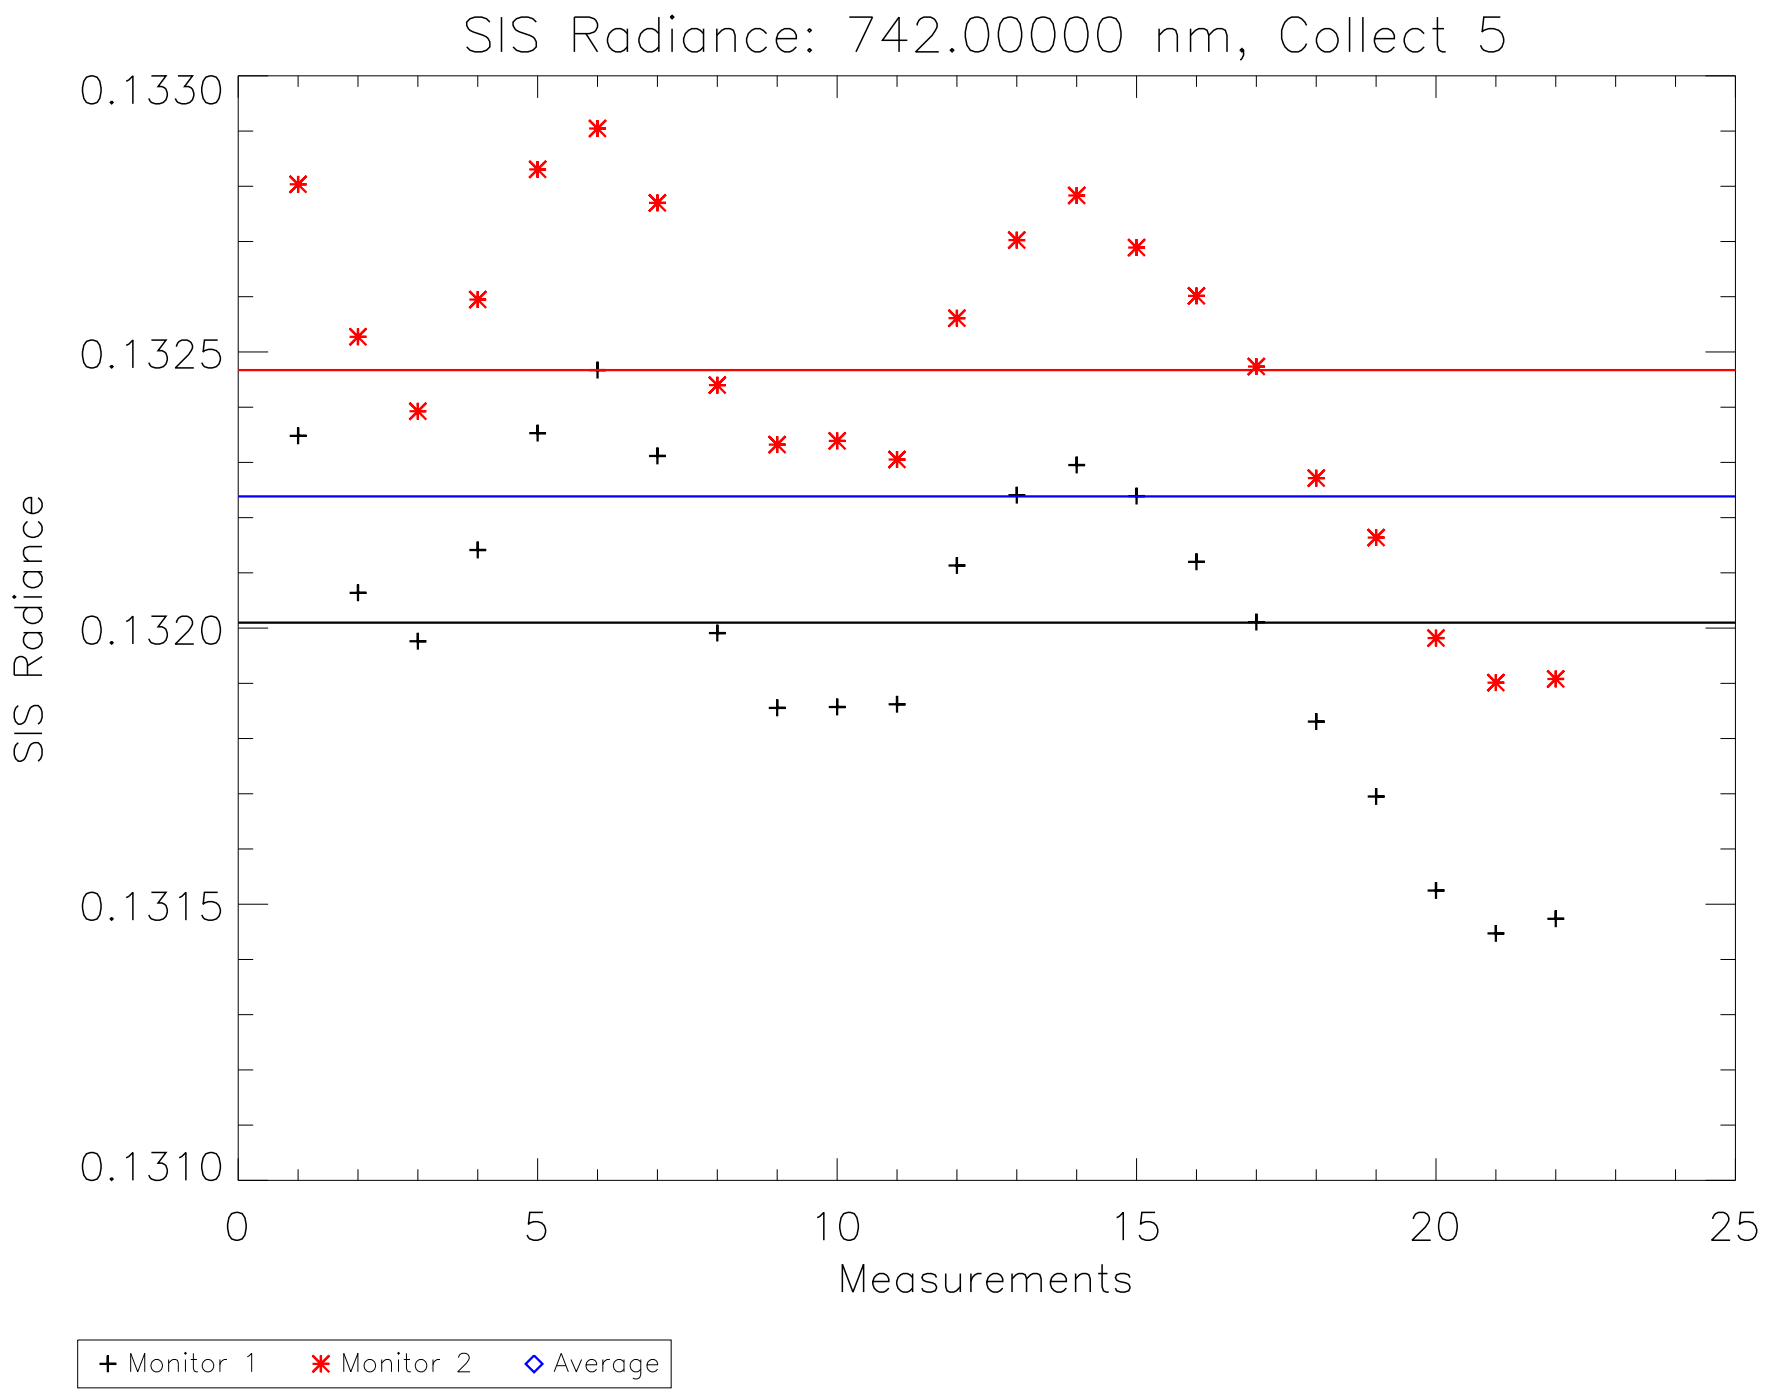
SIS Radiance: 742.00000 nm, Collect 5
SIS Radiance
0.1330
0.1325
0.1320
0.1315
0.1310
0
5
10
15
20
25
Measurements
Monitor 1
Monitor 2
Average

SIS Radiance Standard Deviation: 742.00000 nm
SIS Radiance Standard Deviation
Collects
Monitor 1
Monitor 2
Average
4.0×10⁻⁴
3.8×10⁻⁴
3.6×10⁻⁴
3.4×10⁻⁴
3.2×10⁻⁴
3.0×10⁻⁴
2.8×10⁻⁴
0
2
4
6
8

Collimator Irradiance: 742.00000 nm, Collect 1
Irradiance
6.40
6.38
6.36
6.34
6.32
6.30
6.28
6.26
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance: 742.00000 nm, Collect 4
Irradiance
6.36
6.34
6.32
6.30
6.28
6.26
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance Standard Deviation: 742.00000 nm
Irradiance Standard Deviation
0.030
0.028
0.026
0.024
0.022
0.020
Collects
0
2
4
6
8