SIS Radiance: 442.00000 nm, Collect 2
SIS Radiance
Measurements
0.0116
0.0118
0.0120
0.0122
0.0124
0.0126
0.0128
0
5
10
15
20
25
Monitor 1
Monitor 2
Average

SIS Radiance: 442.00000 nm, Collect 5
SIS Radiance
Measurements
0.0112
0.0114
0.0116
0.0118
0.0120
0.0122
0.0124
0.0126
0
5
10
15
20
25
Monitor 1
Monitor 2
Average

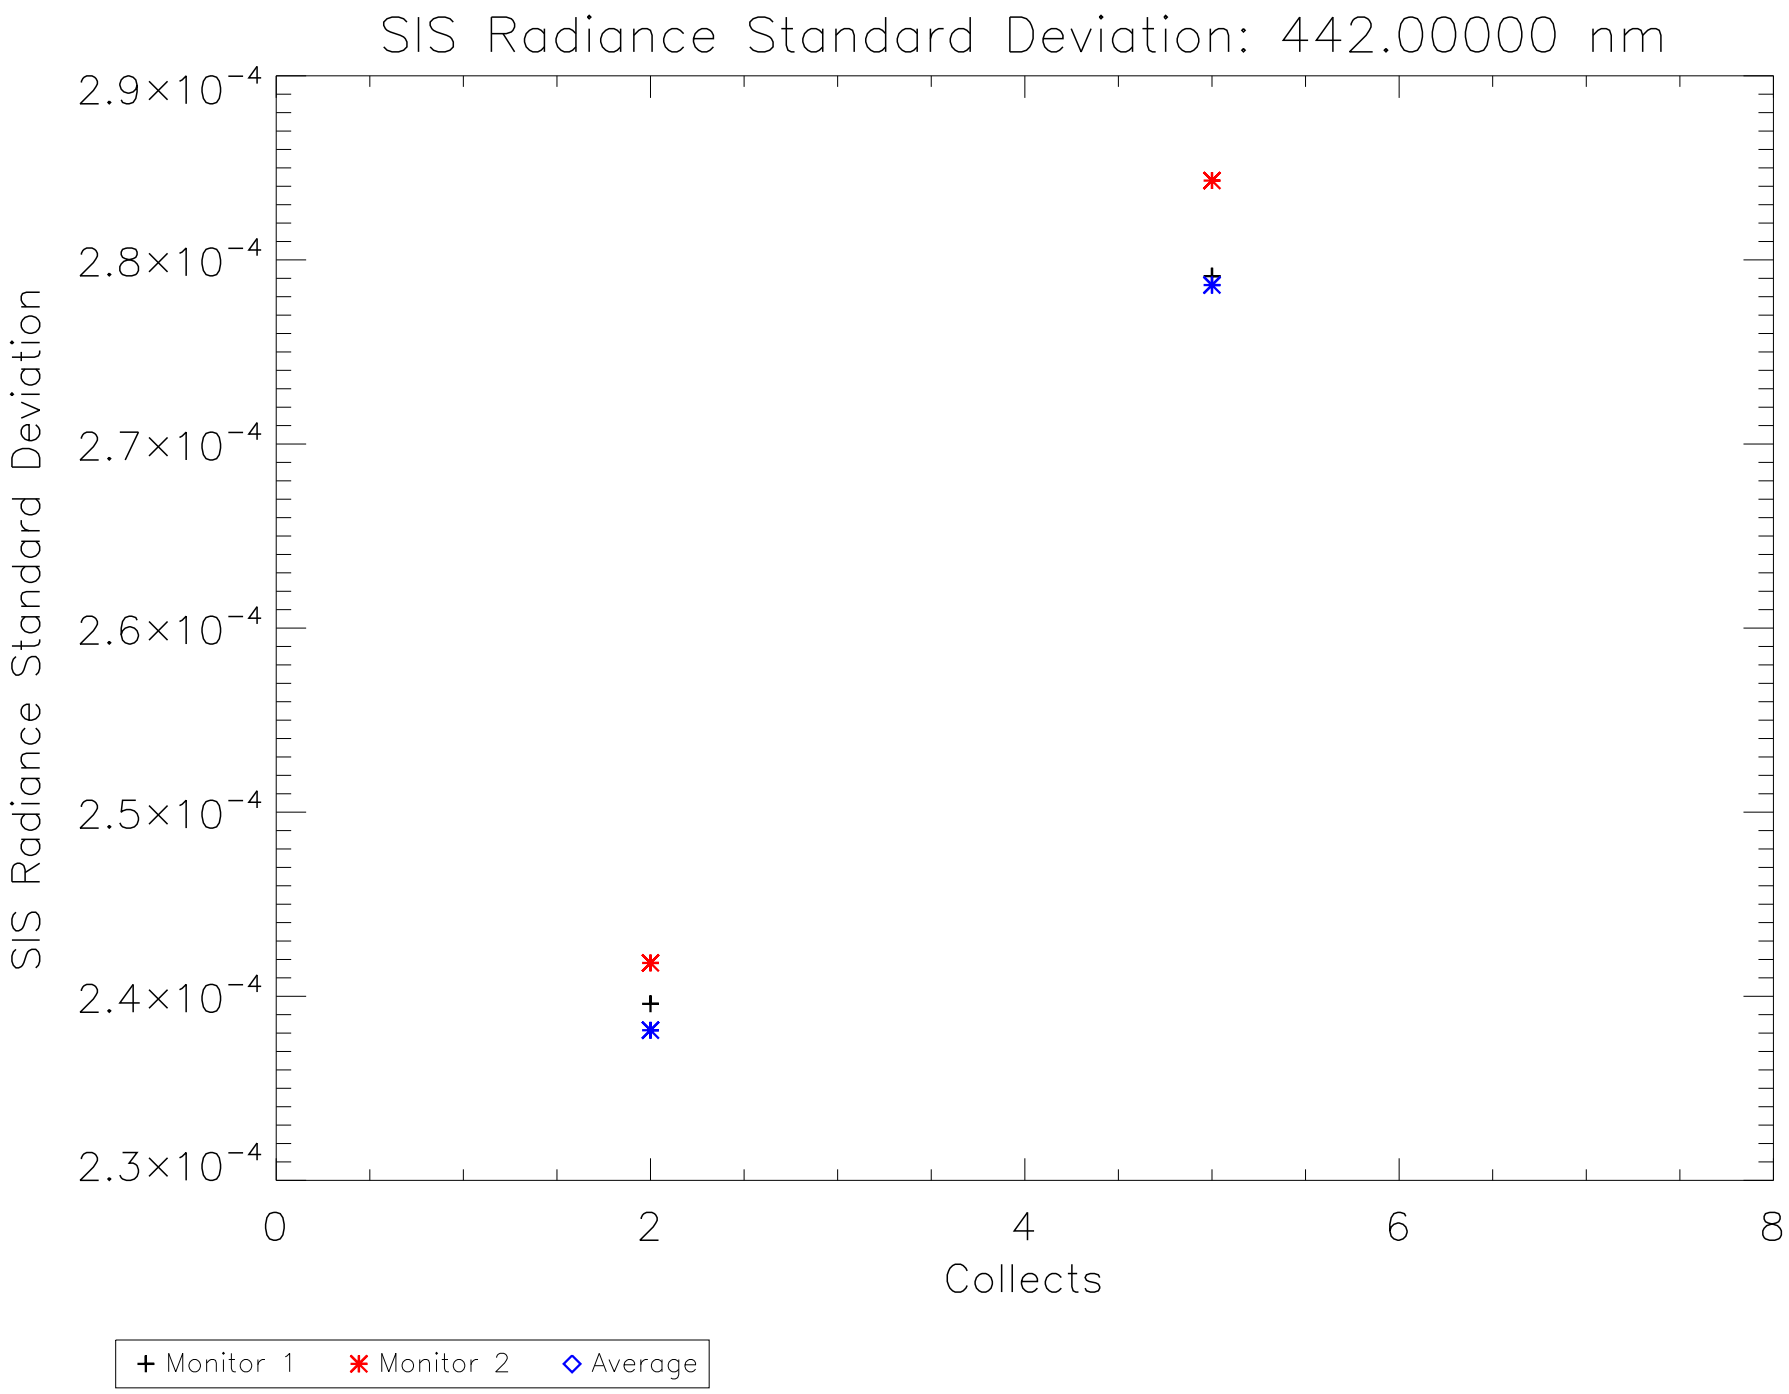
SIS Radiance Standard Deviation: 442.00000 nm
SIS Radiance Standard Deviation
2.9×10⁻⁴
2.8×10⁻⁴
2.7×10⁻⁴
2.6×10⁻⁴
2.5×10⁻⁴
2.4×10⁻⁴
2.3×10⁻⁴
0
2
4
6
8
Collects
Monitor 1
Monitor 2
Average

Collimator Irradiance: 442.00000 nm, Collect 1
Irradiance
0.232
0.231
0.230
0.229
0.228
0.227
0.226
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance: 442.00000 nm, Collect 4
0.232
0.230
0.228
0.226
0.224
Irradiance
0
5
10
15
20
25
Measurements

Collimator Irradiance Standard Deviation: 442.00000 nm
Irradiance Standard Deviation
0.0028
0.0026
0.0024
0.0022
0.0020
0.0018
0.0016
0.0014
0
2
4
6
8
Collects