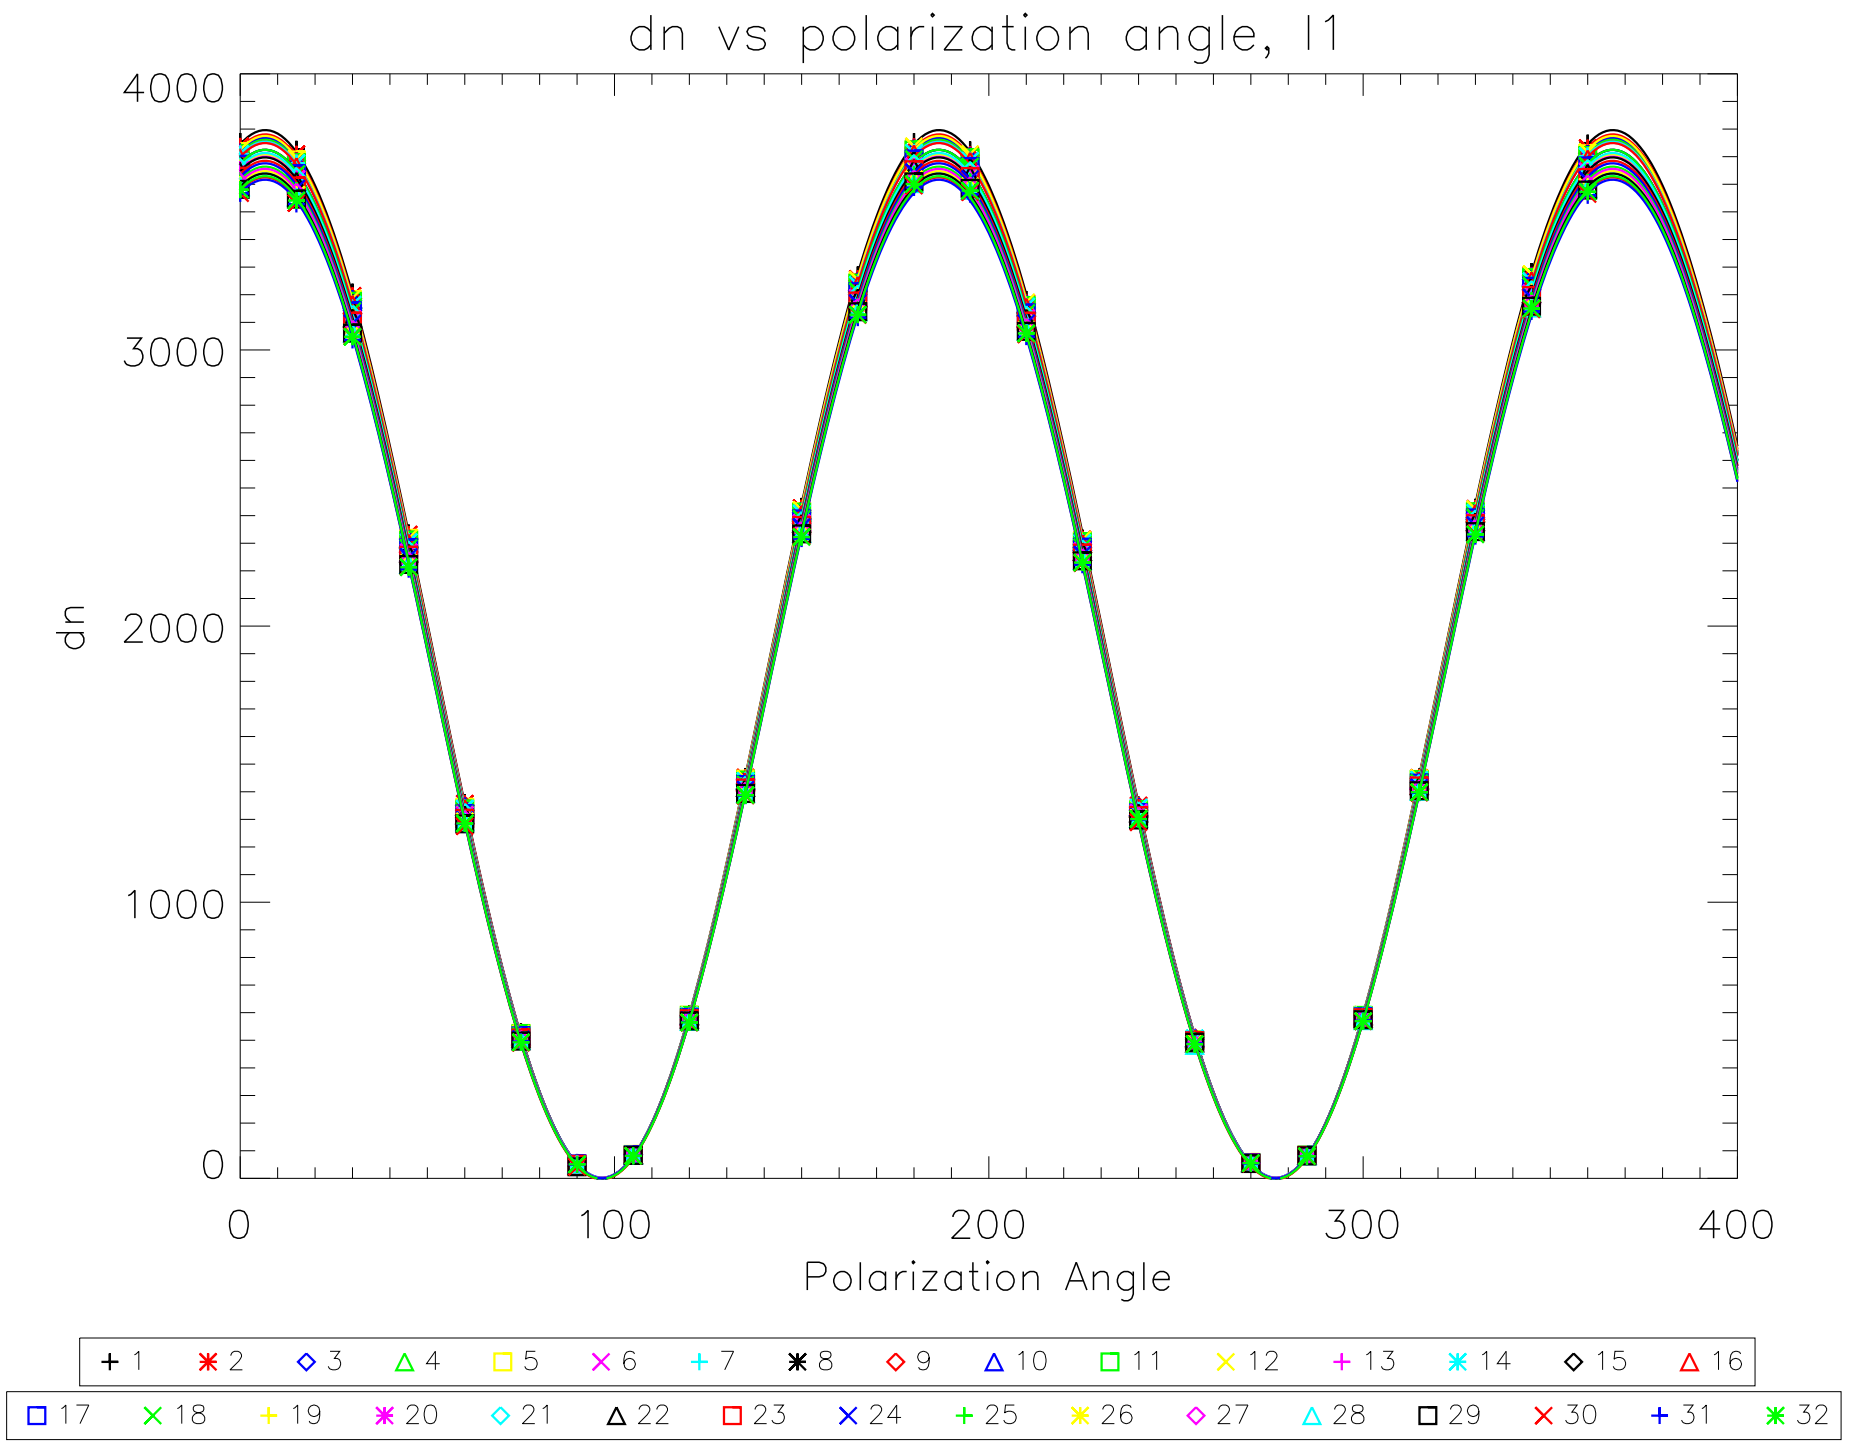
dn vs polarization angle, I1
dn
4000
3000
2000
1000
0
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

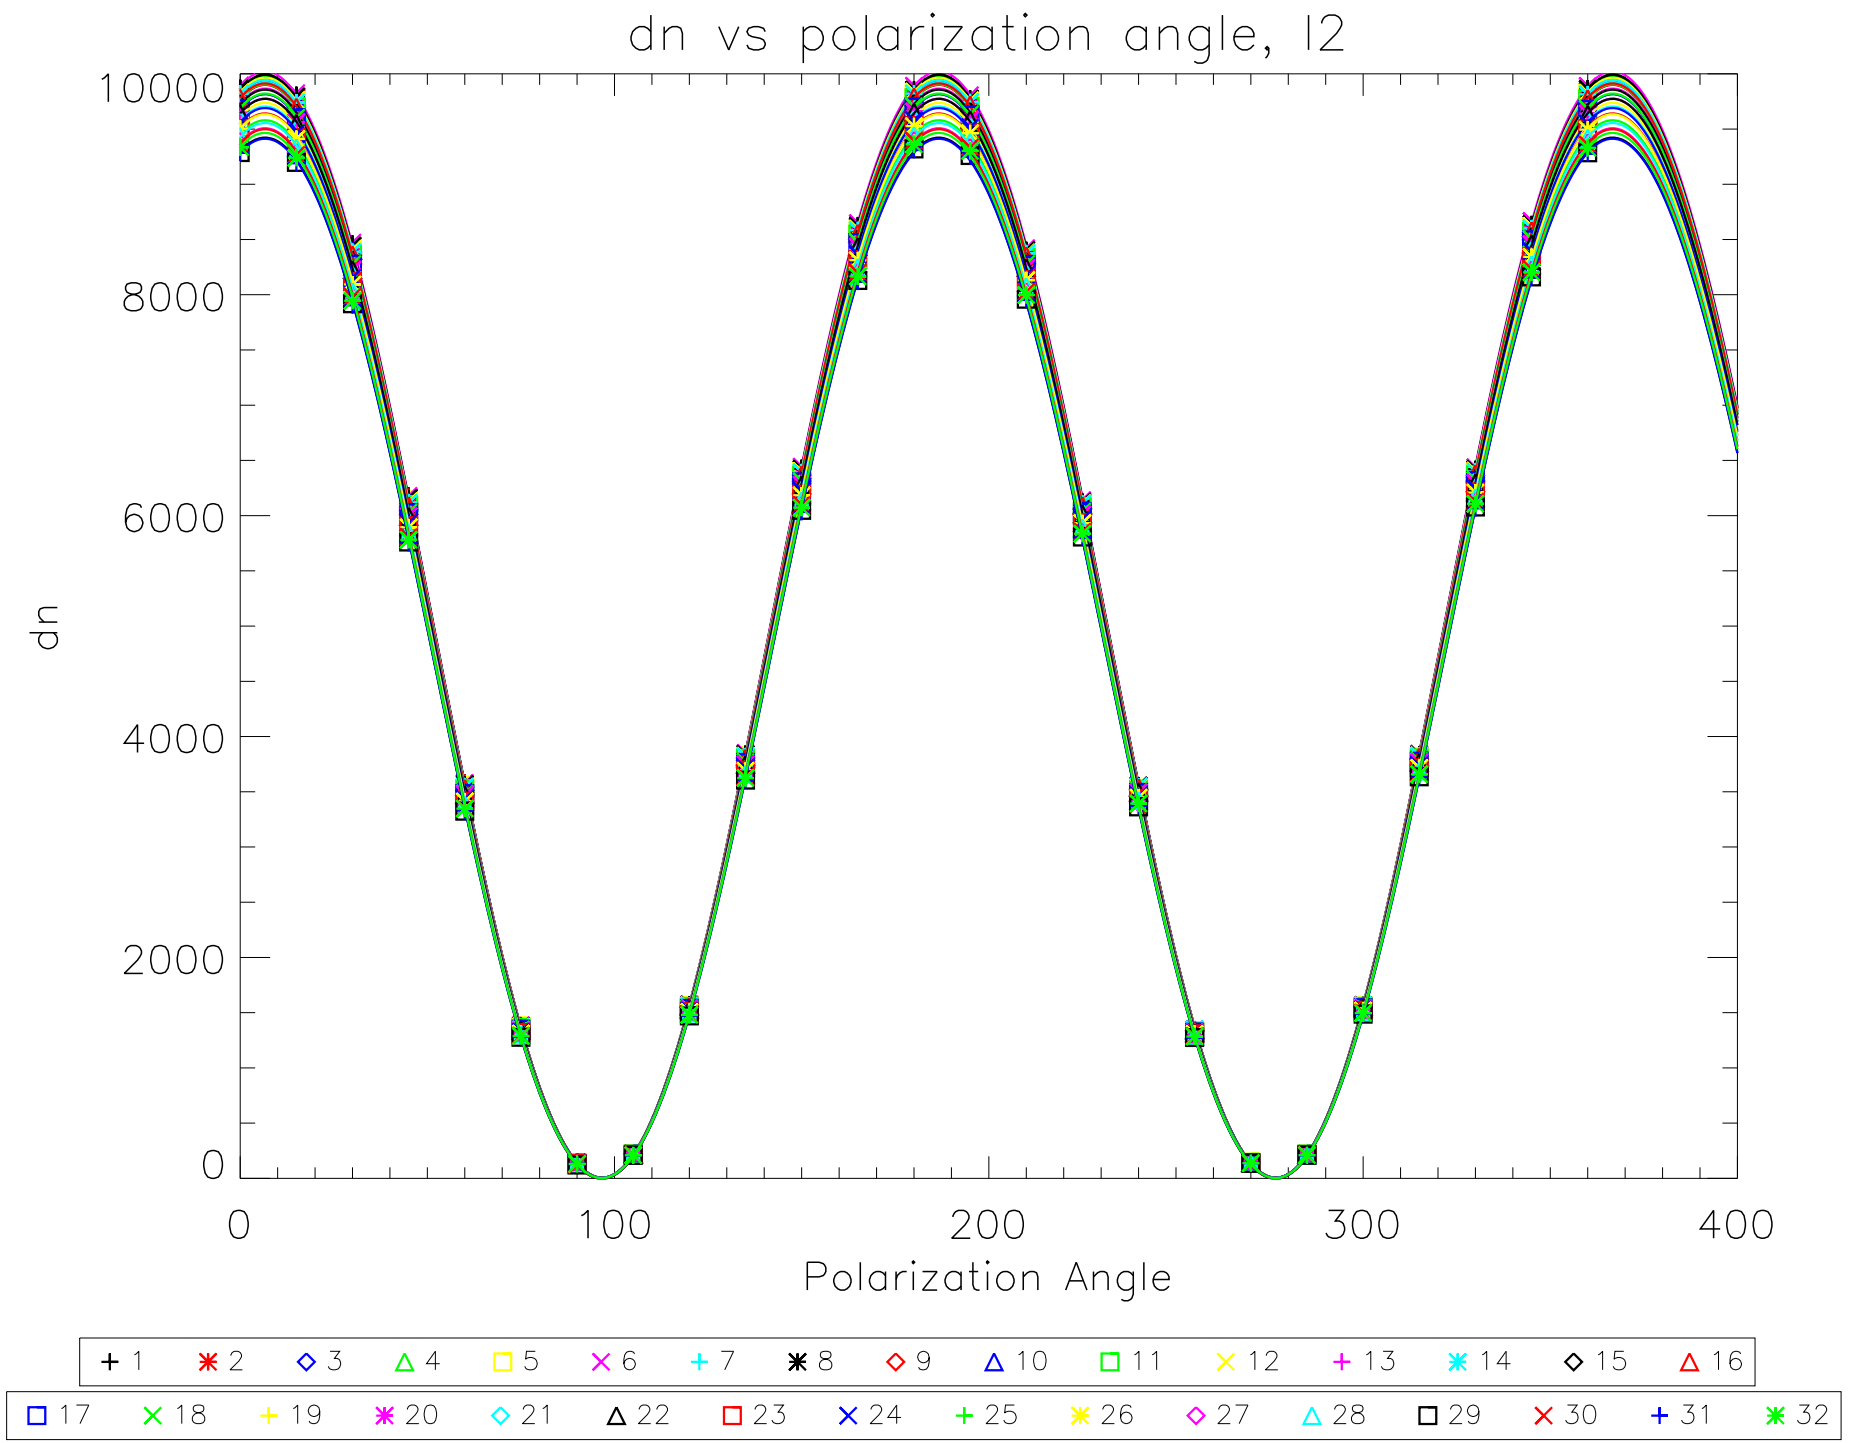
dn vs polarization angle, I2
10000
8000
6000
4000
2000
0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

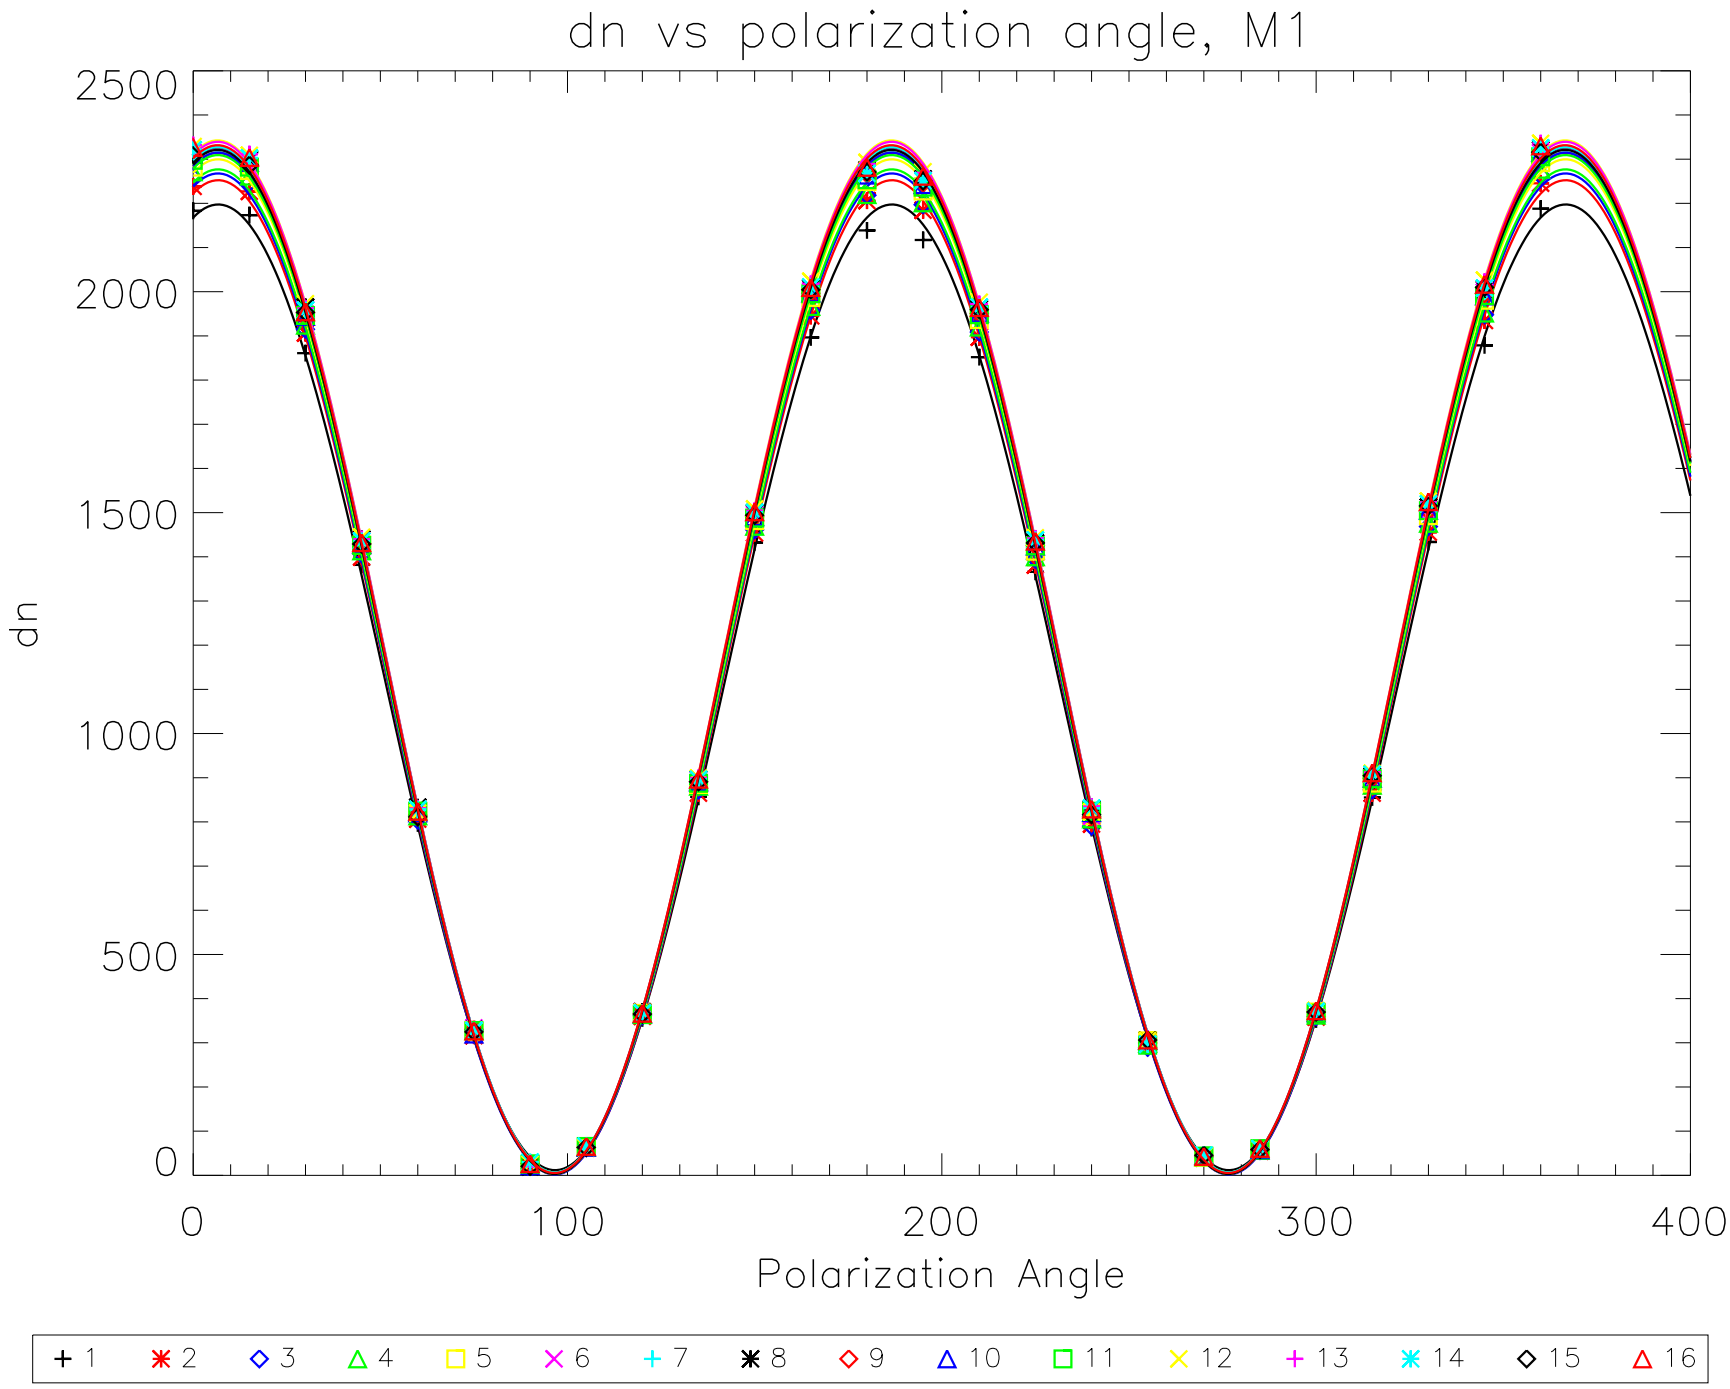
dn vs polarization angle, M1
2500
2000
1500
1000
500
0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

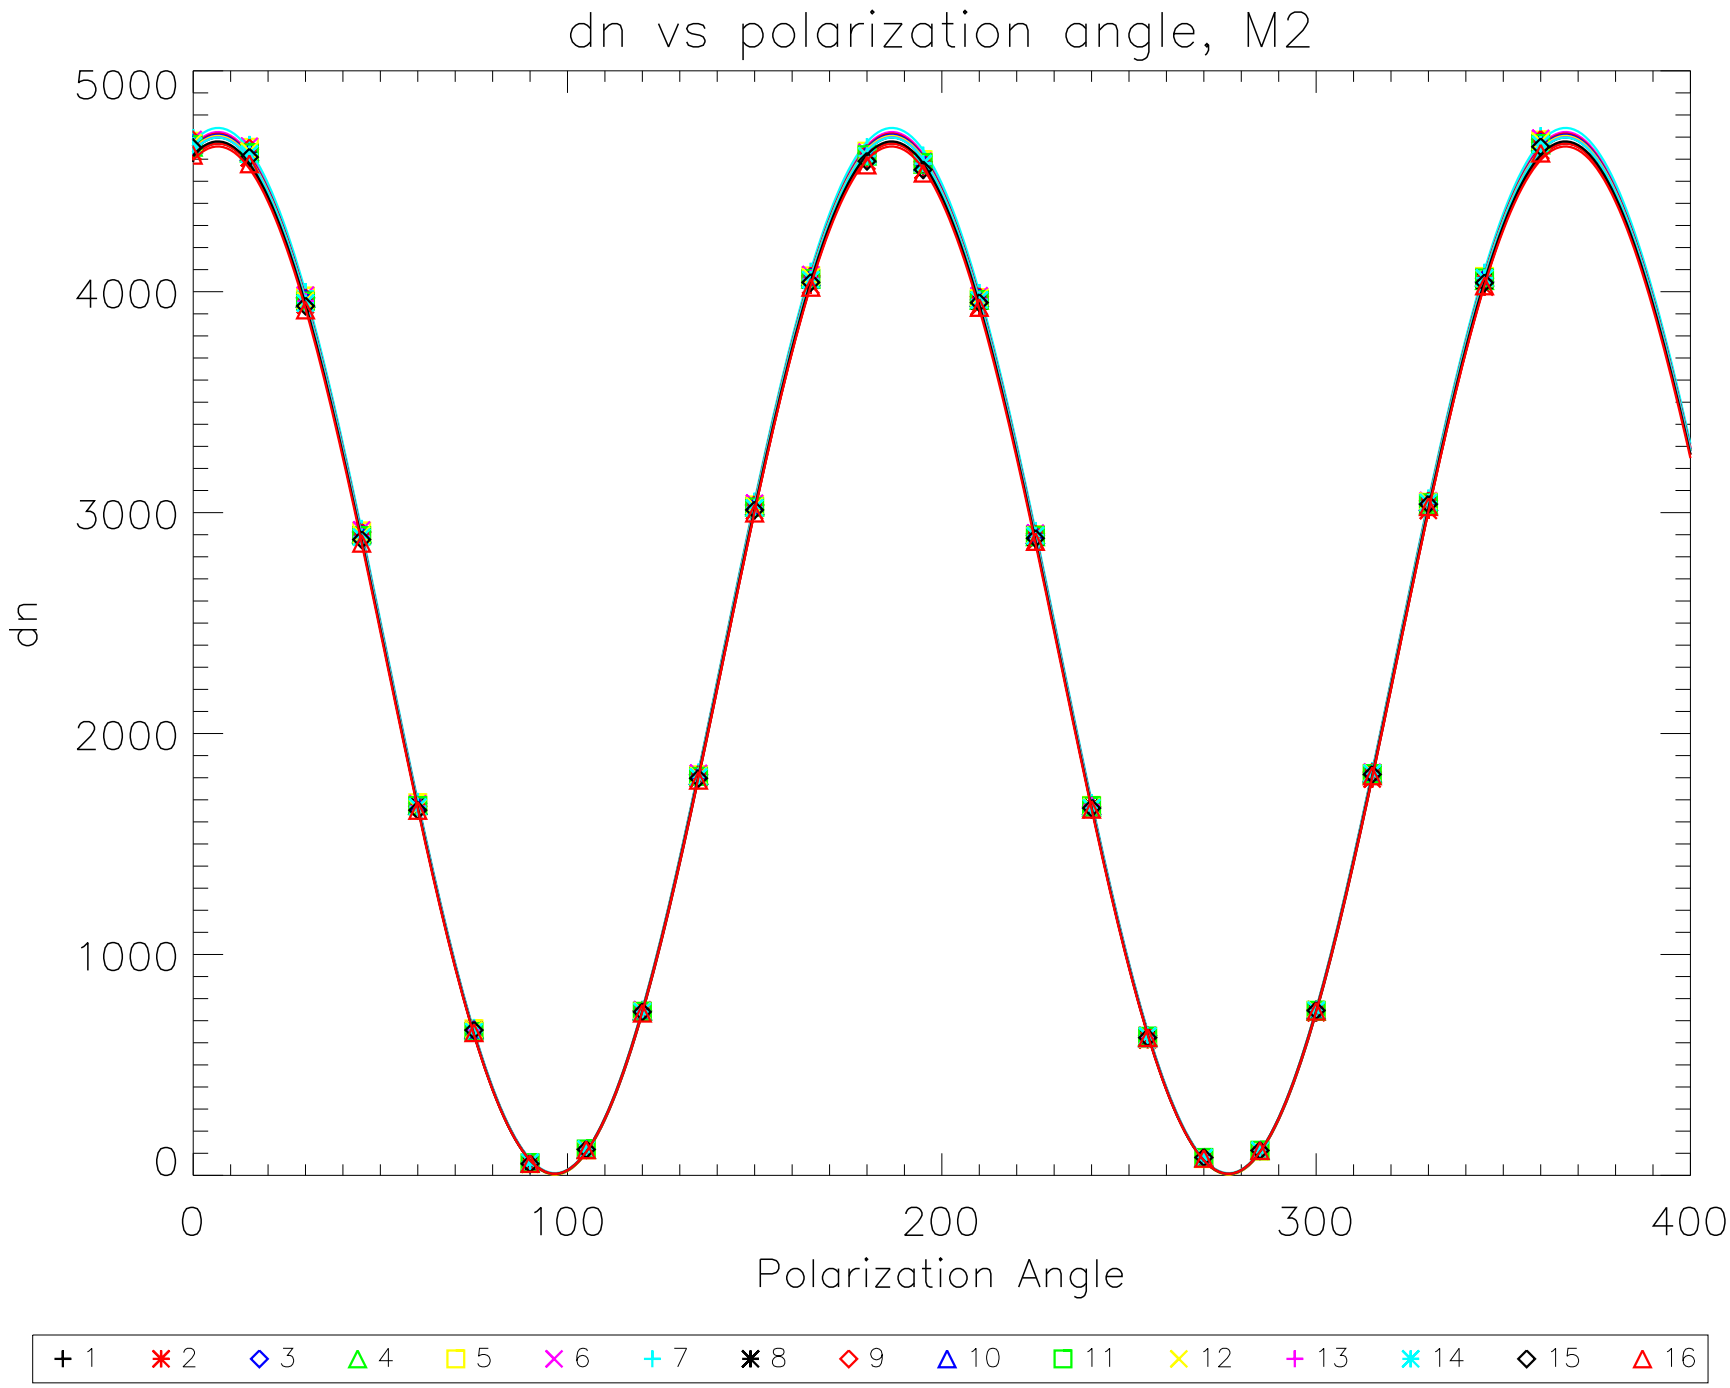
dn vs polarization angle, M2
5000
4000
3000
2000
1000
0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

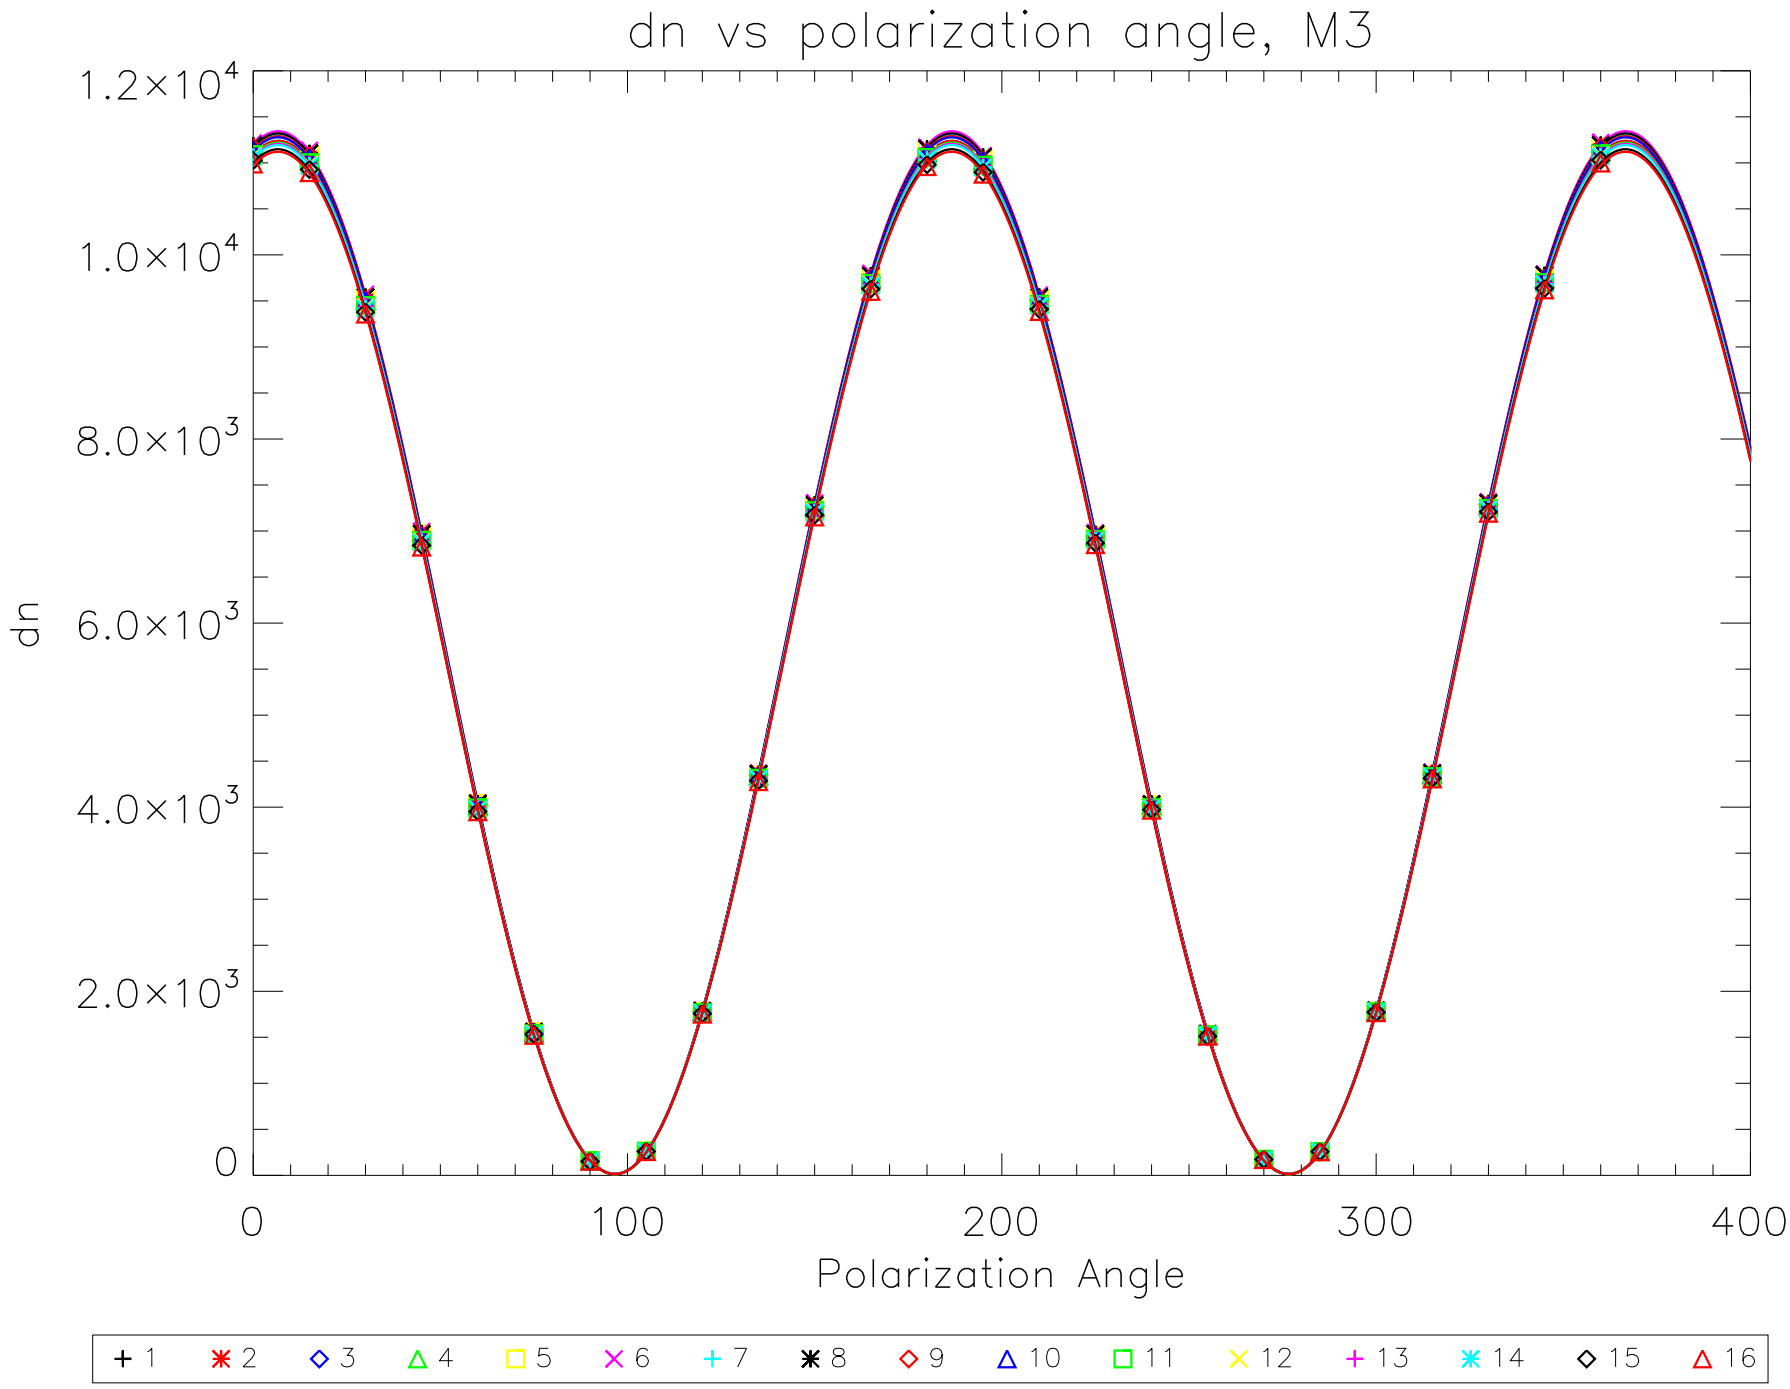
dn vs polarization angle, M3
1.2×10^4
1.0×10^4
8.0×10^3
6.0×10^3
4.0×10^3
2.0×10^3
0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

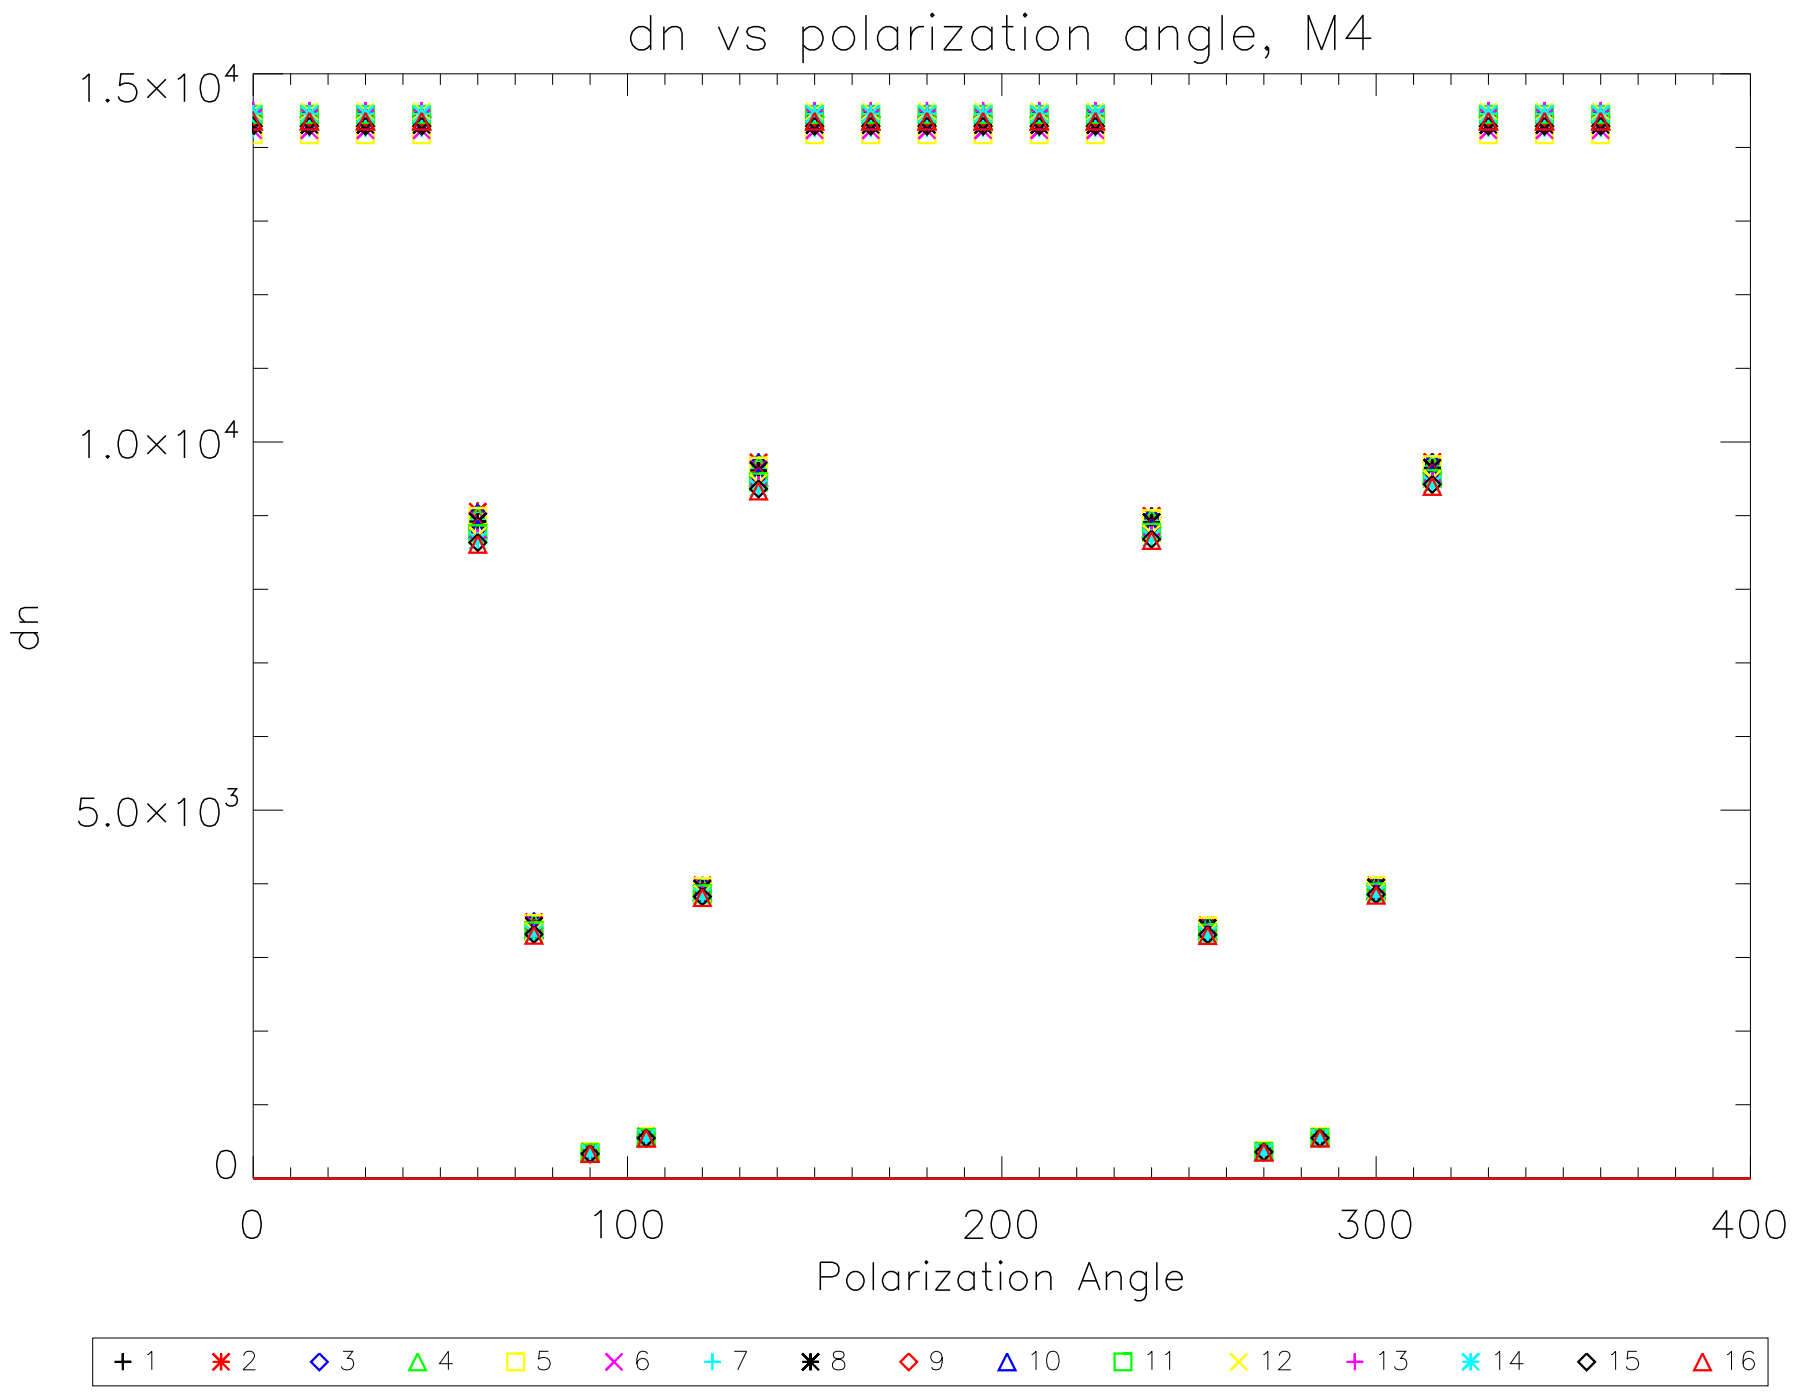
dn vs polarization angle, M4
1.5×10^4
1.0×10^4
5.0×10^3
0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

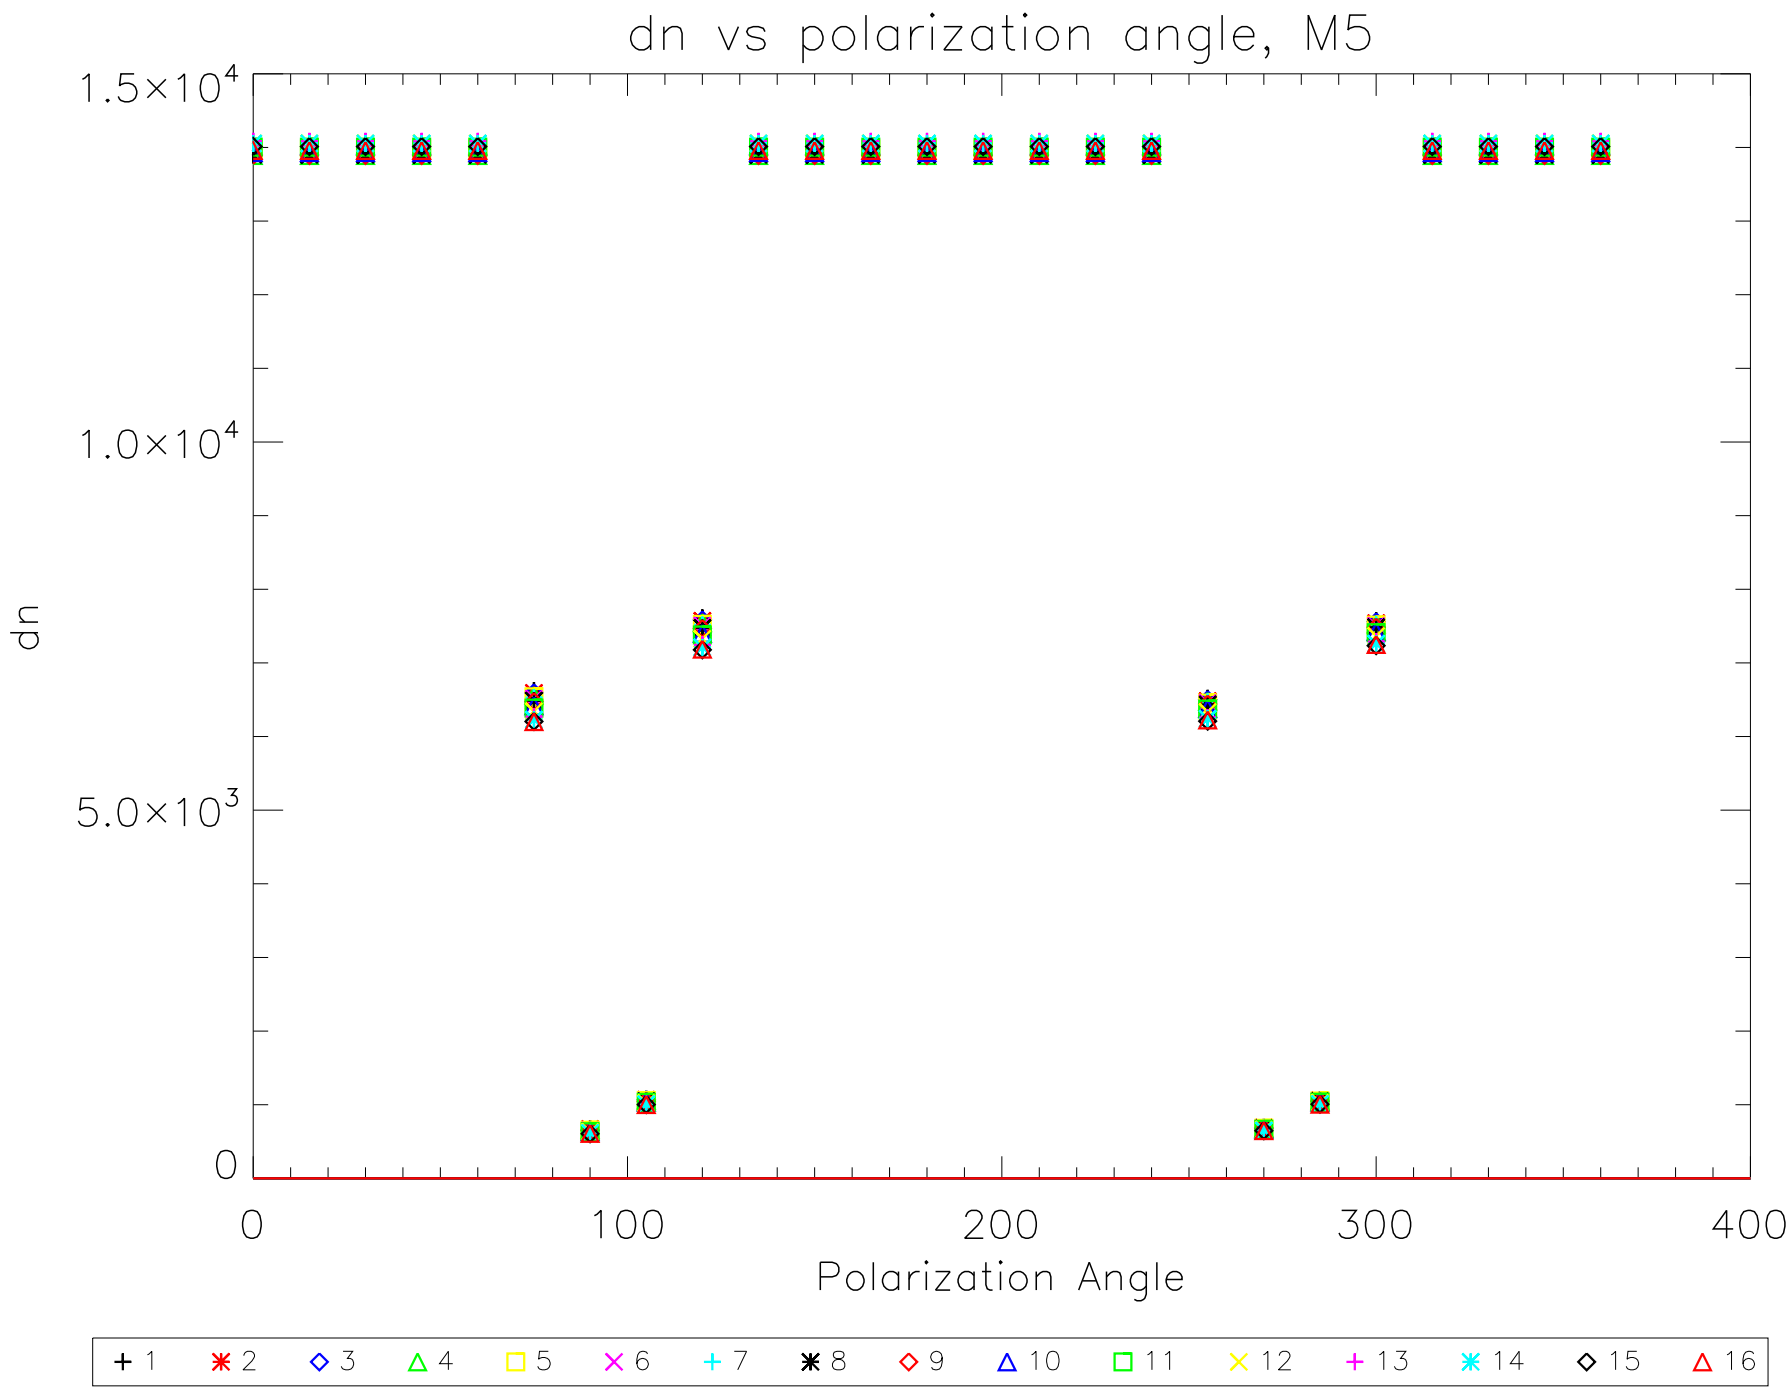
dn vs polarization angle, M5
1.5×10^4
1.0×10^4
5.0×10^3
0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

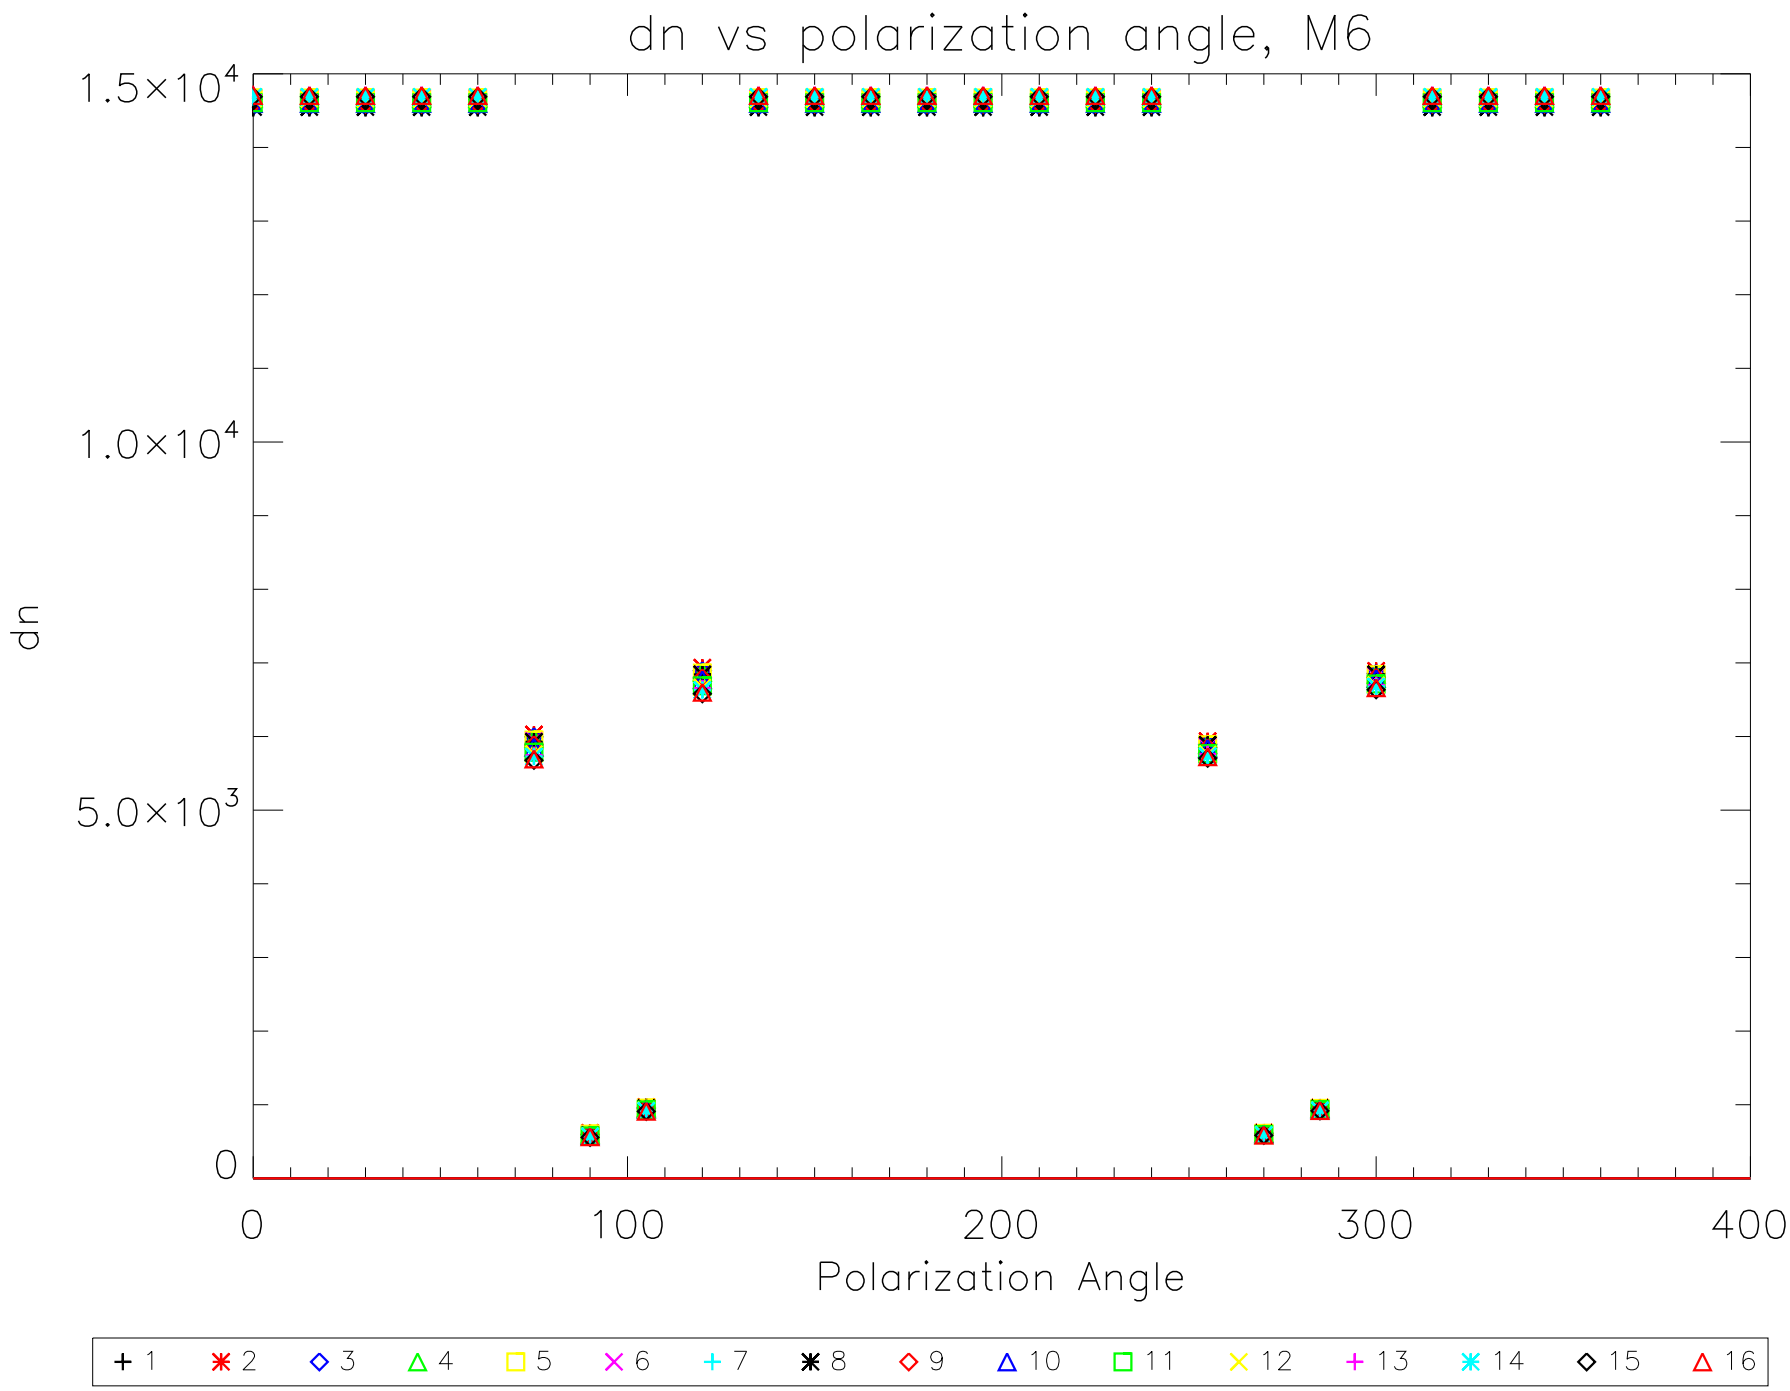
dn vs polarization angle, M6
1.5×10^4
1.0×10^4
5.0×10^3
0
dn
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

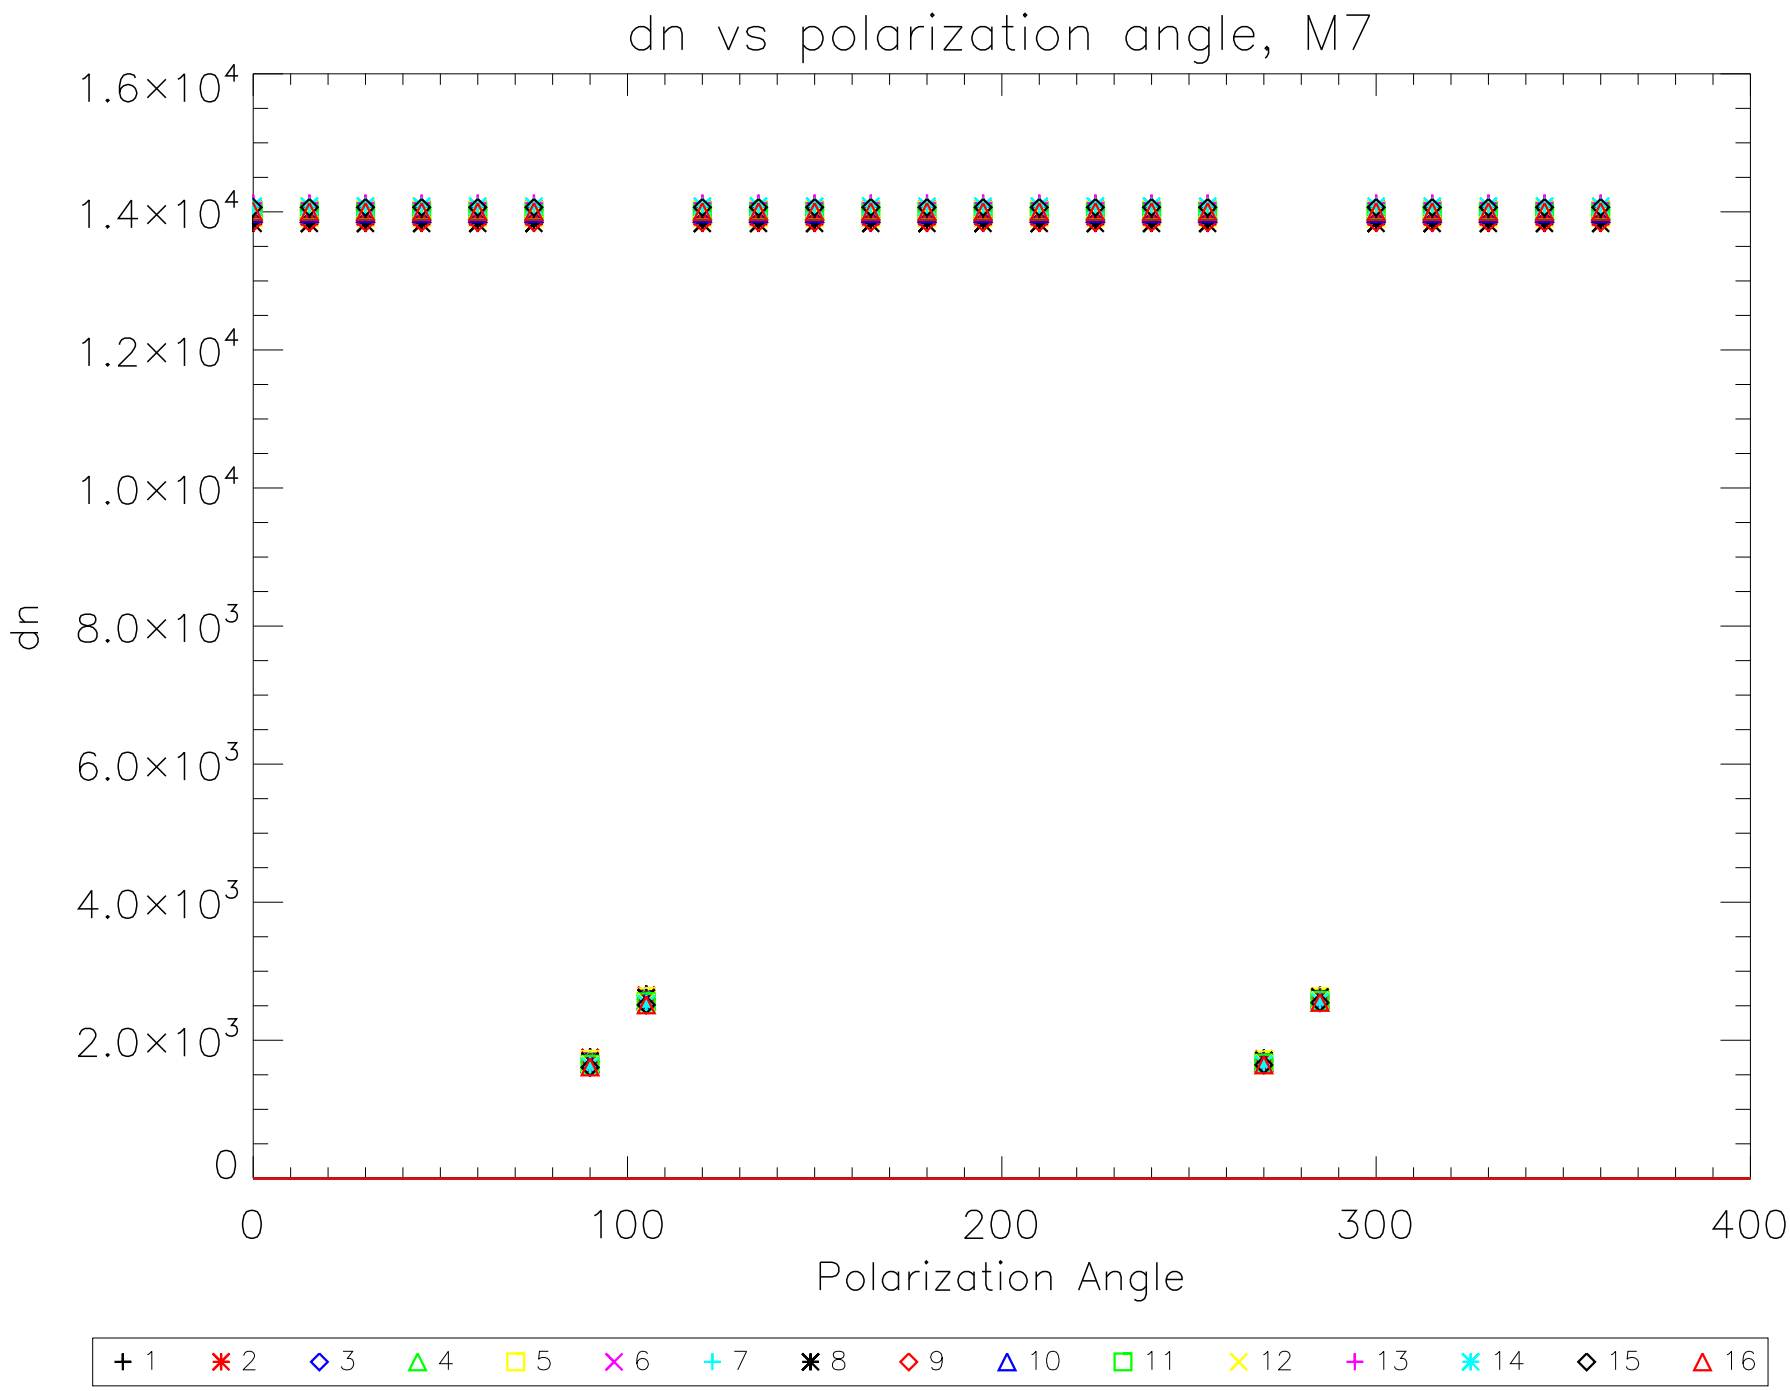
dn vs polarization angle, M7
dn
1.6×10^4
1.4×10^4
1.2×10^4
1.0×10^4
8.0×10^3
6.0×10^3
4.0×10^3
2.0×10^3
0
0
100
200
300
400
Polarization Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

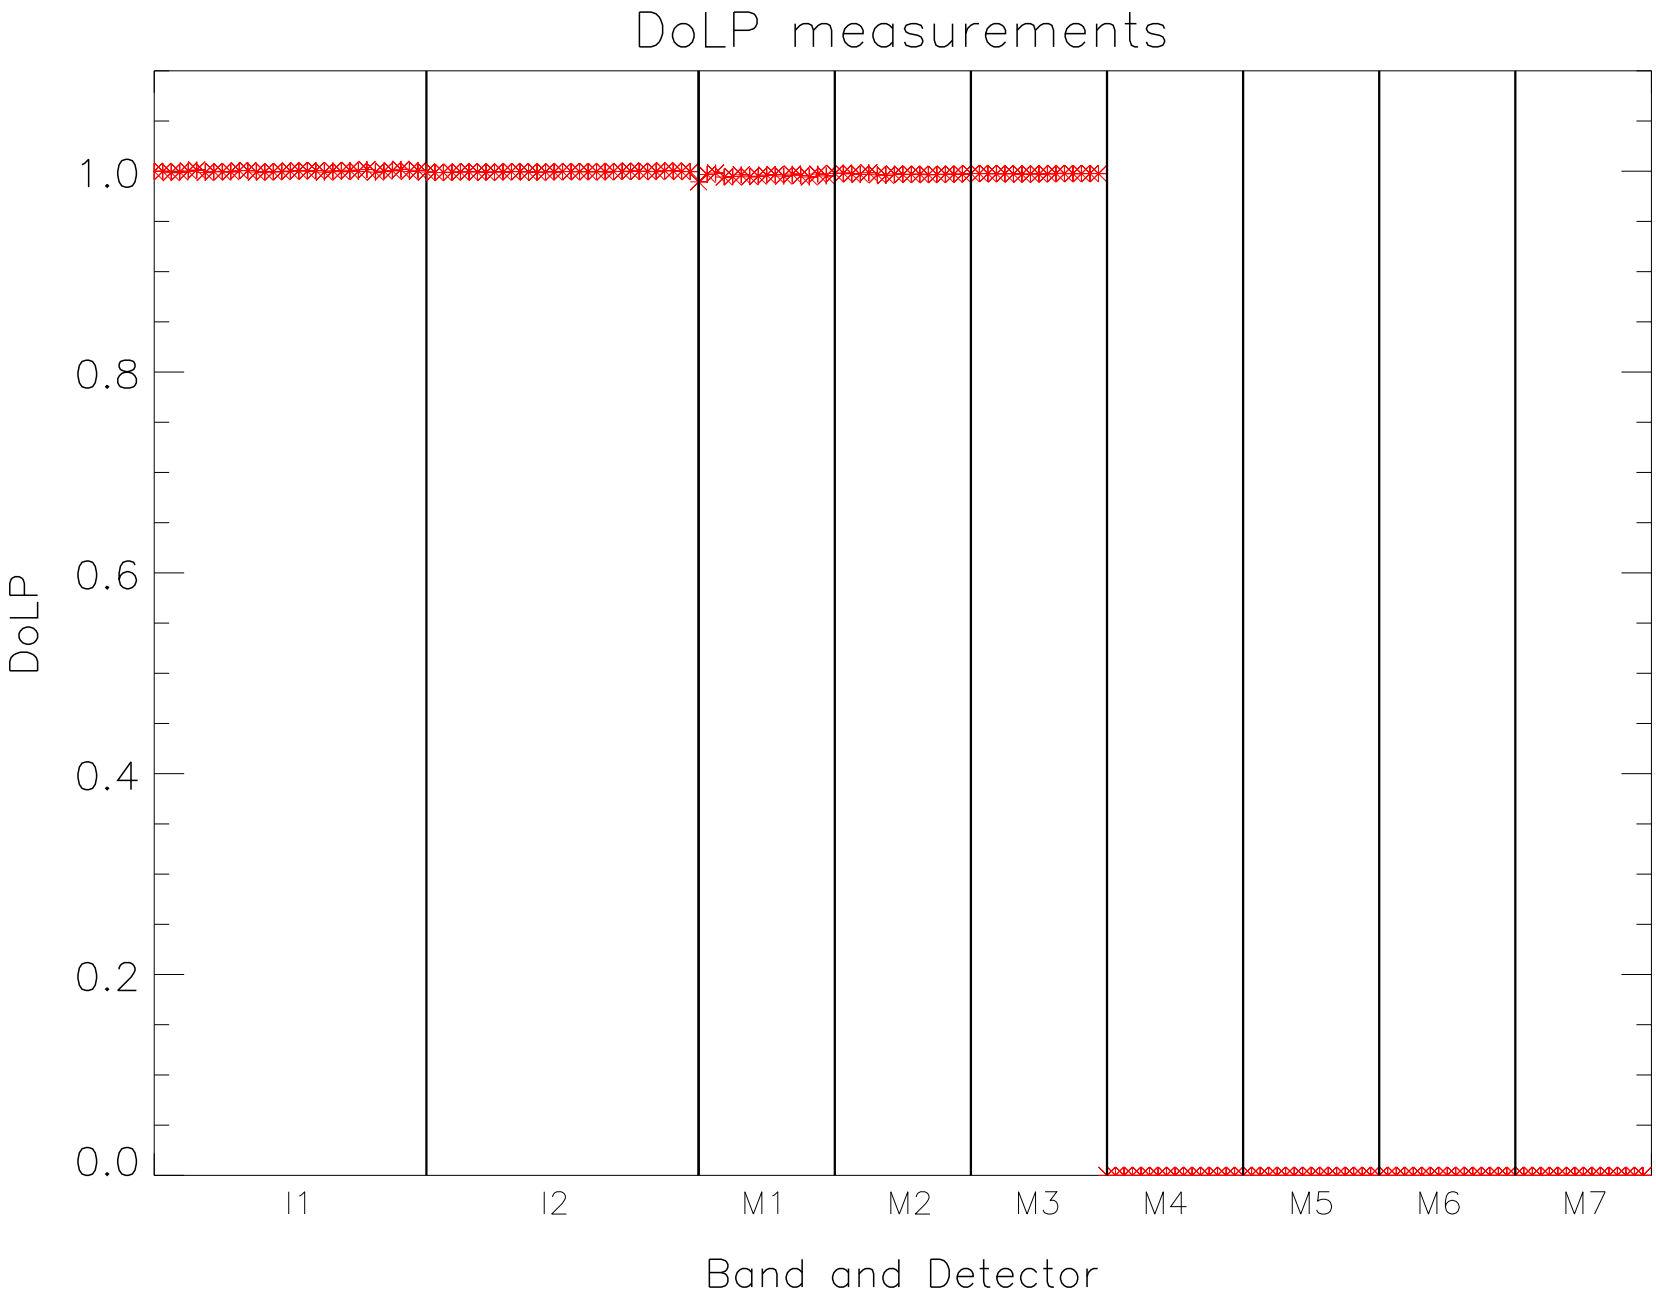
DoLP measurements
DoLP
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Band and Detector

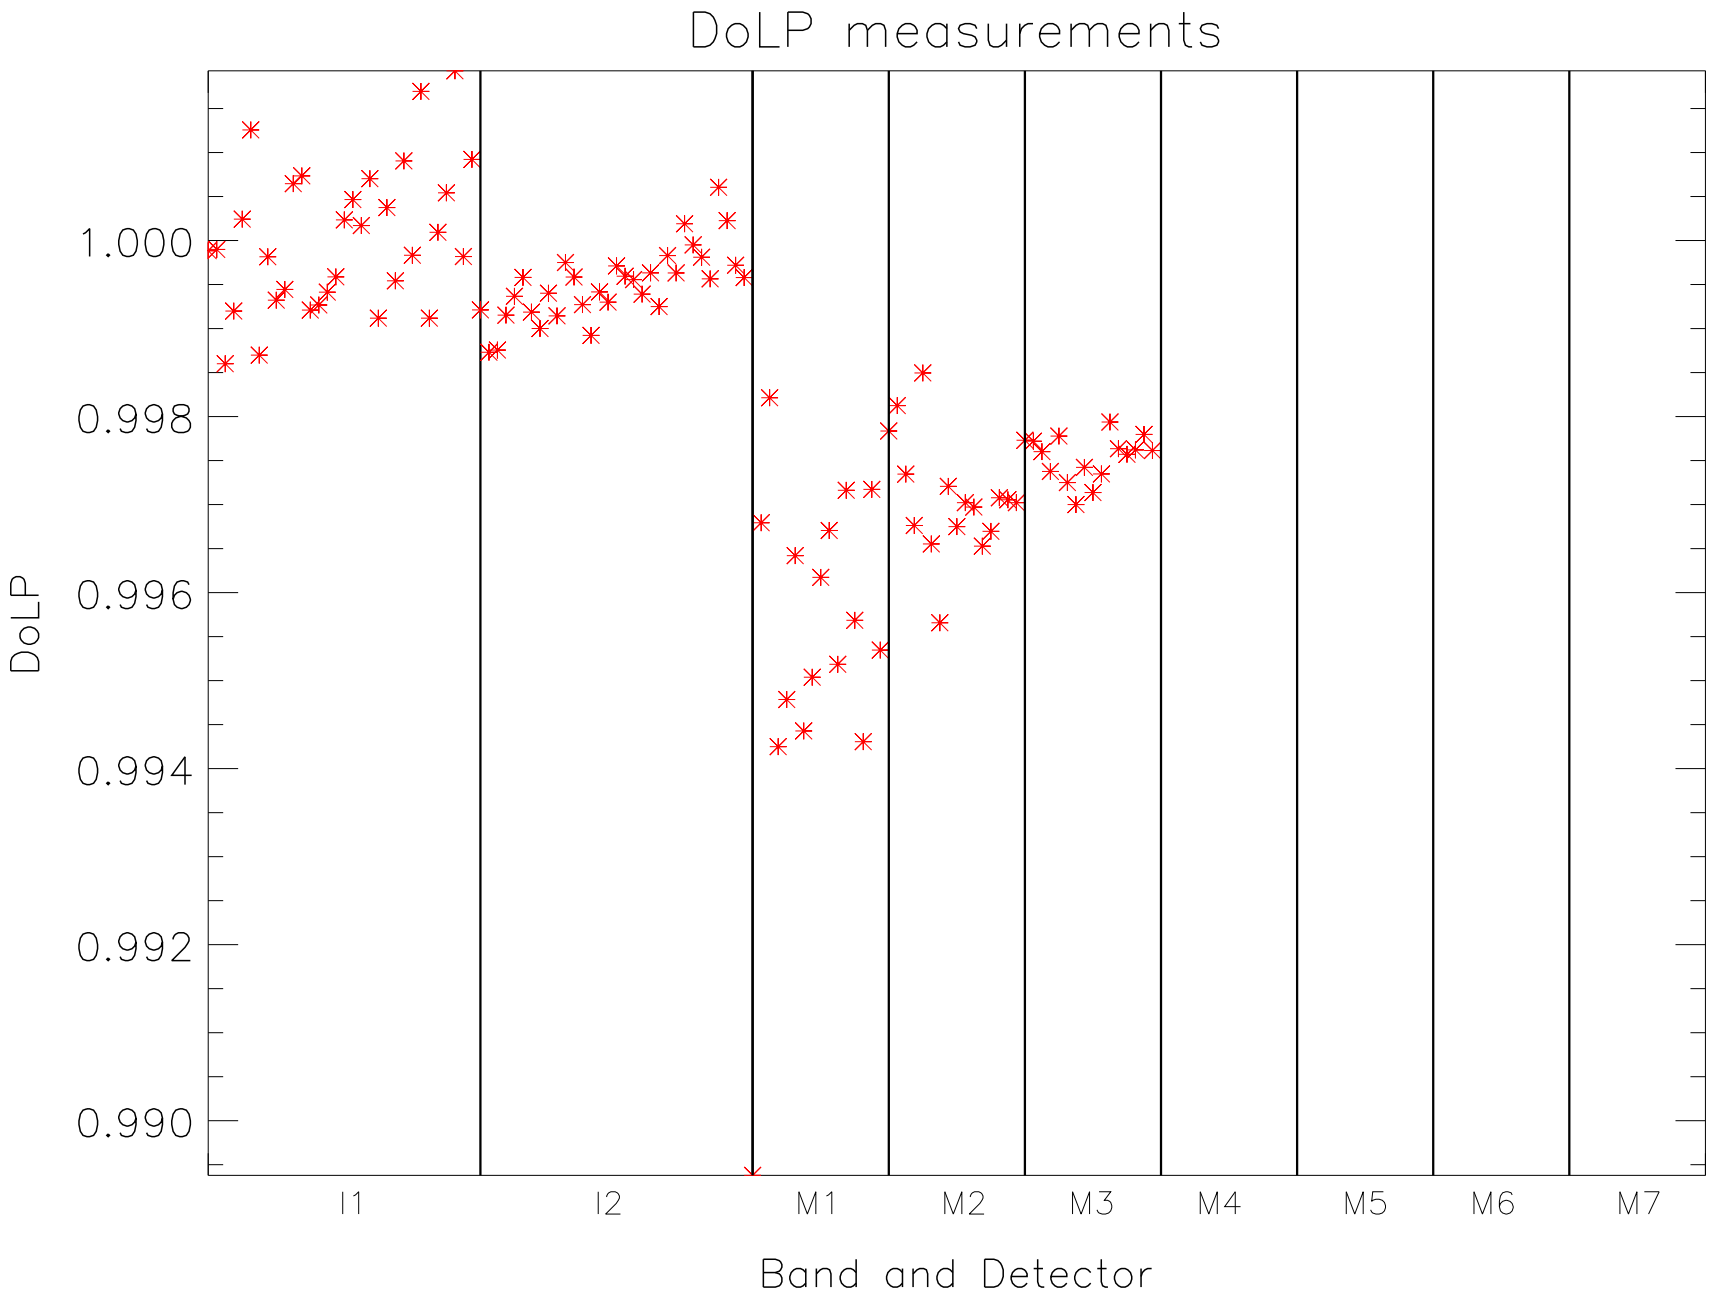
DoLP measurements
DoLP
1.000
0.998
0.996
0.994
0.992
0.990
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Band and Detector