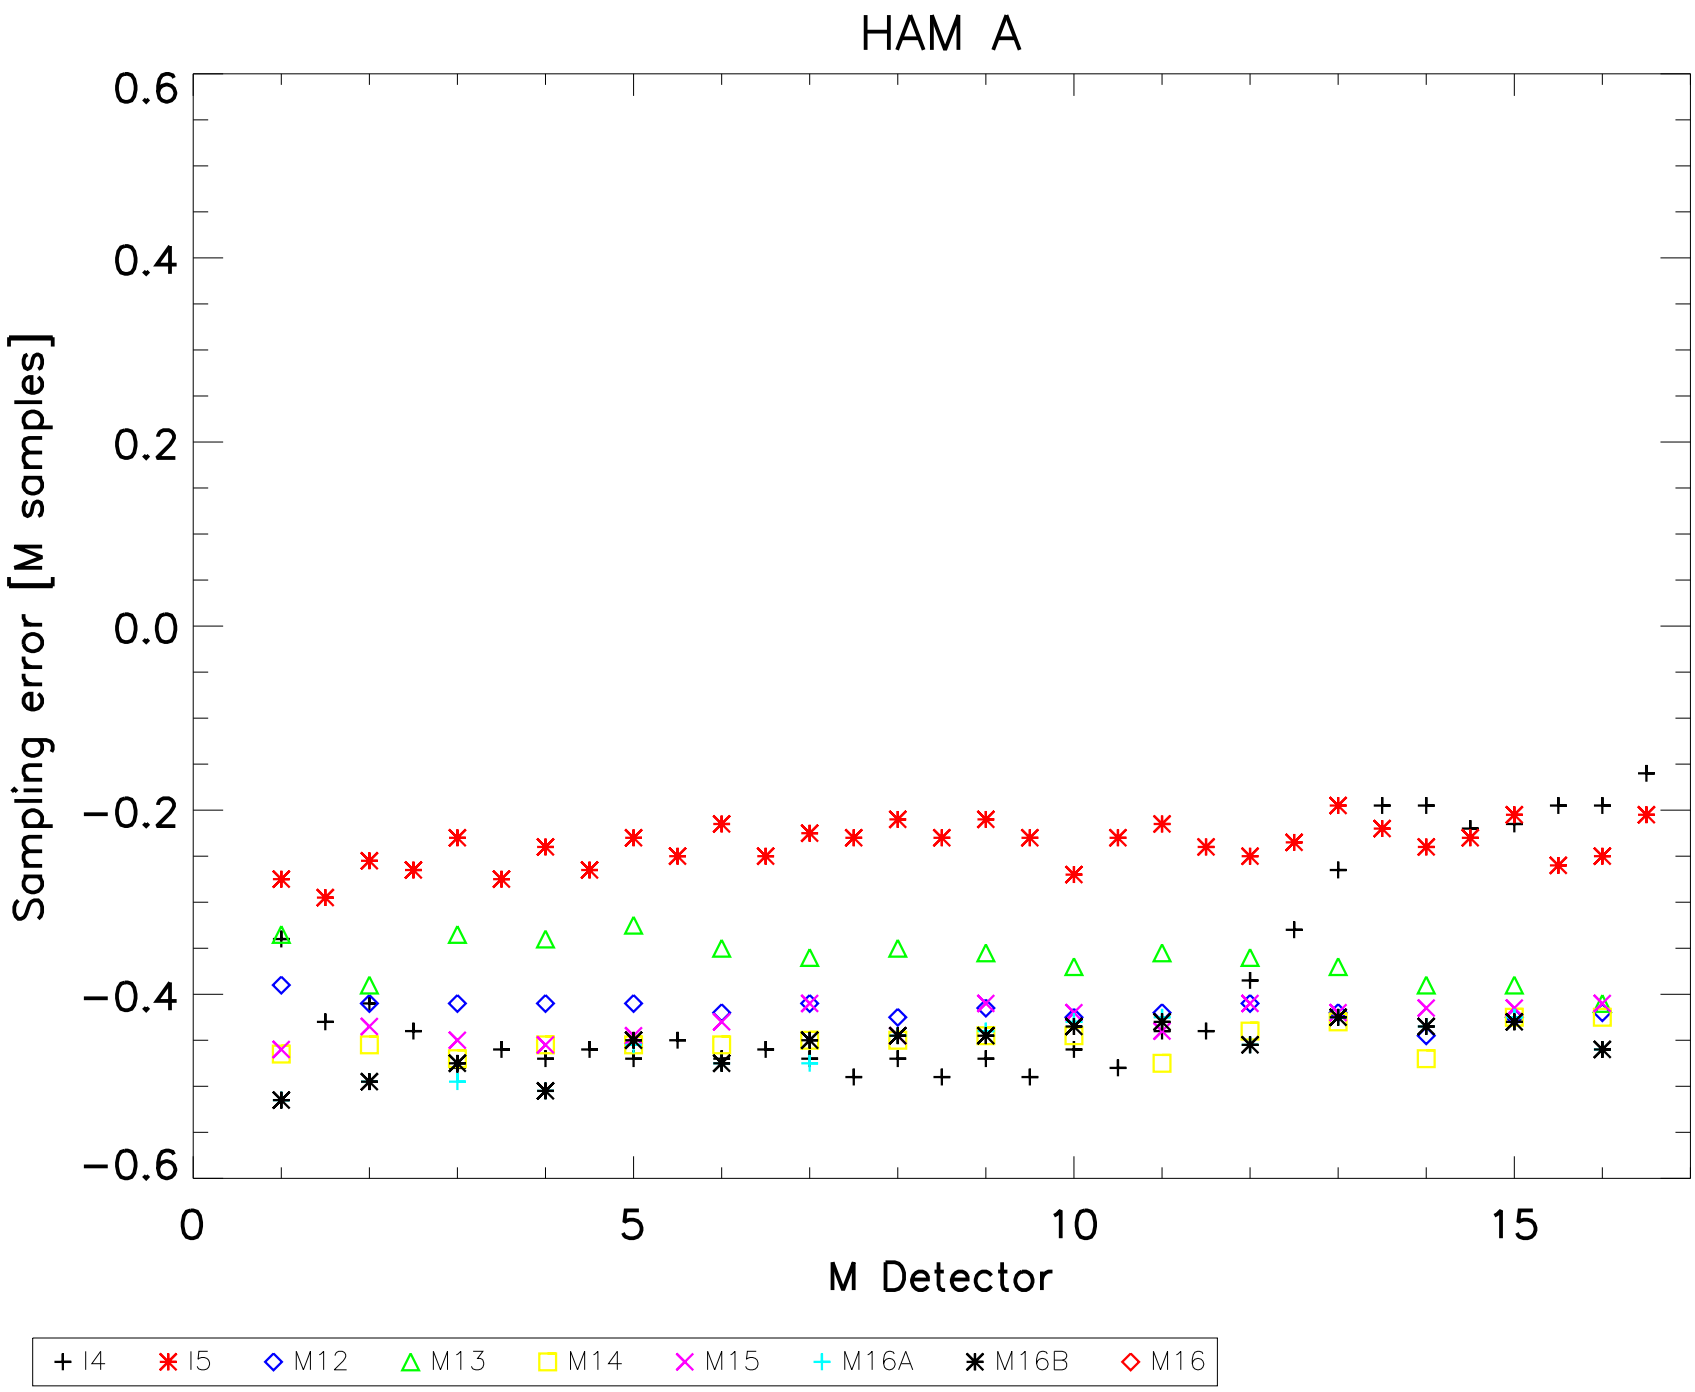
HAM A
Sampling error [M samples]
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
5
10
15
M Detector
I4
I5
M12
M13
M14
M15
M16A
M16B
M16

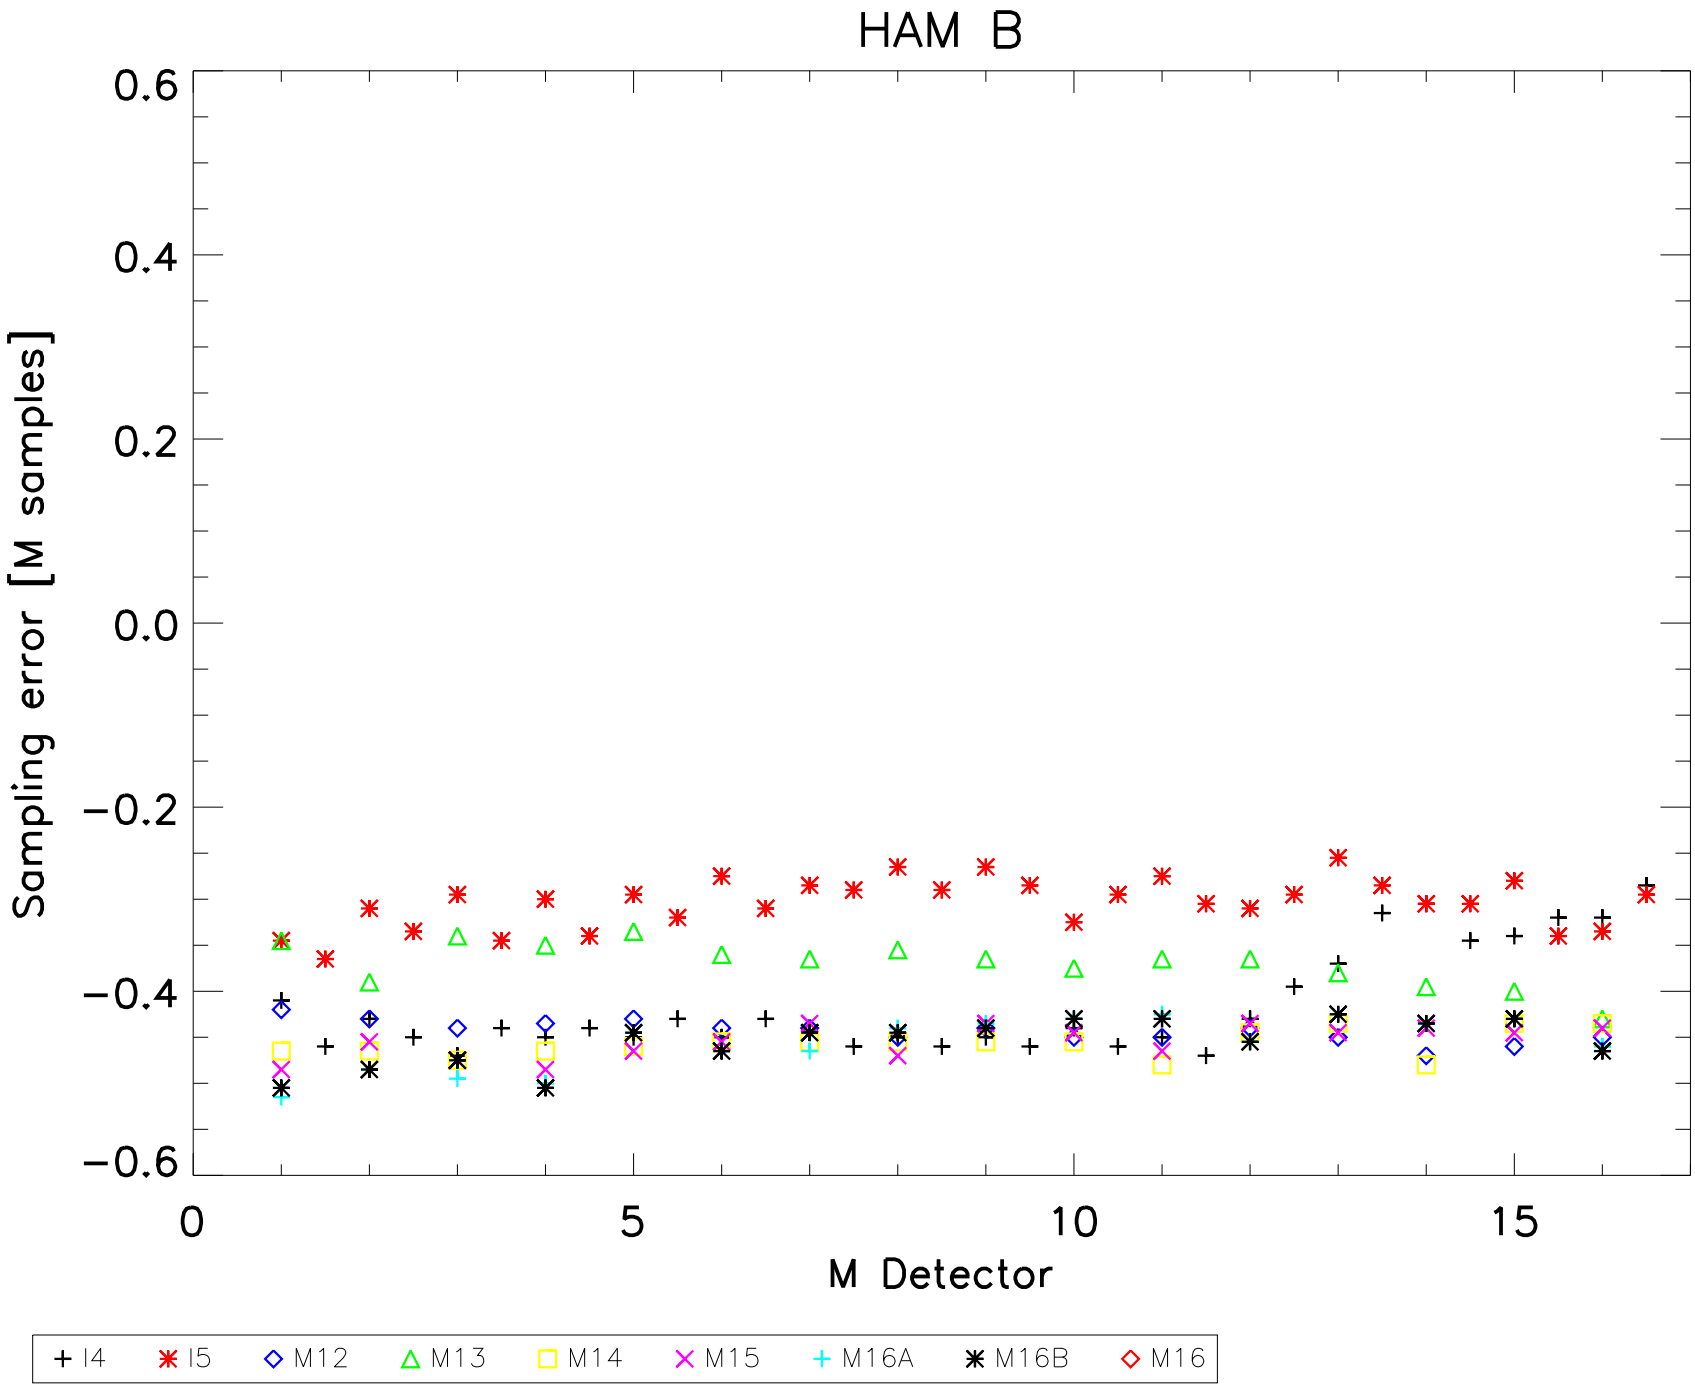
HAM B
Sampling error [M samples]
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
5
10
15
M Detector
I4
I5
M12
M13
M14
M15
M16A
M16B
M16

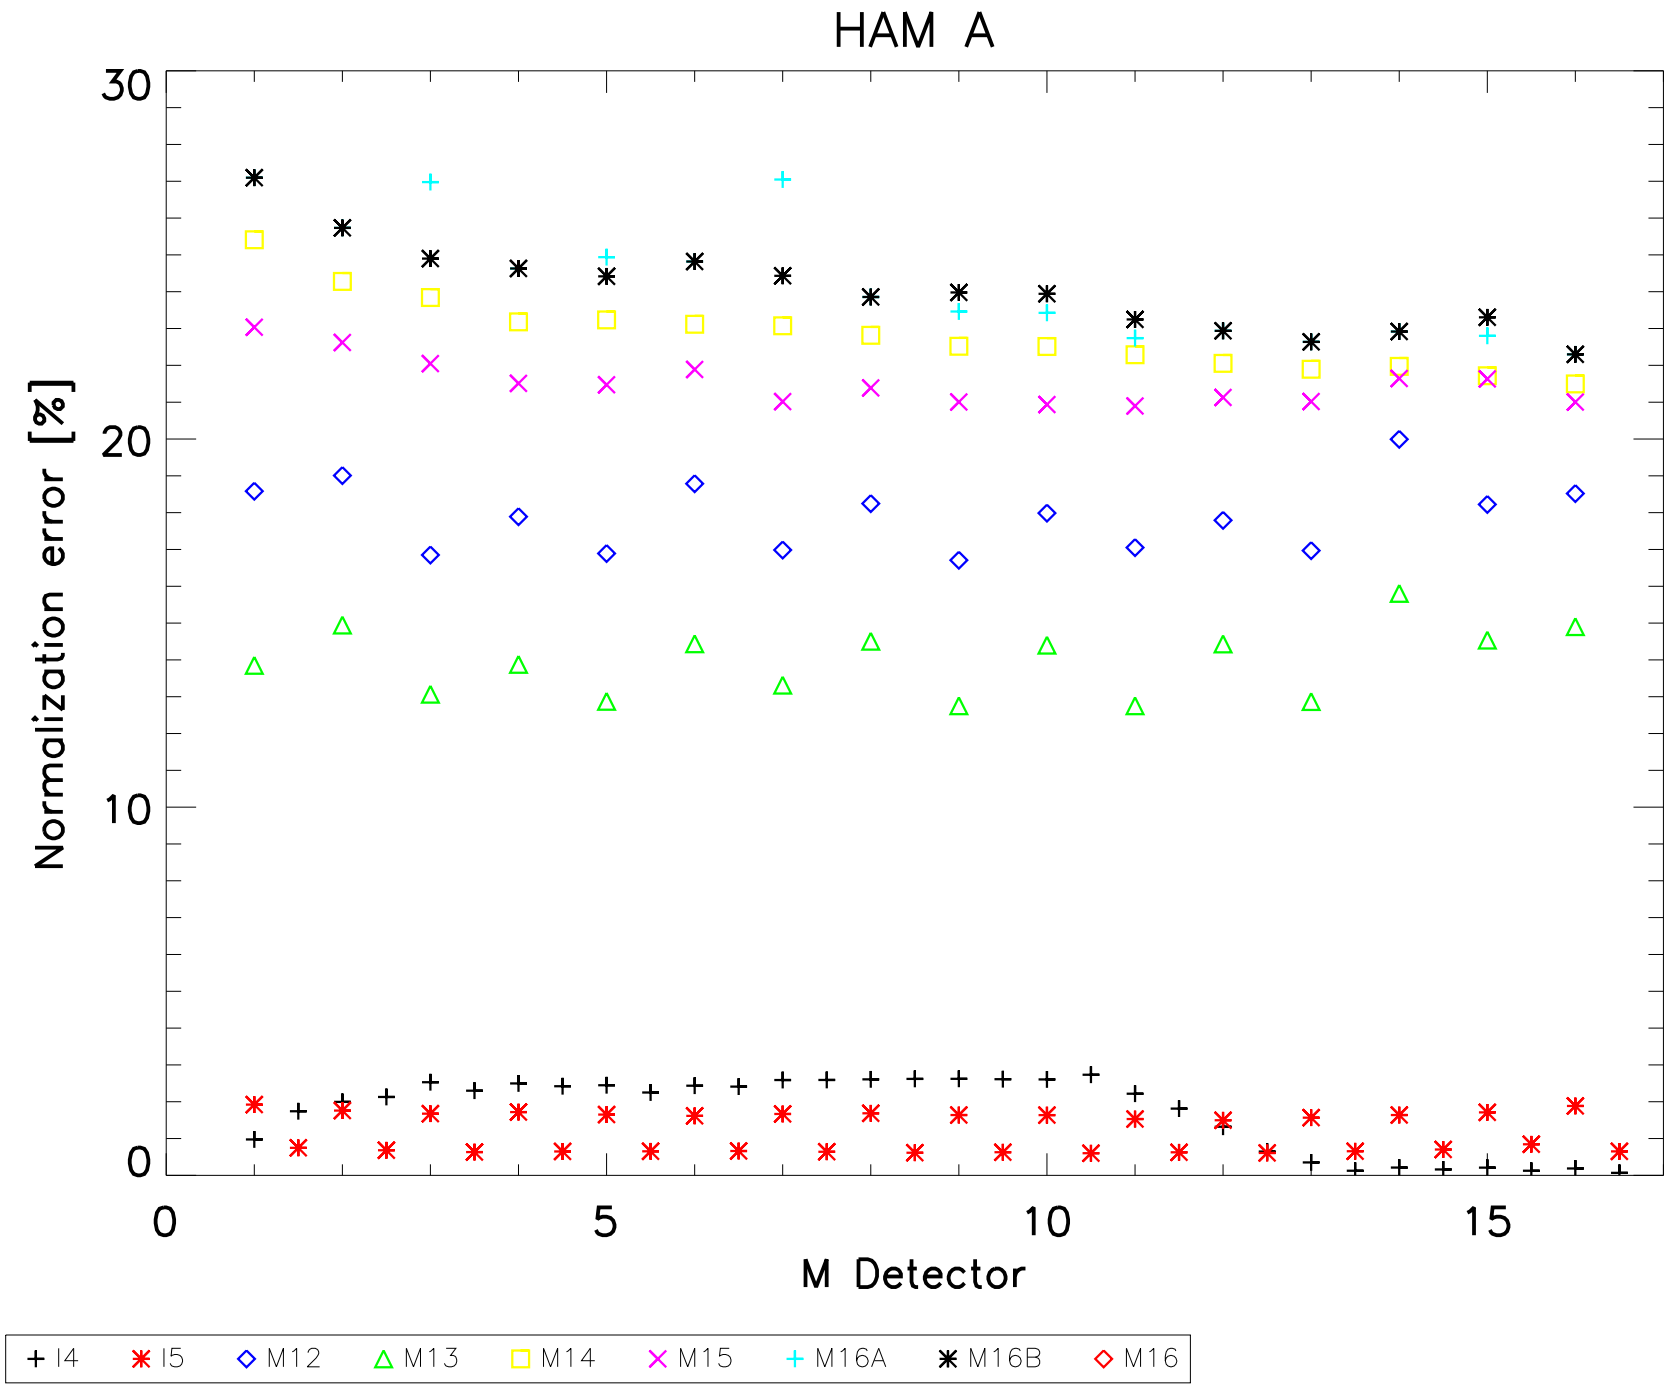
HAM A
Normalization error [%]
30
20
10
0
0
5
10
15
M Detector
I4
I5
M12
M13
M14
M15
M16A
M16B
M16

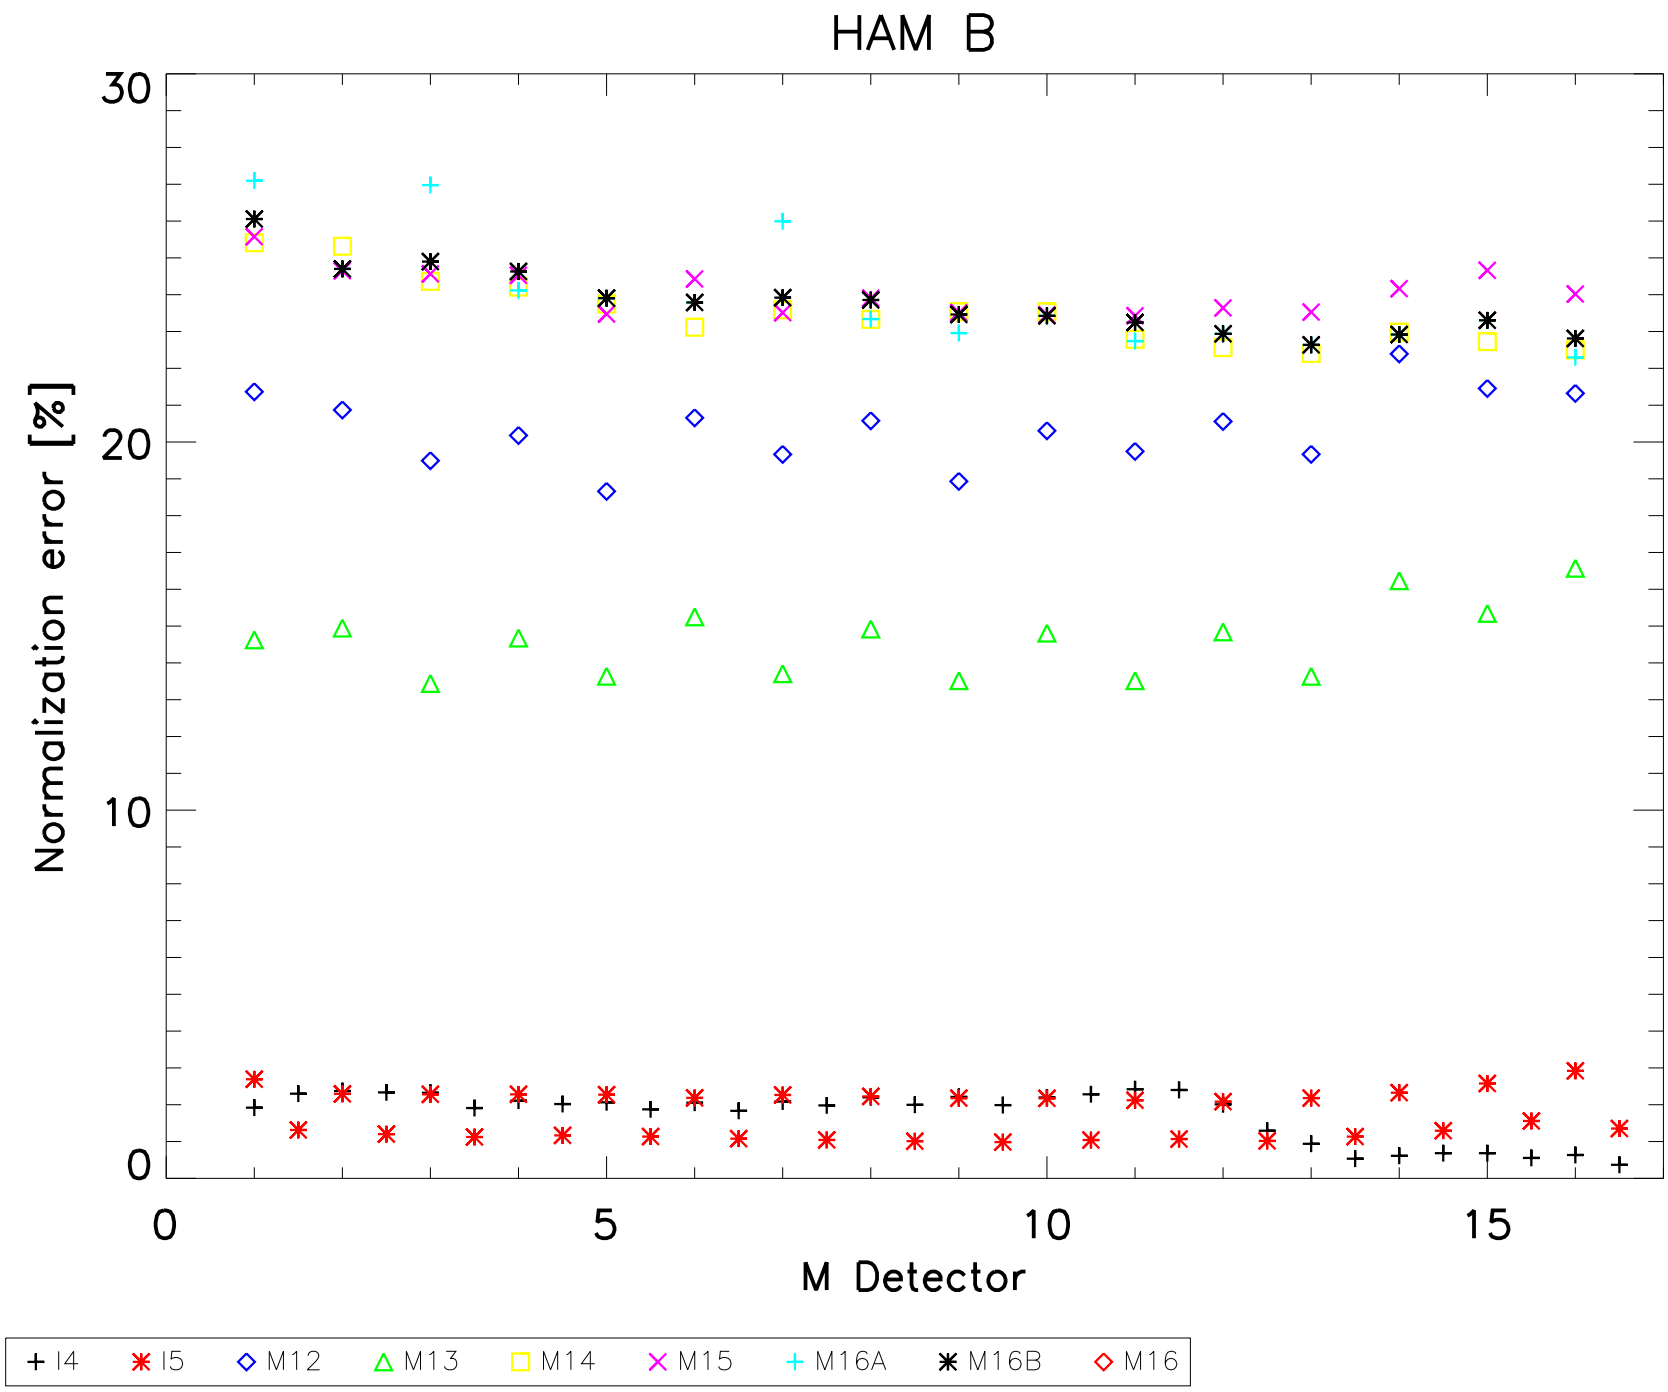
HAM B
Normalization error [%]
30
20
10
0
0
5
10
15
M Detector
I4
I5
M12
M13
M14
M15
M16A
M16B
M16