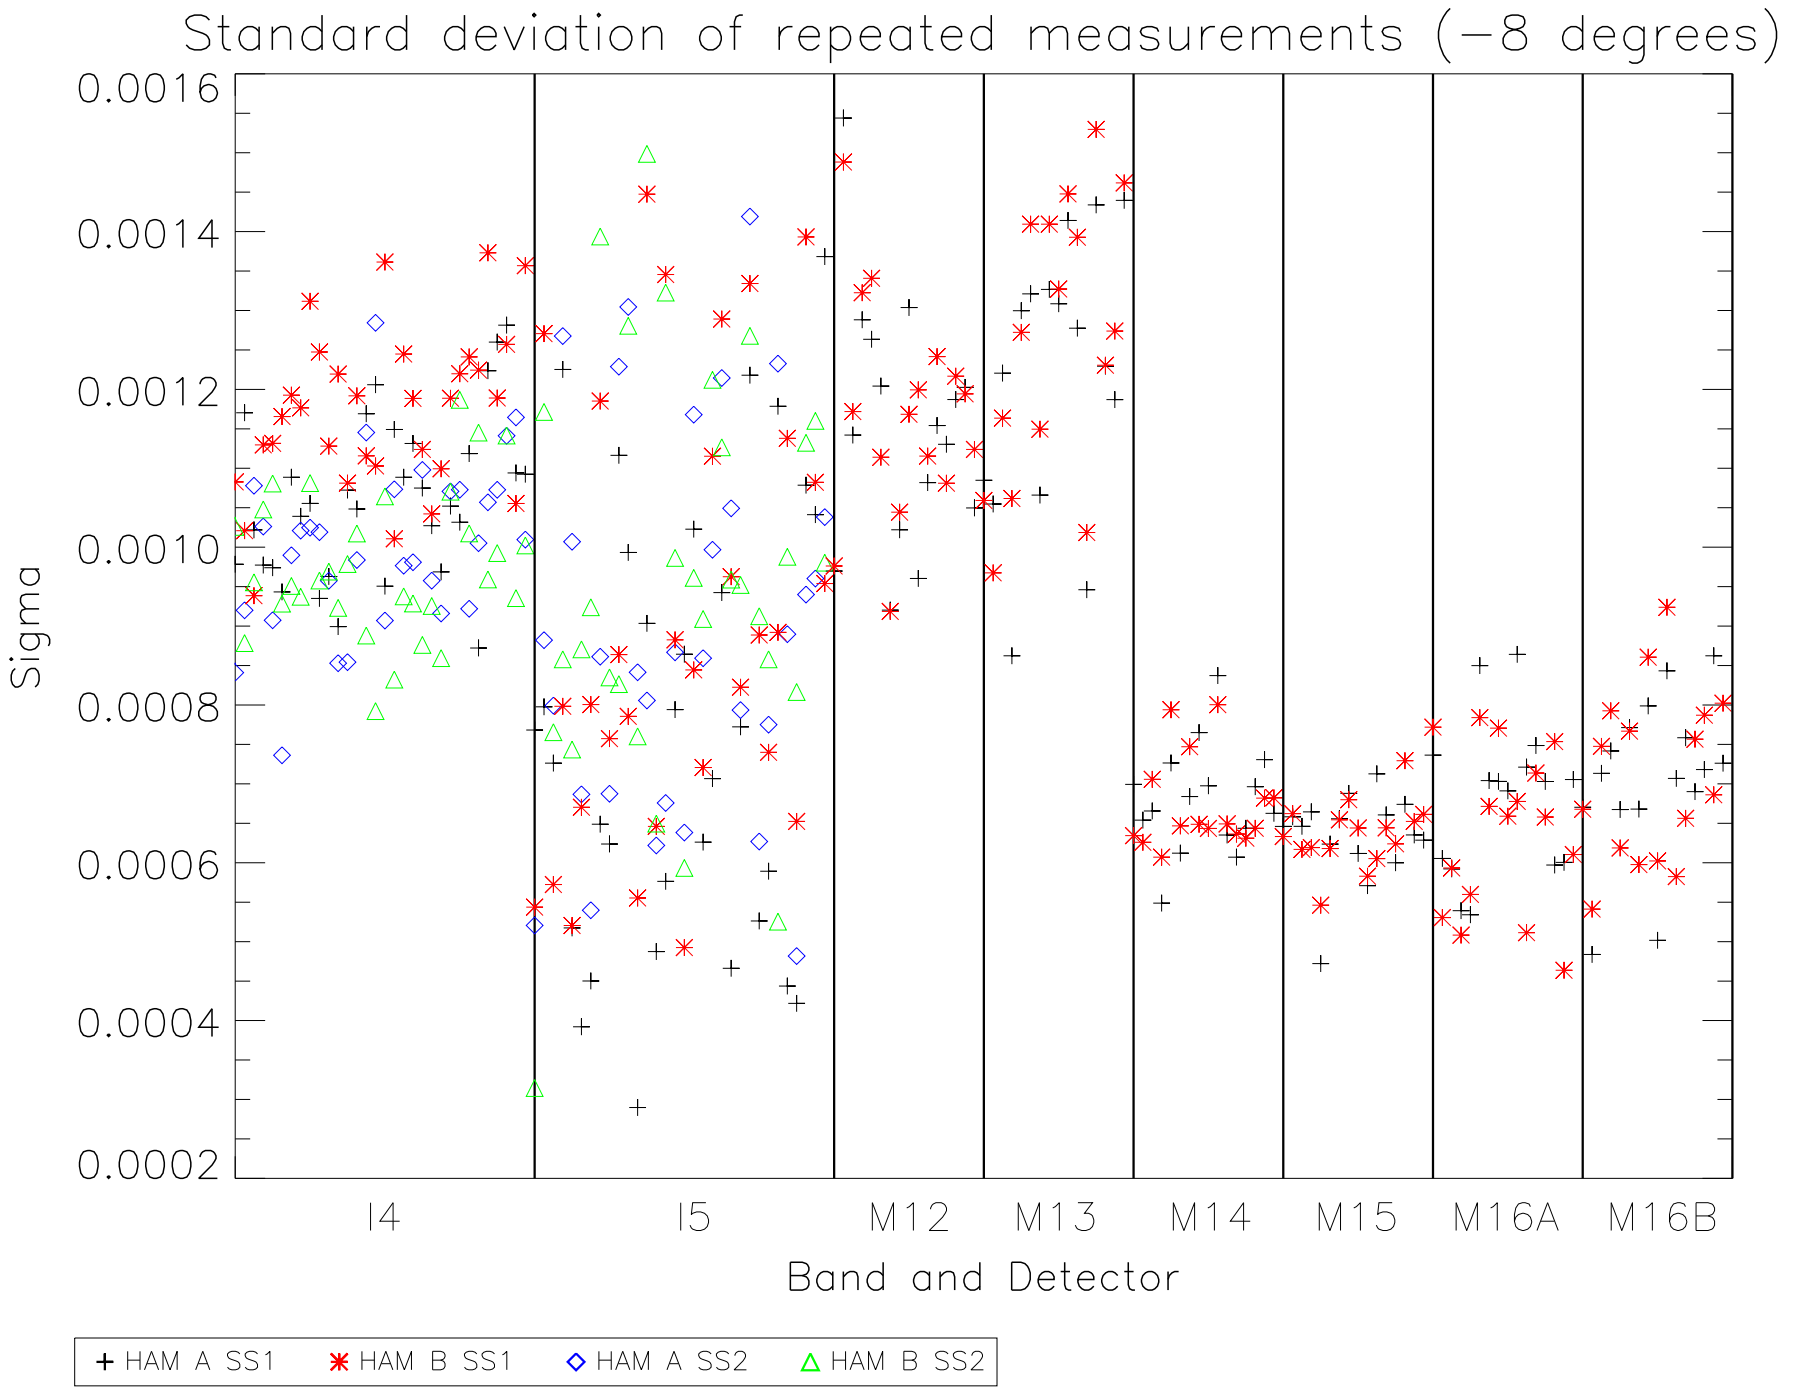
Standard deviation of repeated measurements (−8 degrees)
Sigma
0.0016
0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
I4
I5
M12
M13
M14
M15
M16A
M16B
Band and Detector
HAM A SS1
HAM B SS1
HAM A SS2
HAM B SS2