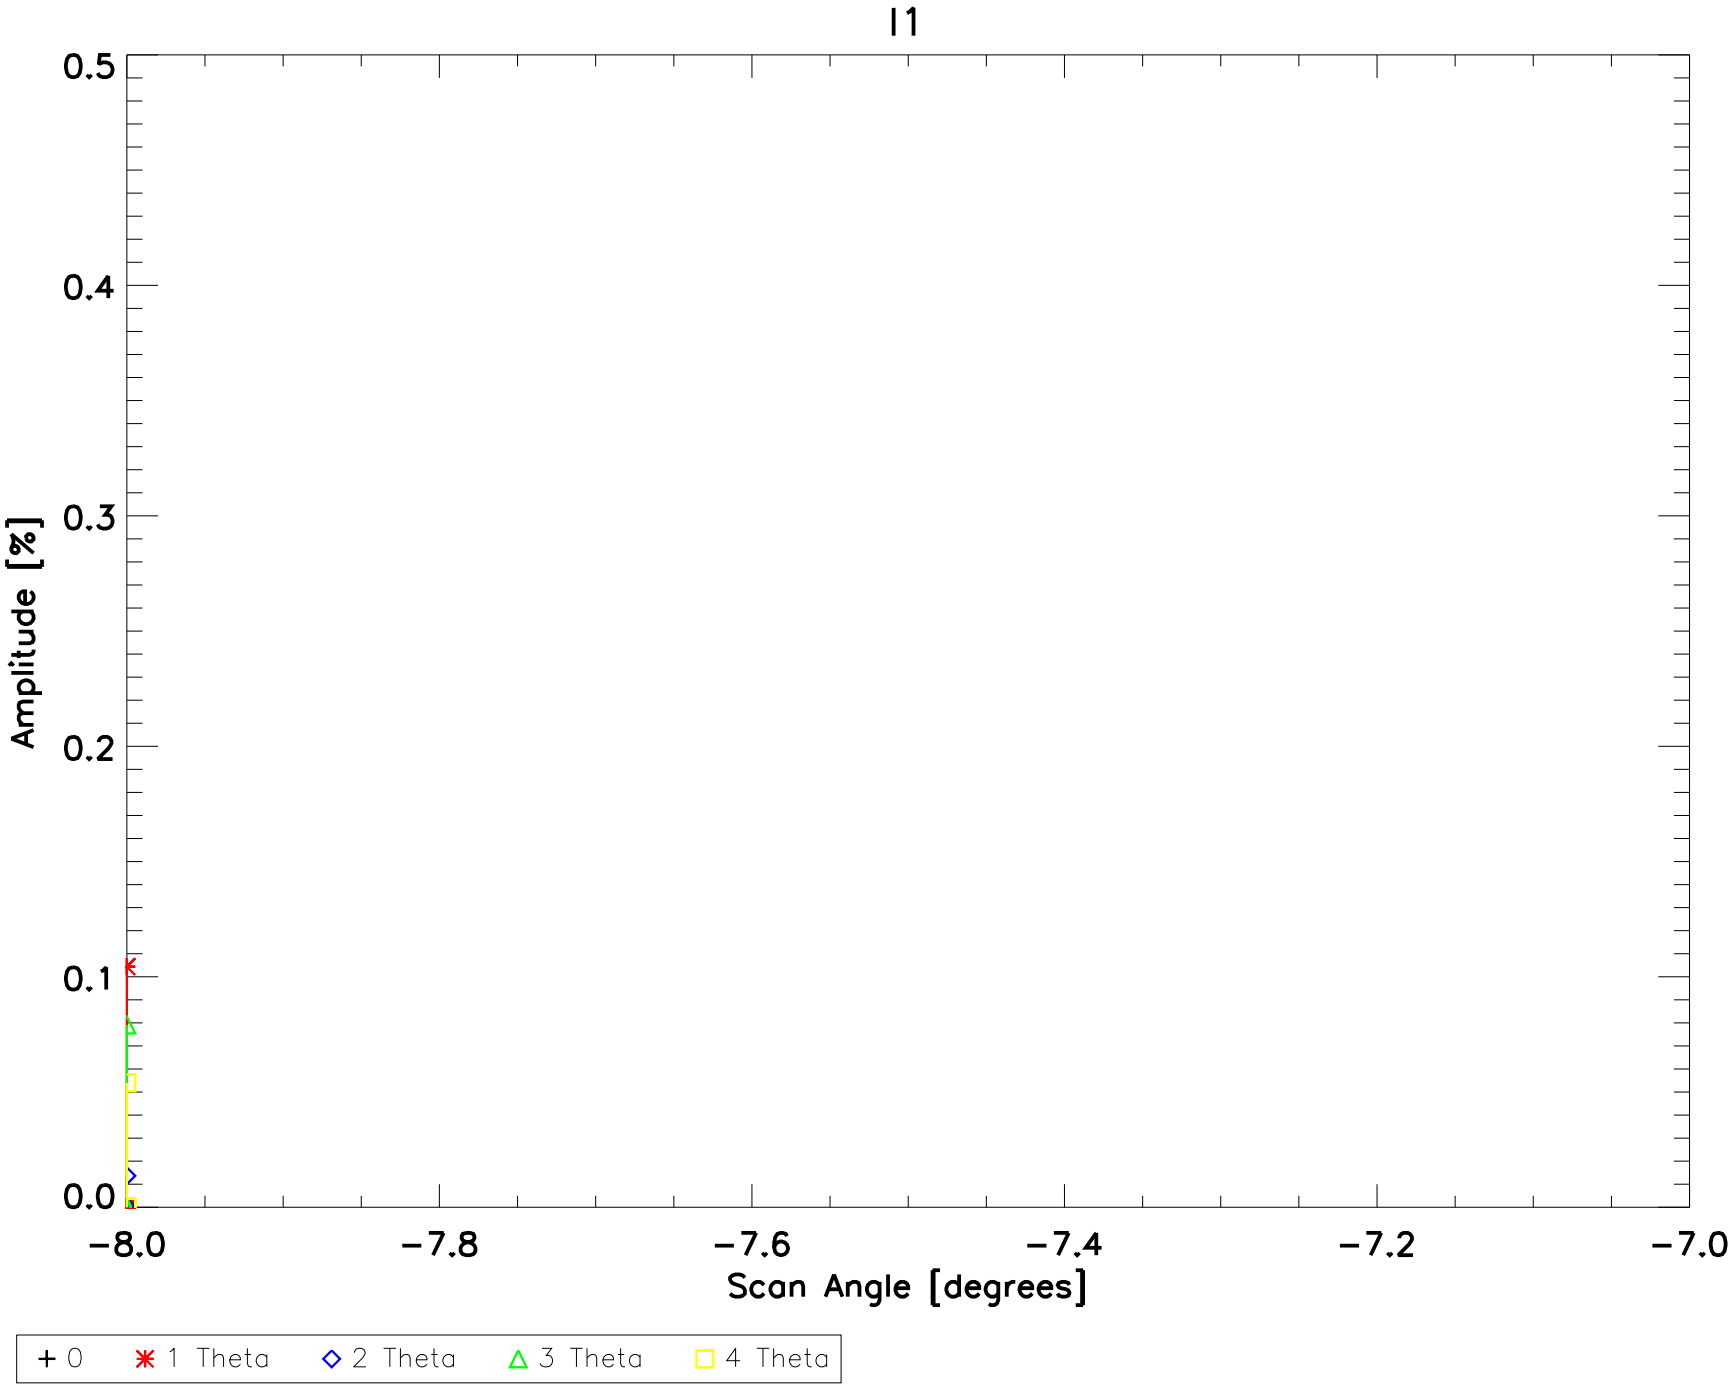
I1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Amplitude [%]
−8.0
−7.8
−7.6
−7.4
−7.2
−7.0
Scan Angle [degrees]
0
1 Theta
2 Theta
3 Theta
4 Theta

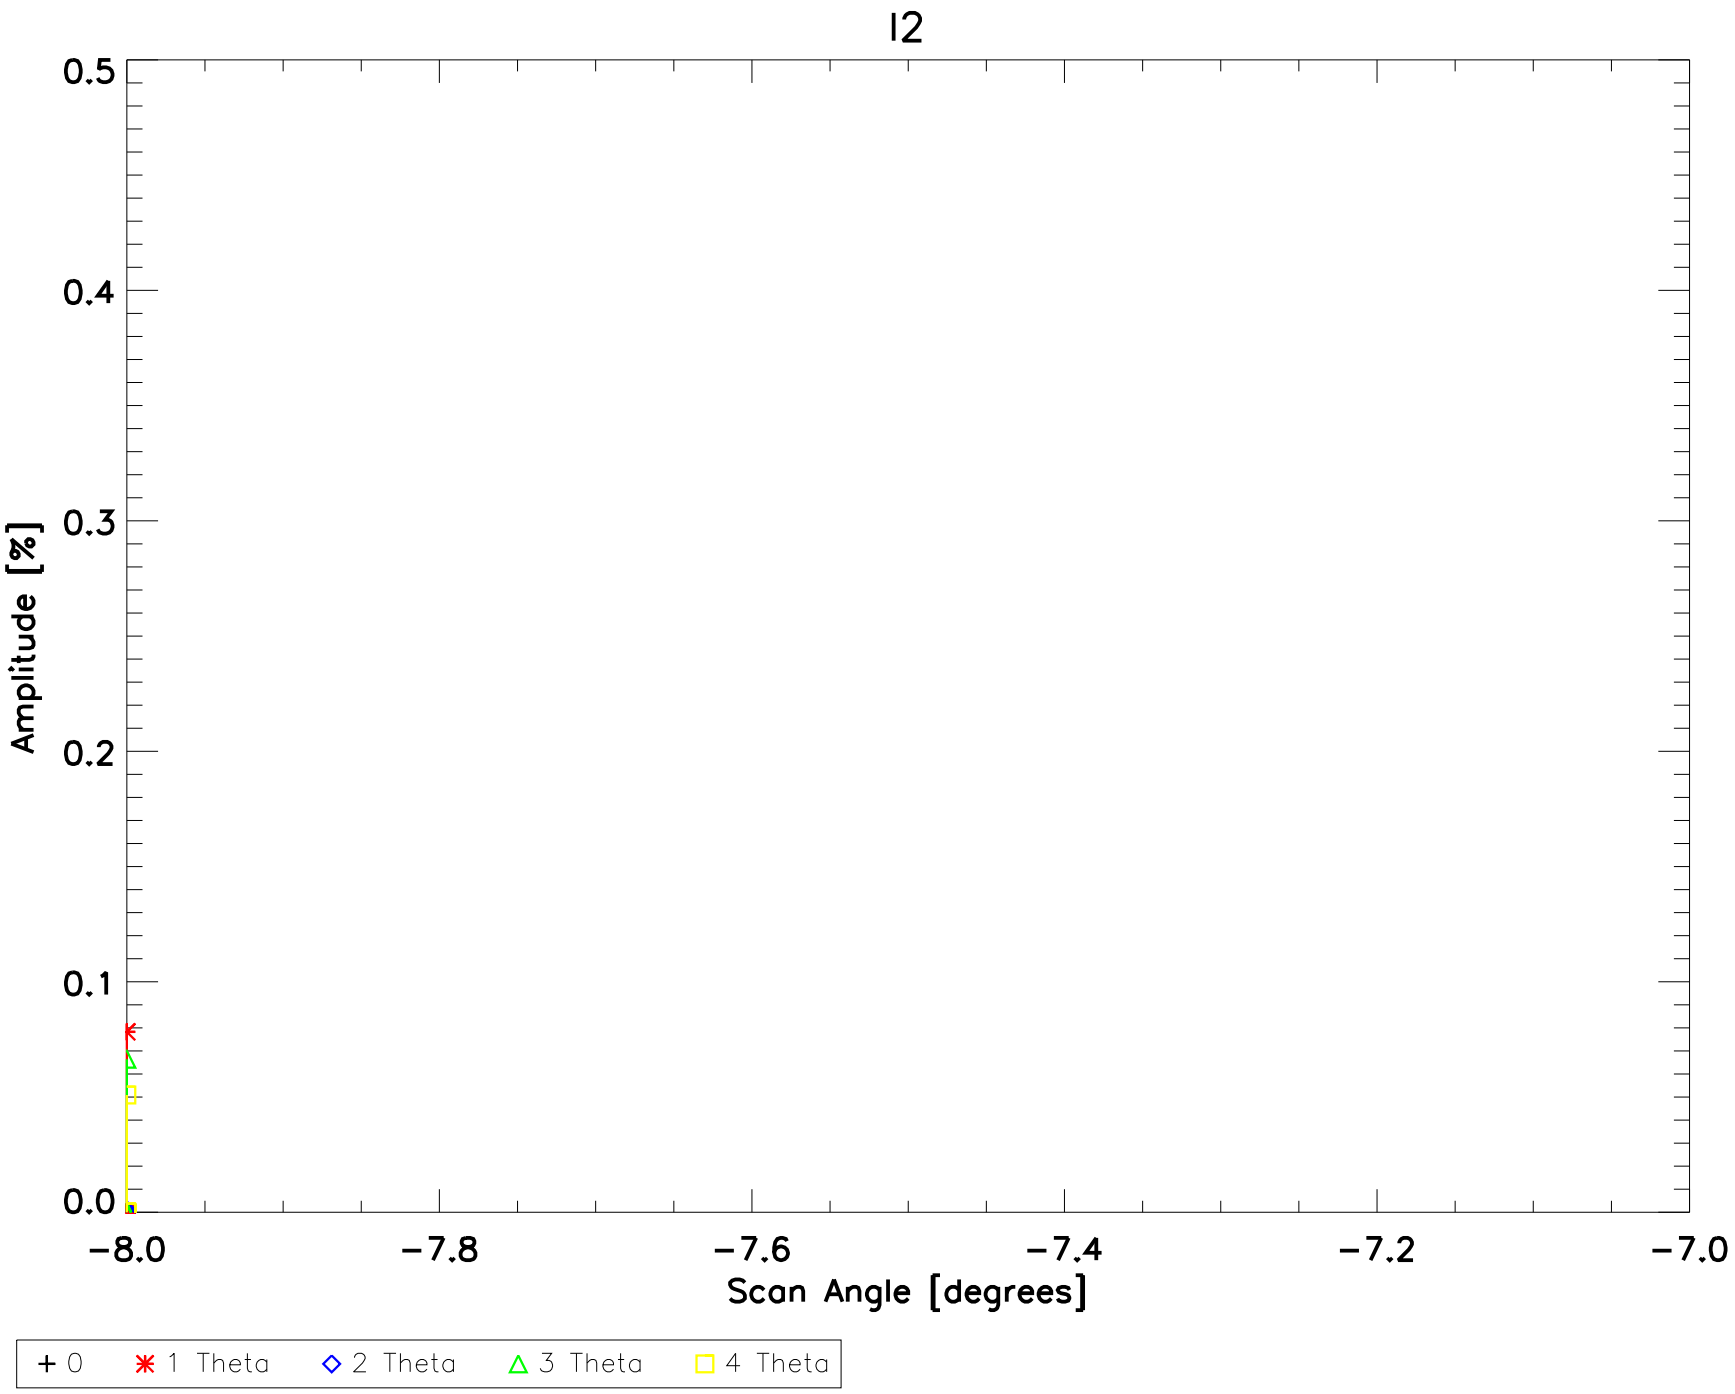
I2
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Amplitude [%]
−8.0
−7.8
−7.6
−7.4
−7.2
−7.0
Scan Angle [degrees]
0
1 Theta
2 Theta
3 Theta
4 Theta

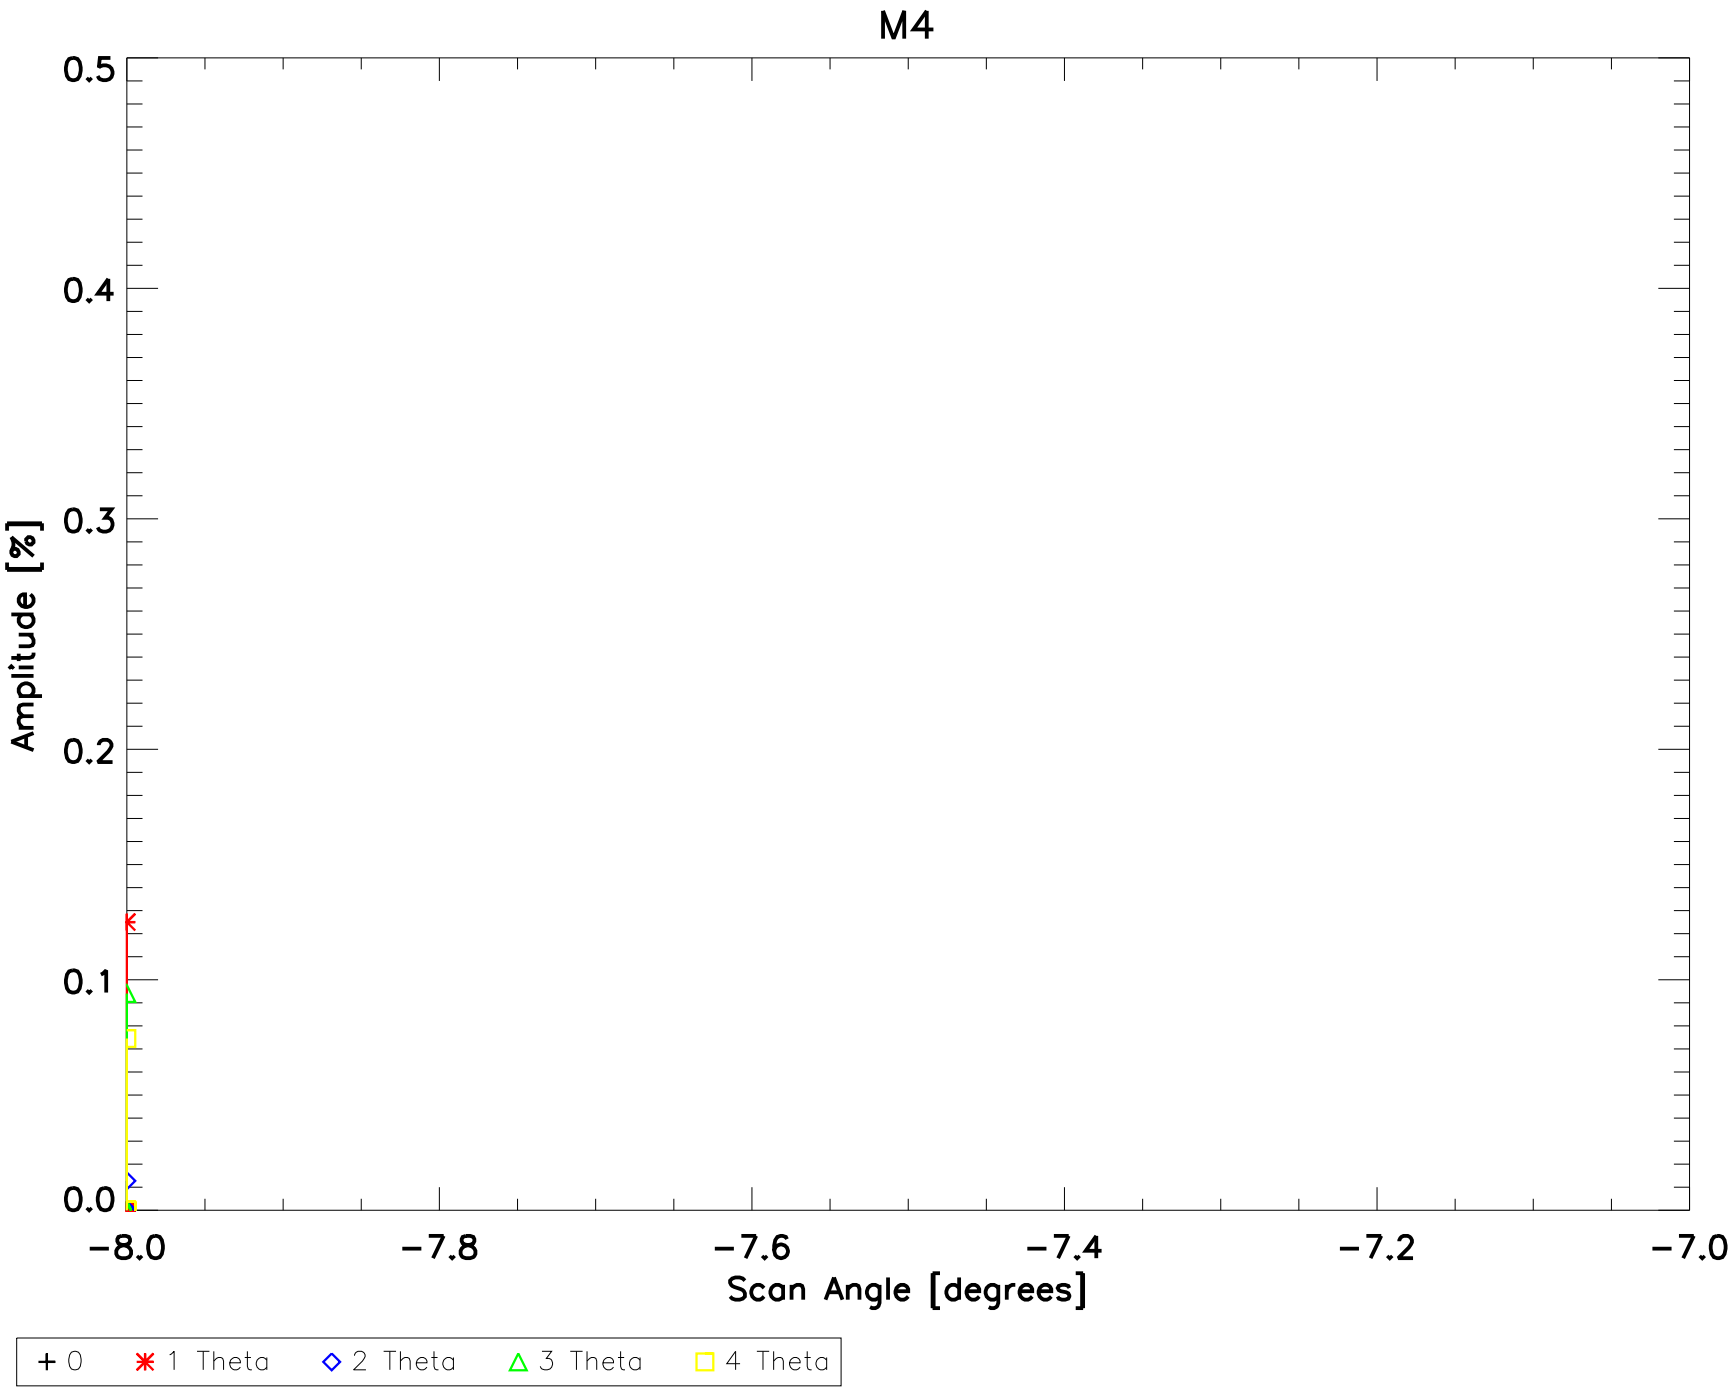
M4
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Amplitude [%]
−8.0
−7.8
−7.6
−7.4
−7.2
−7.0
Scan Angle [degrees]
0
1 Theta
2 Theta
3 Theta
4 Theta

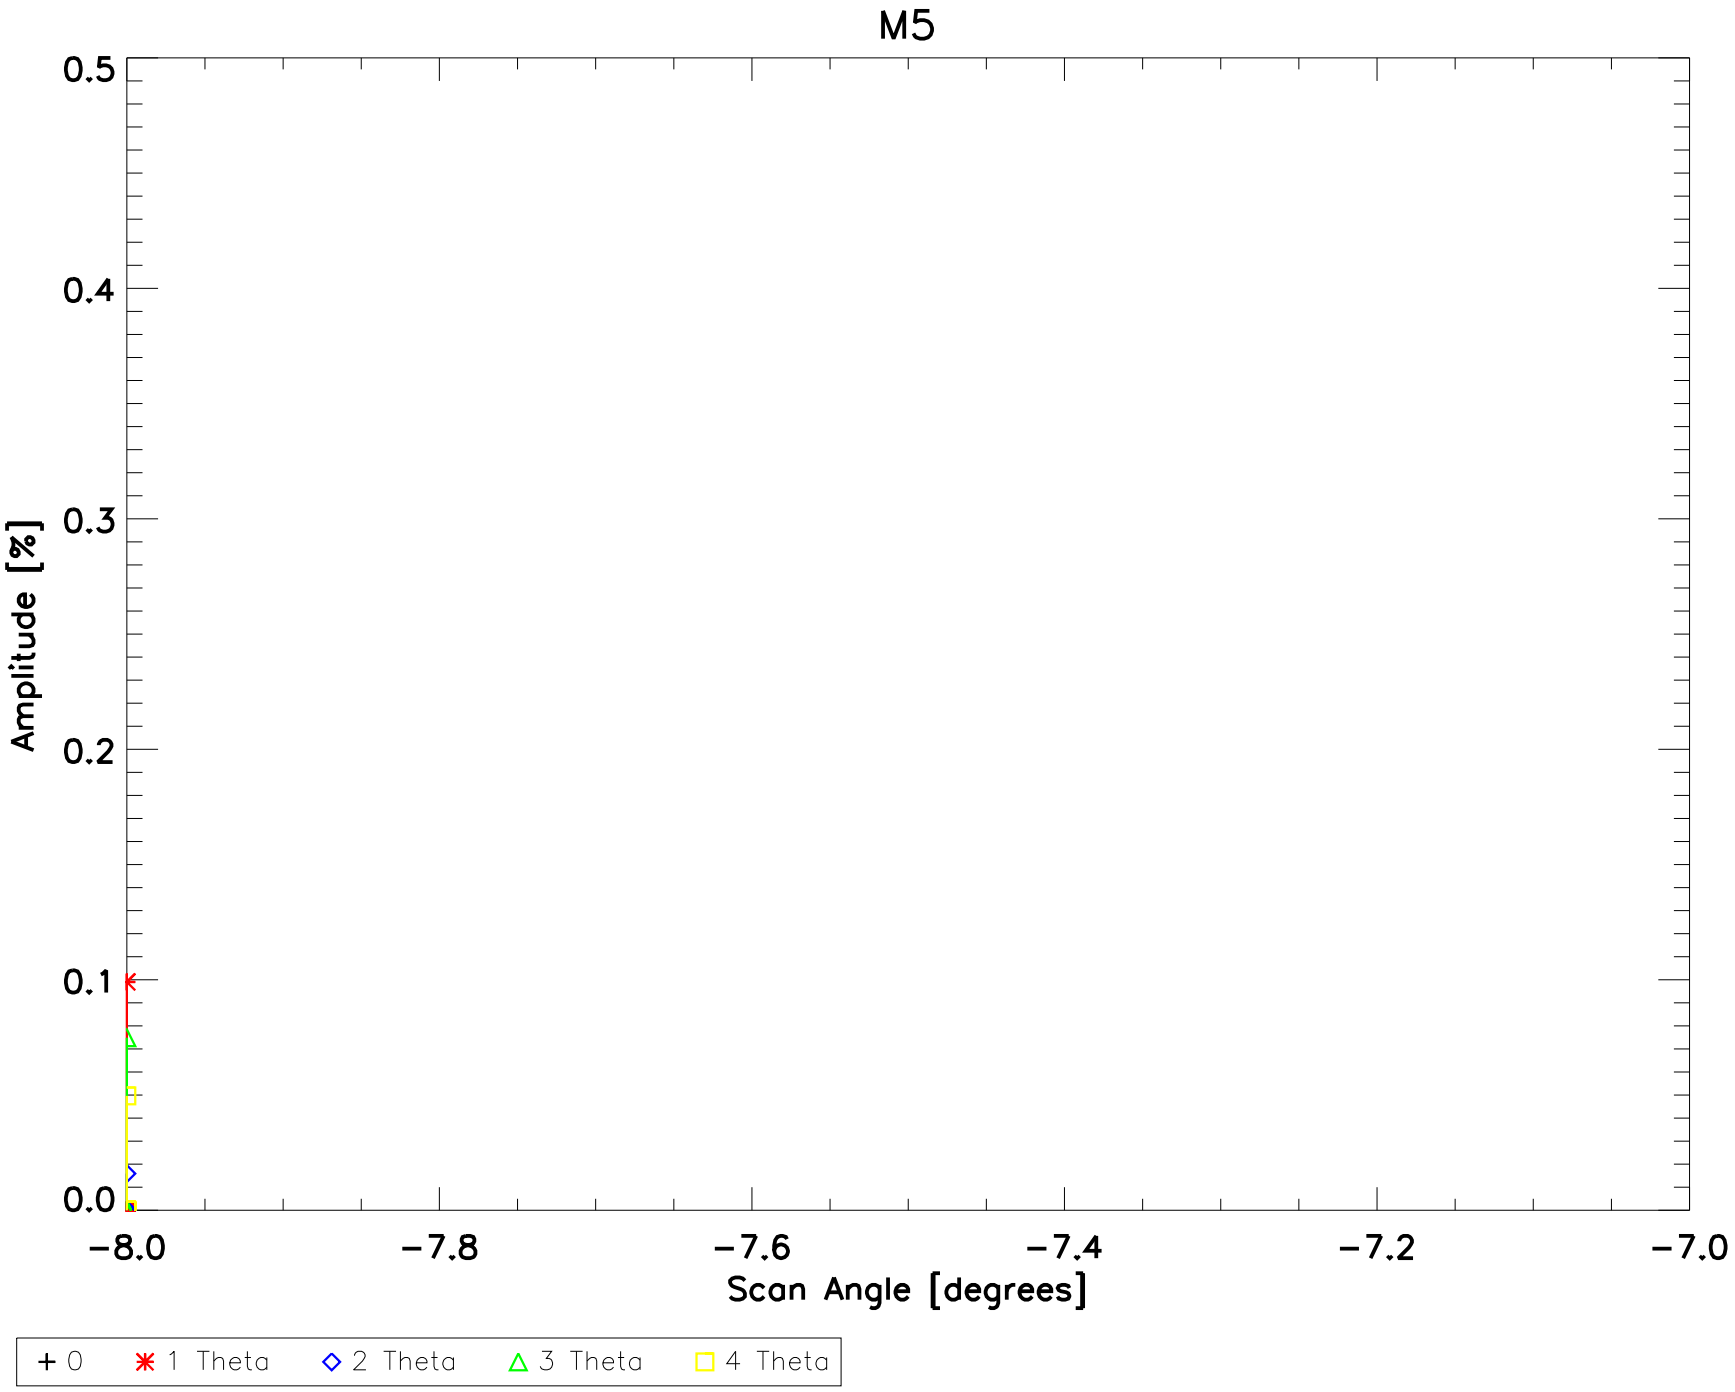
M5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Amplitude [%]
−8.0
−7.8
−7.6
−7.4
−7.2
−7.0
Scan Angle [degrees]
0
1 Theta
2 Theta
3 Theta
4 Theta

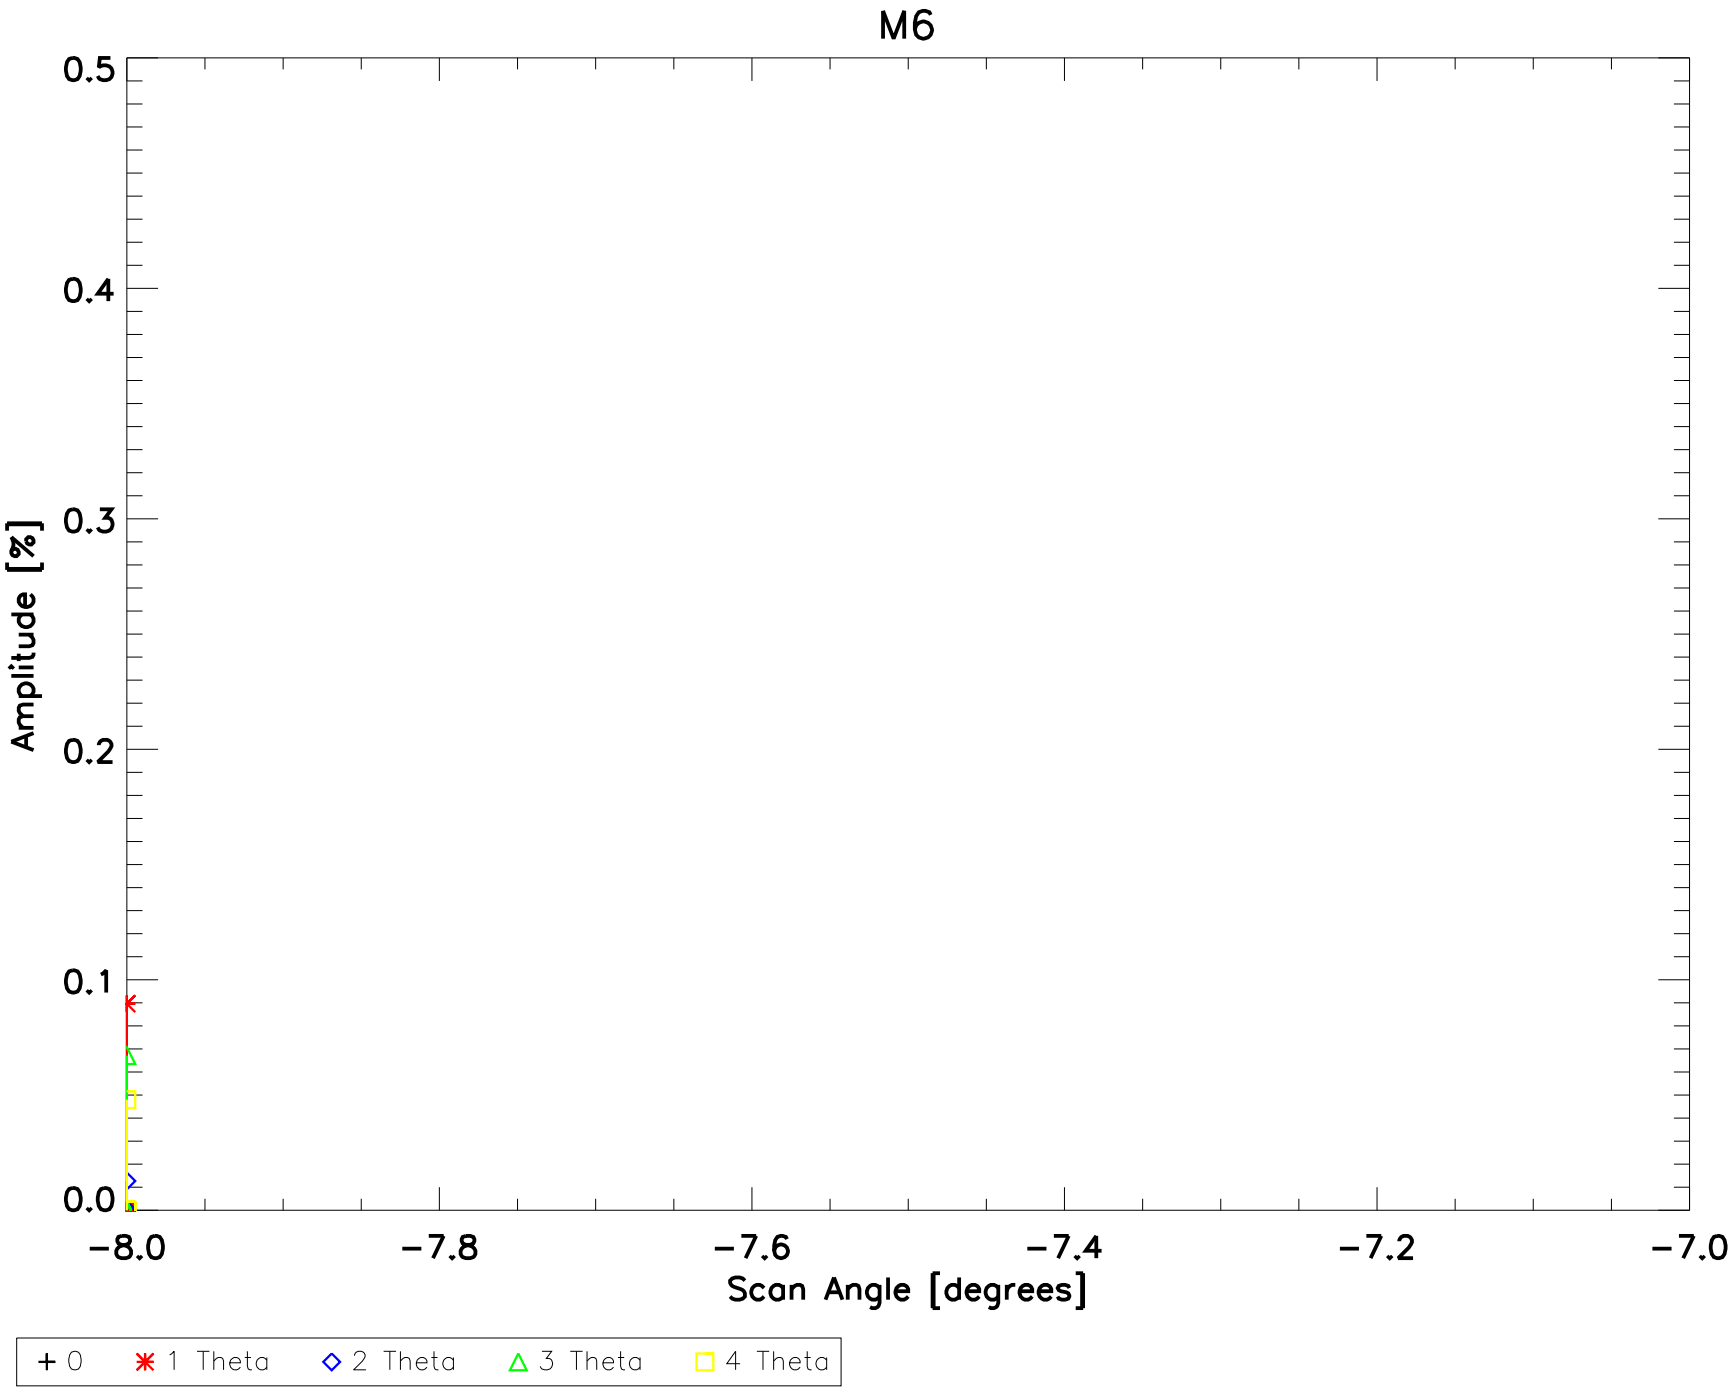
M6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Amplitude [%]
−8.0
−7.8
−7.6
−7.4
−7.2
−7.0
Scan Angle [degrees]
0
1 Theta
2 Theta
3 Theta
4 Theta

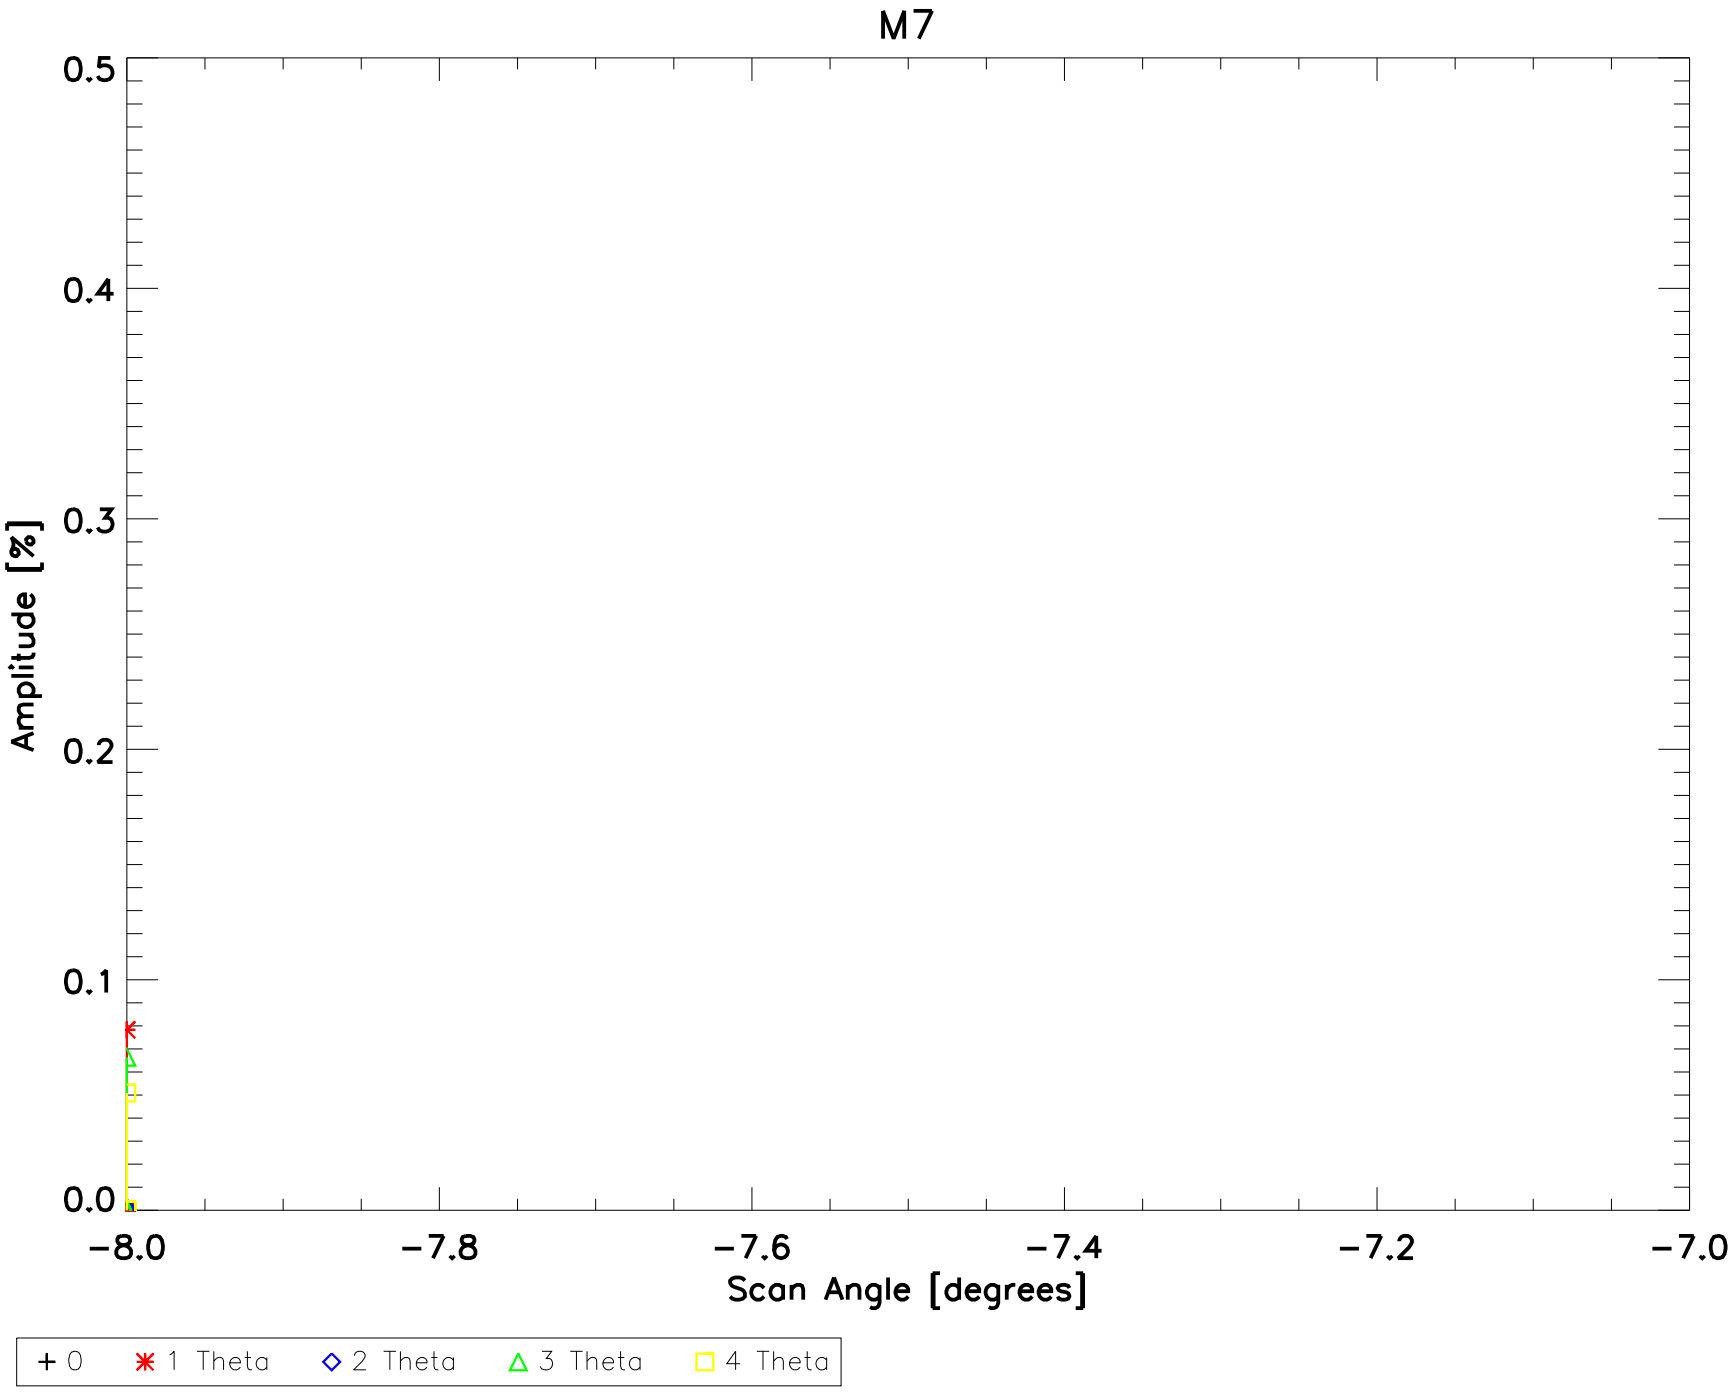
M7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Amplitude [%]
−8.0
−7.8
−7.6
−7.4
−7.2
−7.0
Scan Angle [degrees]
0
1 Theta
2 Theta
3 Theta
4 Theta

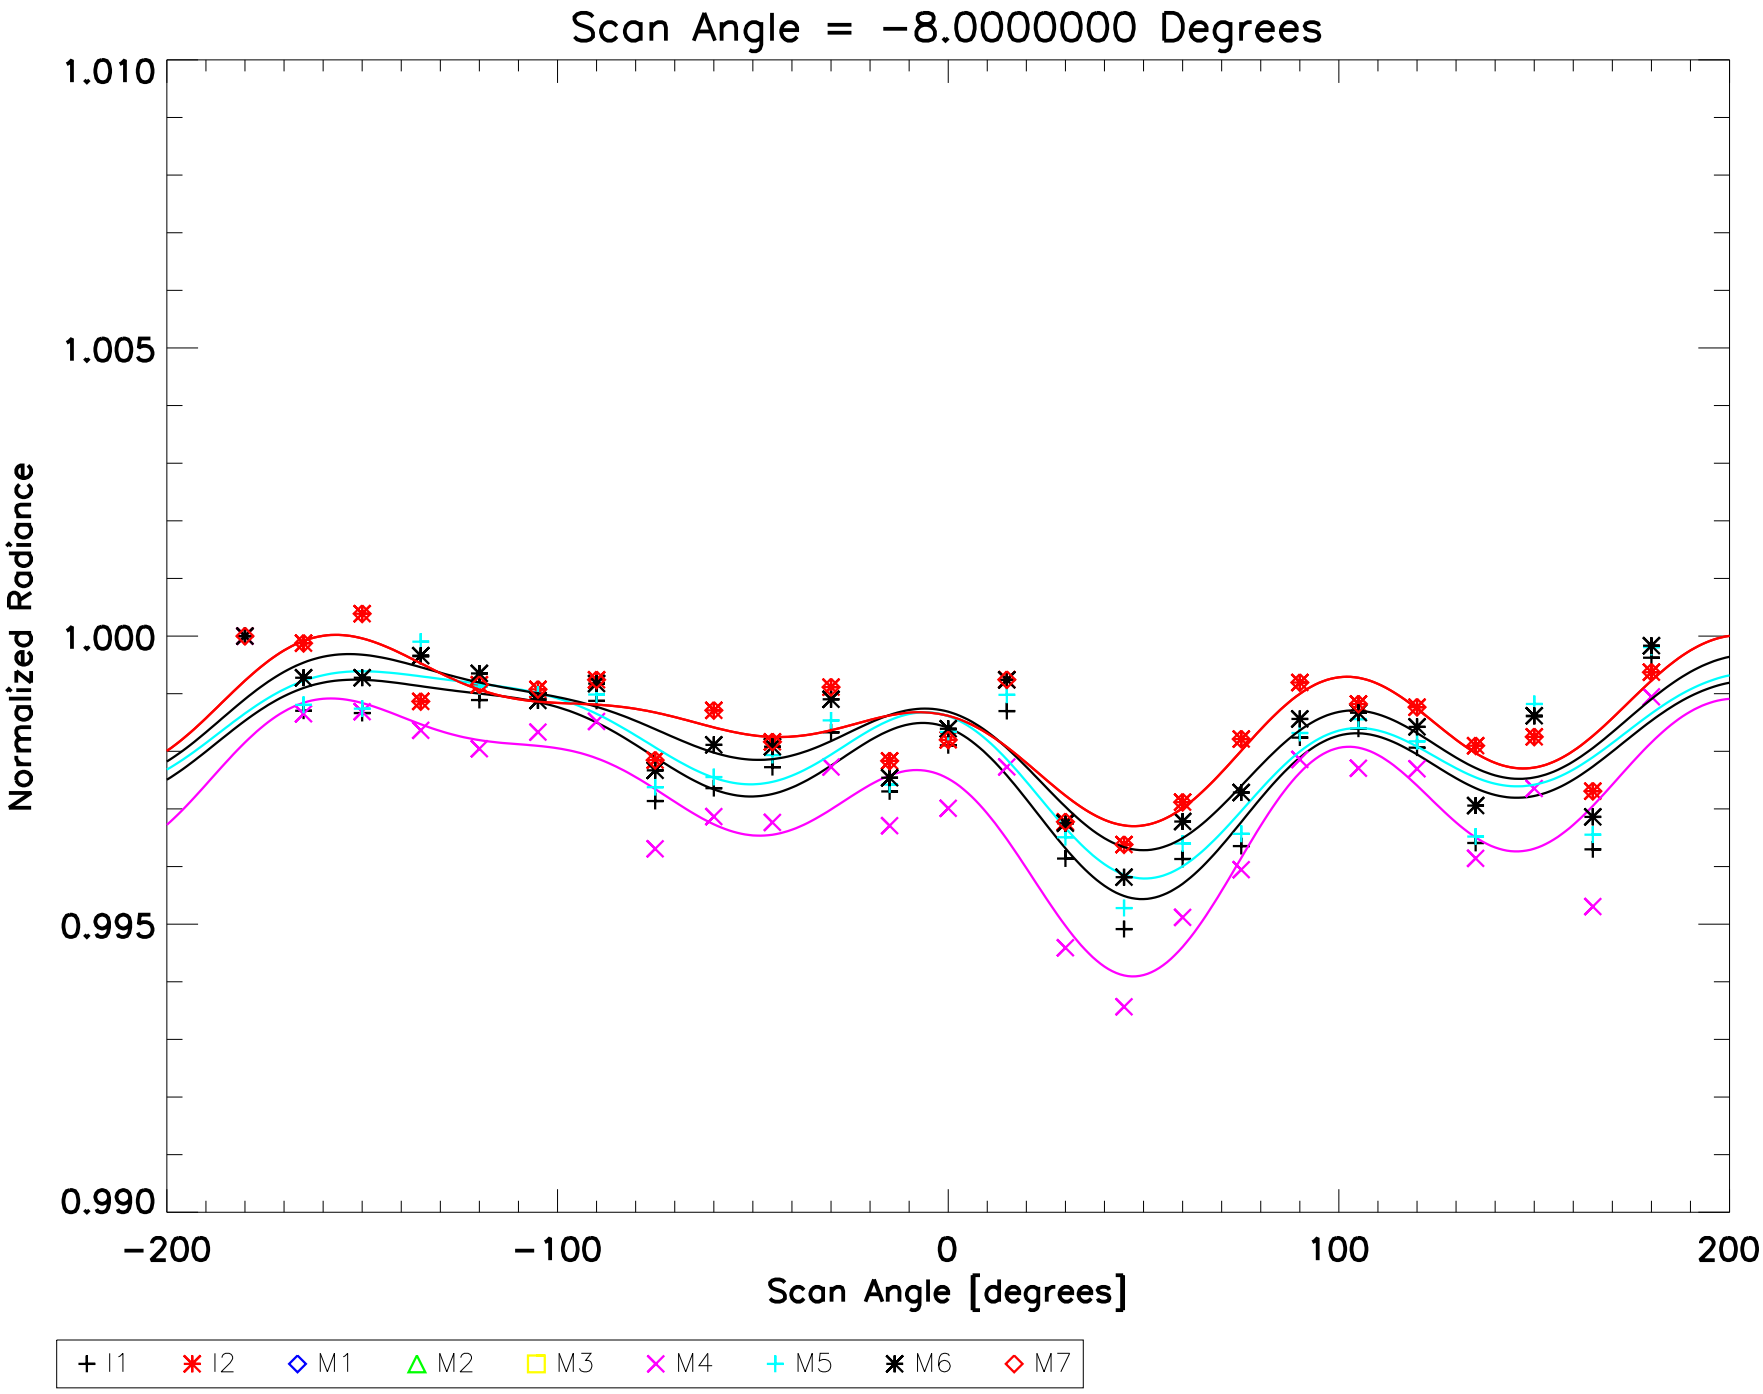
Scan Angle = −8.0000000 Degrees
1.010
1.005
1.000
0.995
0.990
Normalized Radiance
−200
−100
0
100
200
Scan Angle [degrees]
I1
I2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7