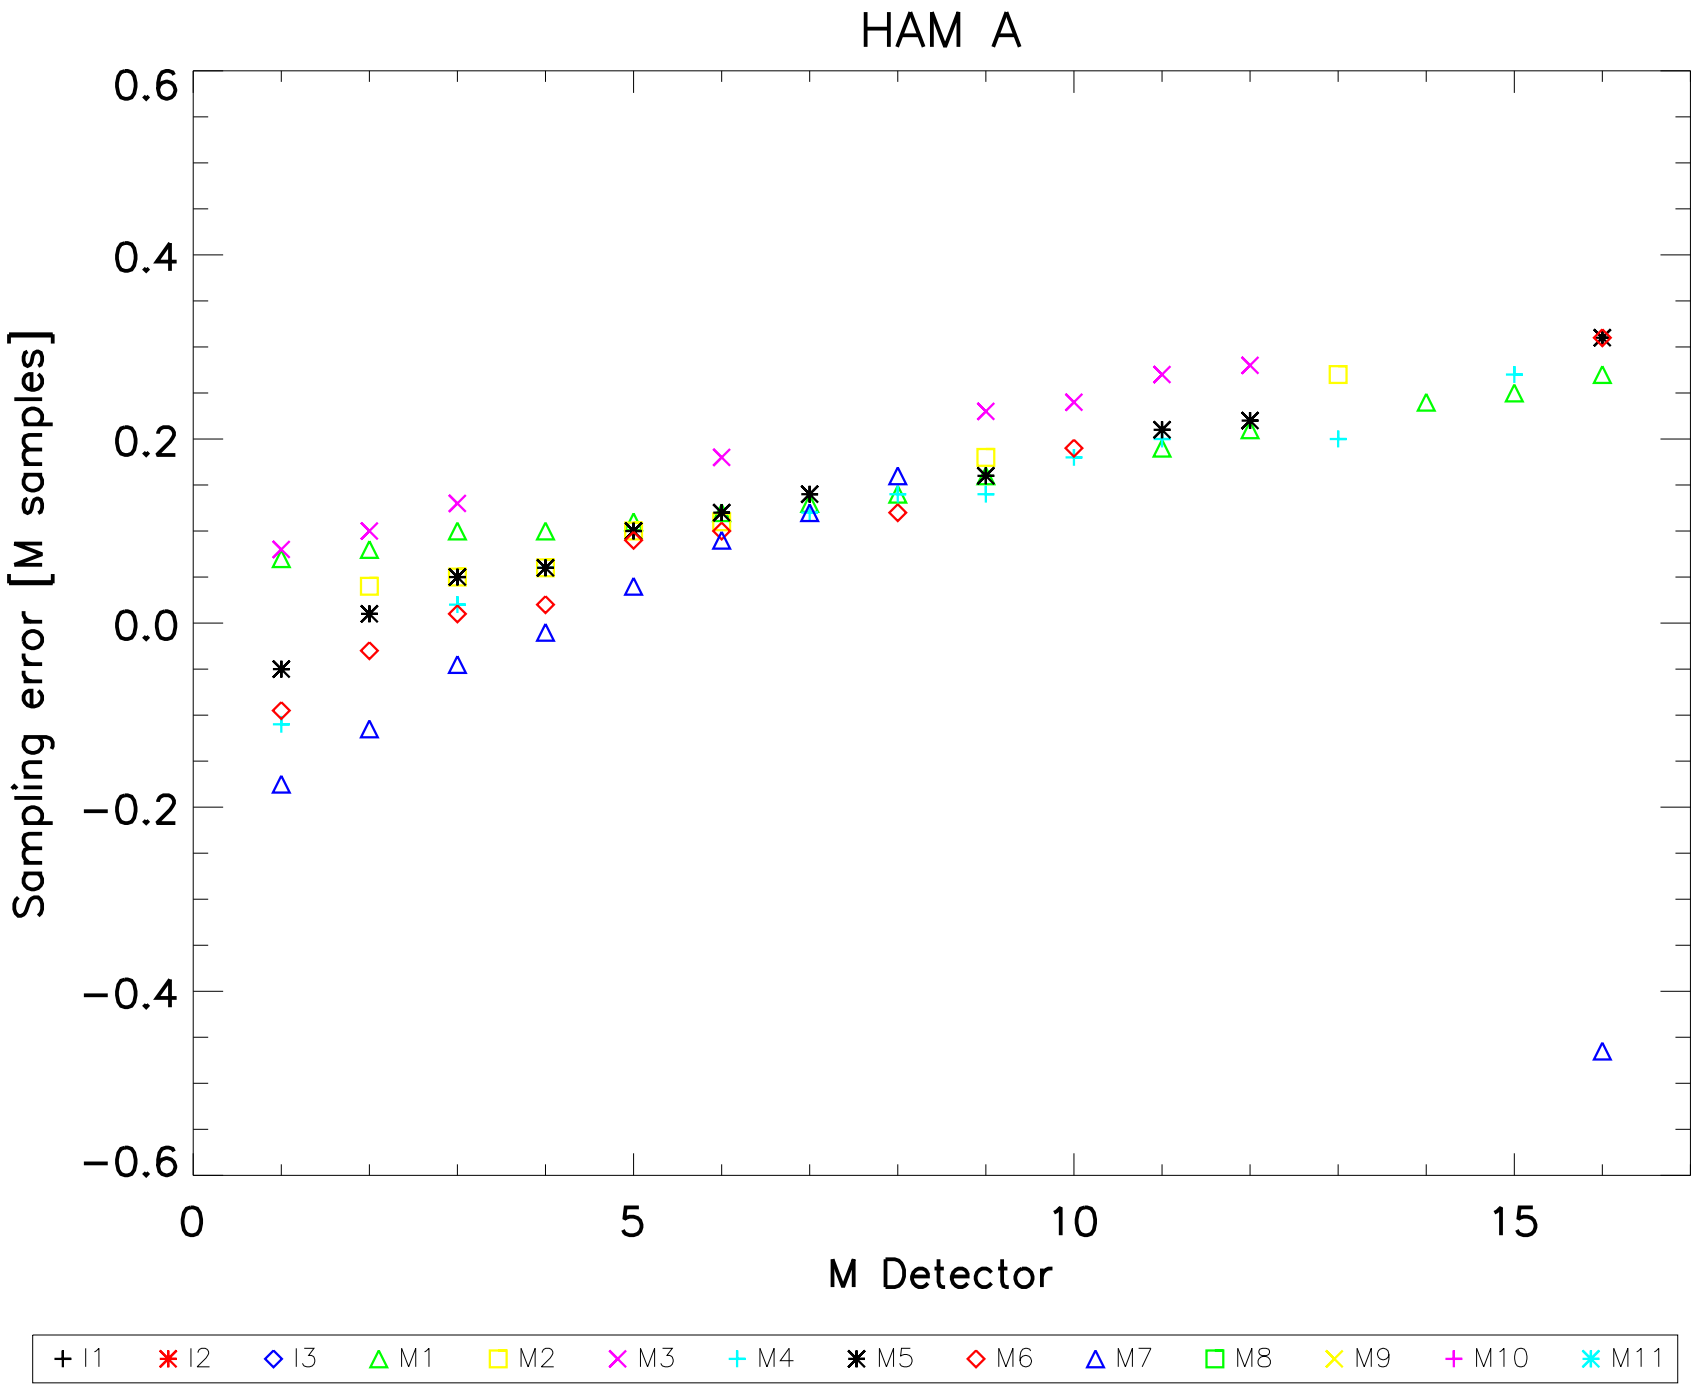
HAM A
Sampling error [M samples]
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
5
10
15
M Detector
I1
I2
I3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

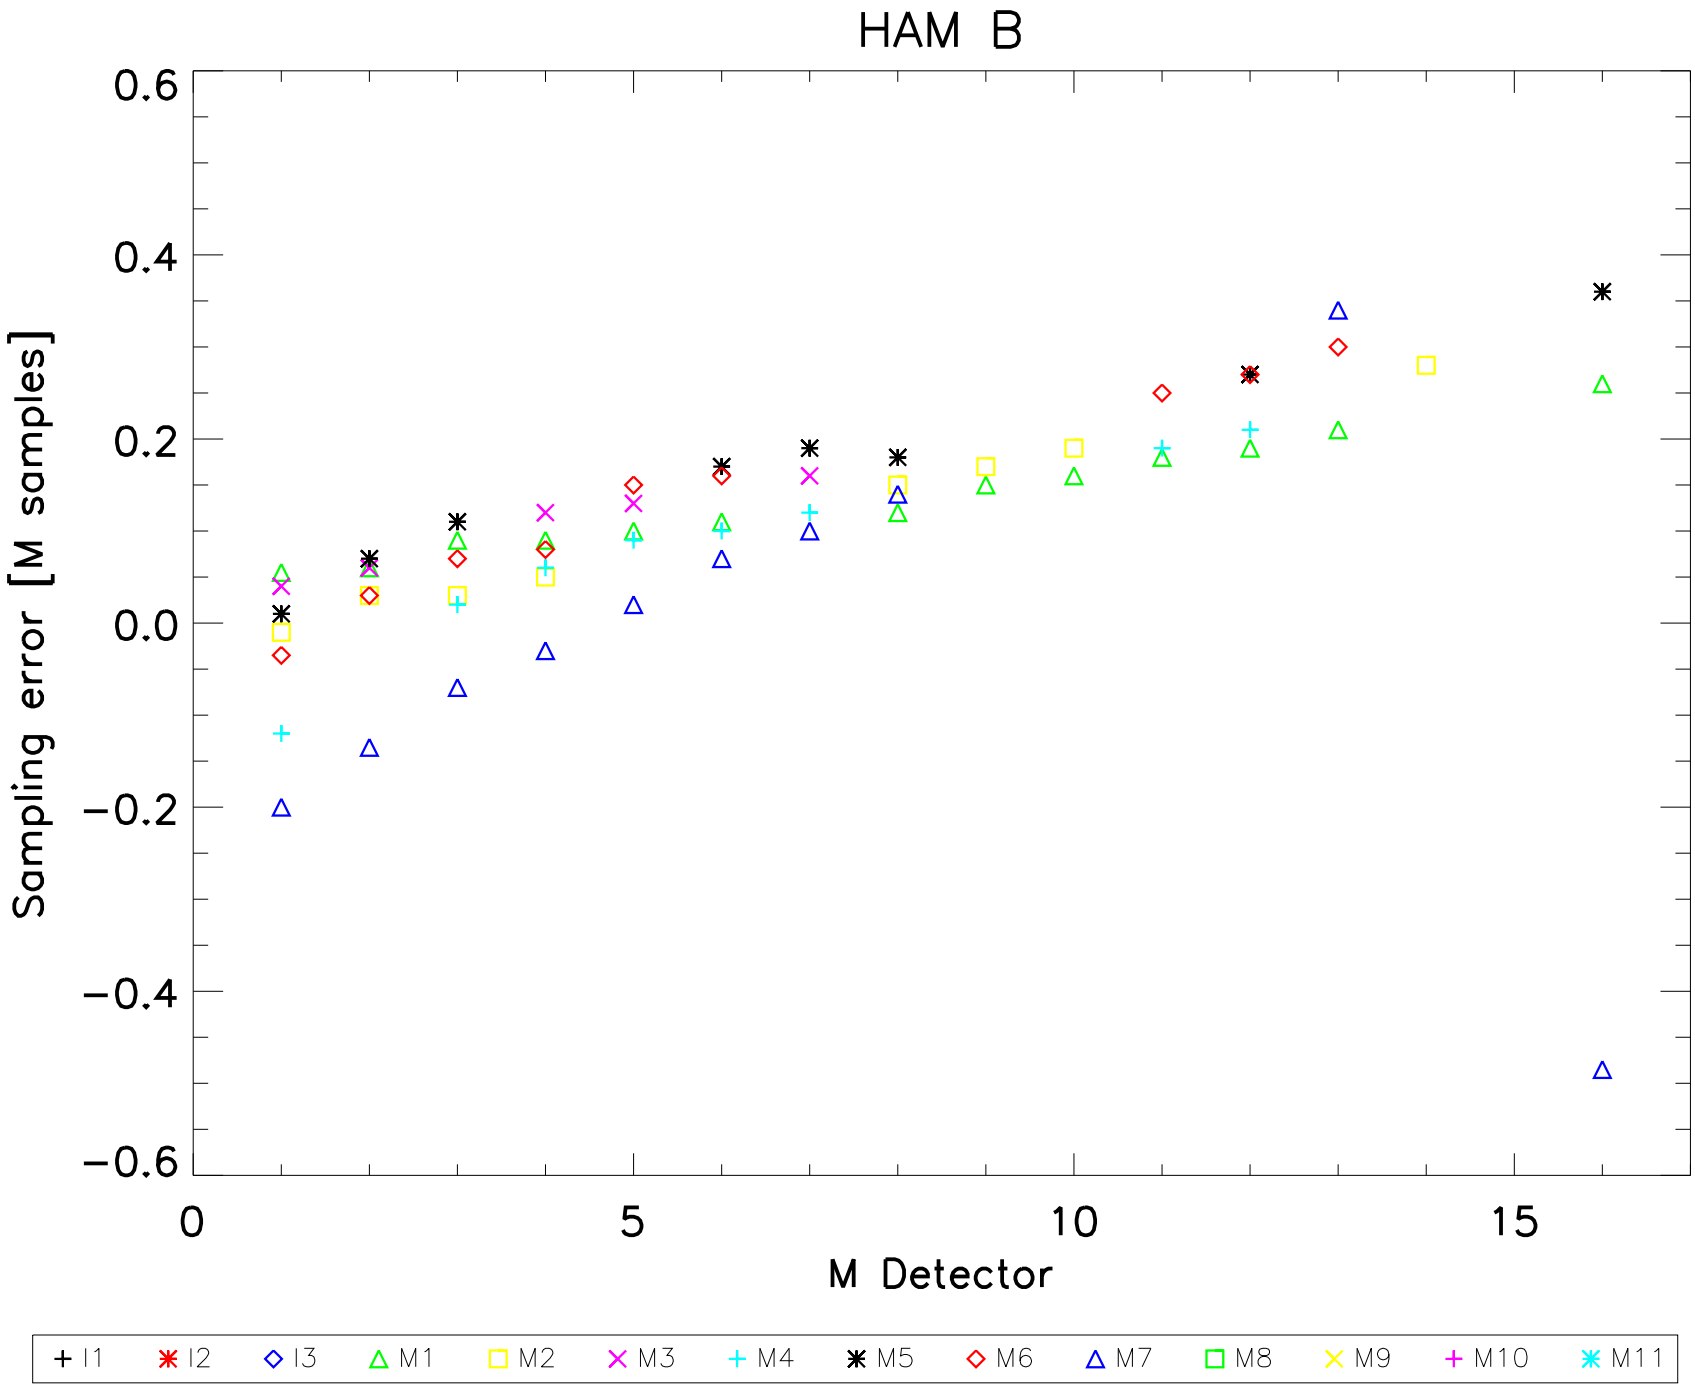
HAM B
Sampling error [M samples]
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
5
10
15
M Detector
I1
I2
I3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

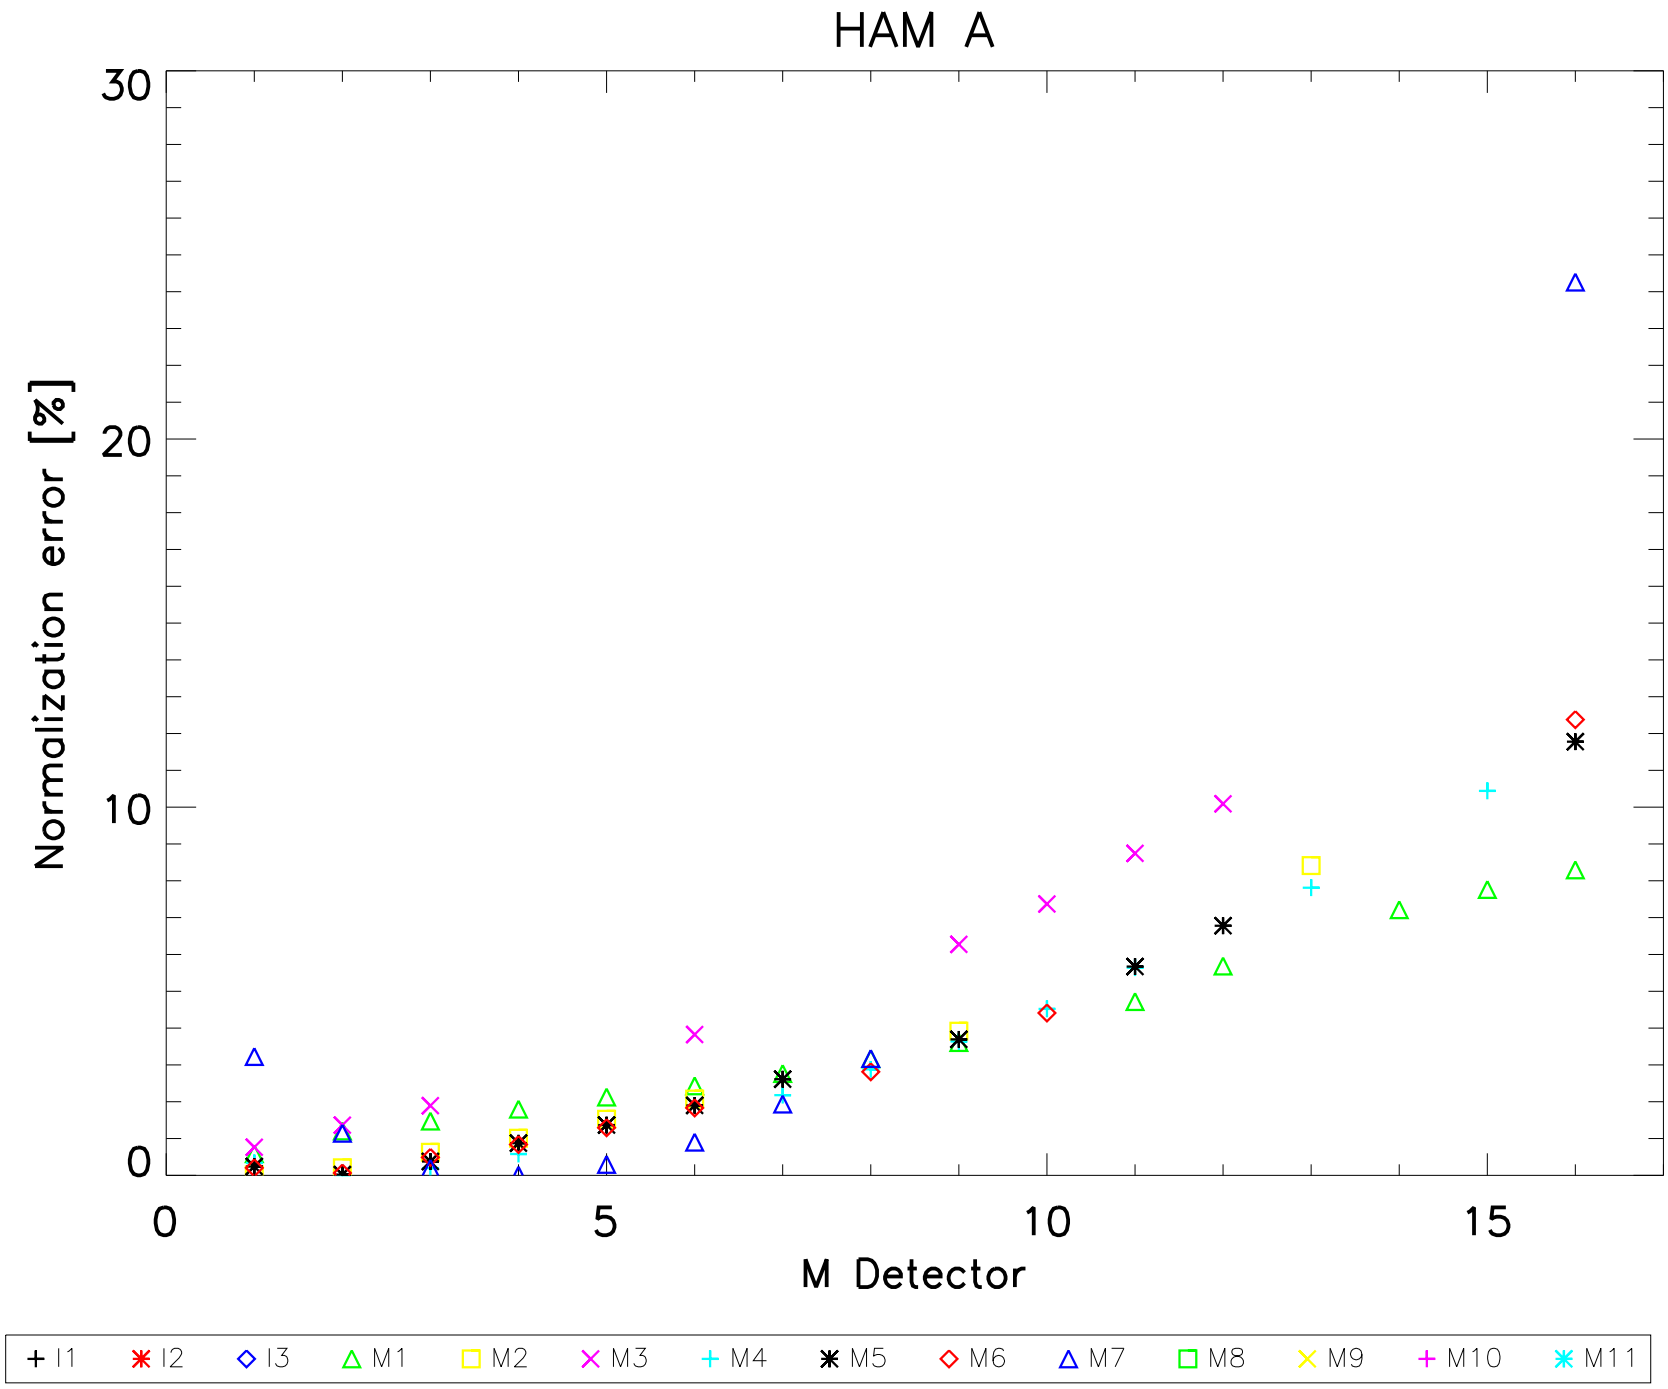
HAM A
Normalization error [%]
30
20
10
0
0
5
10
15
M Detector
I1
I2
I3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

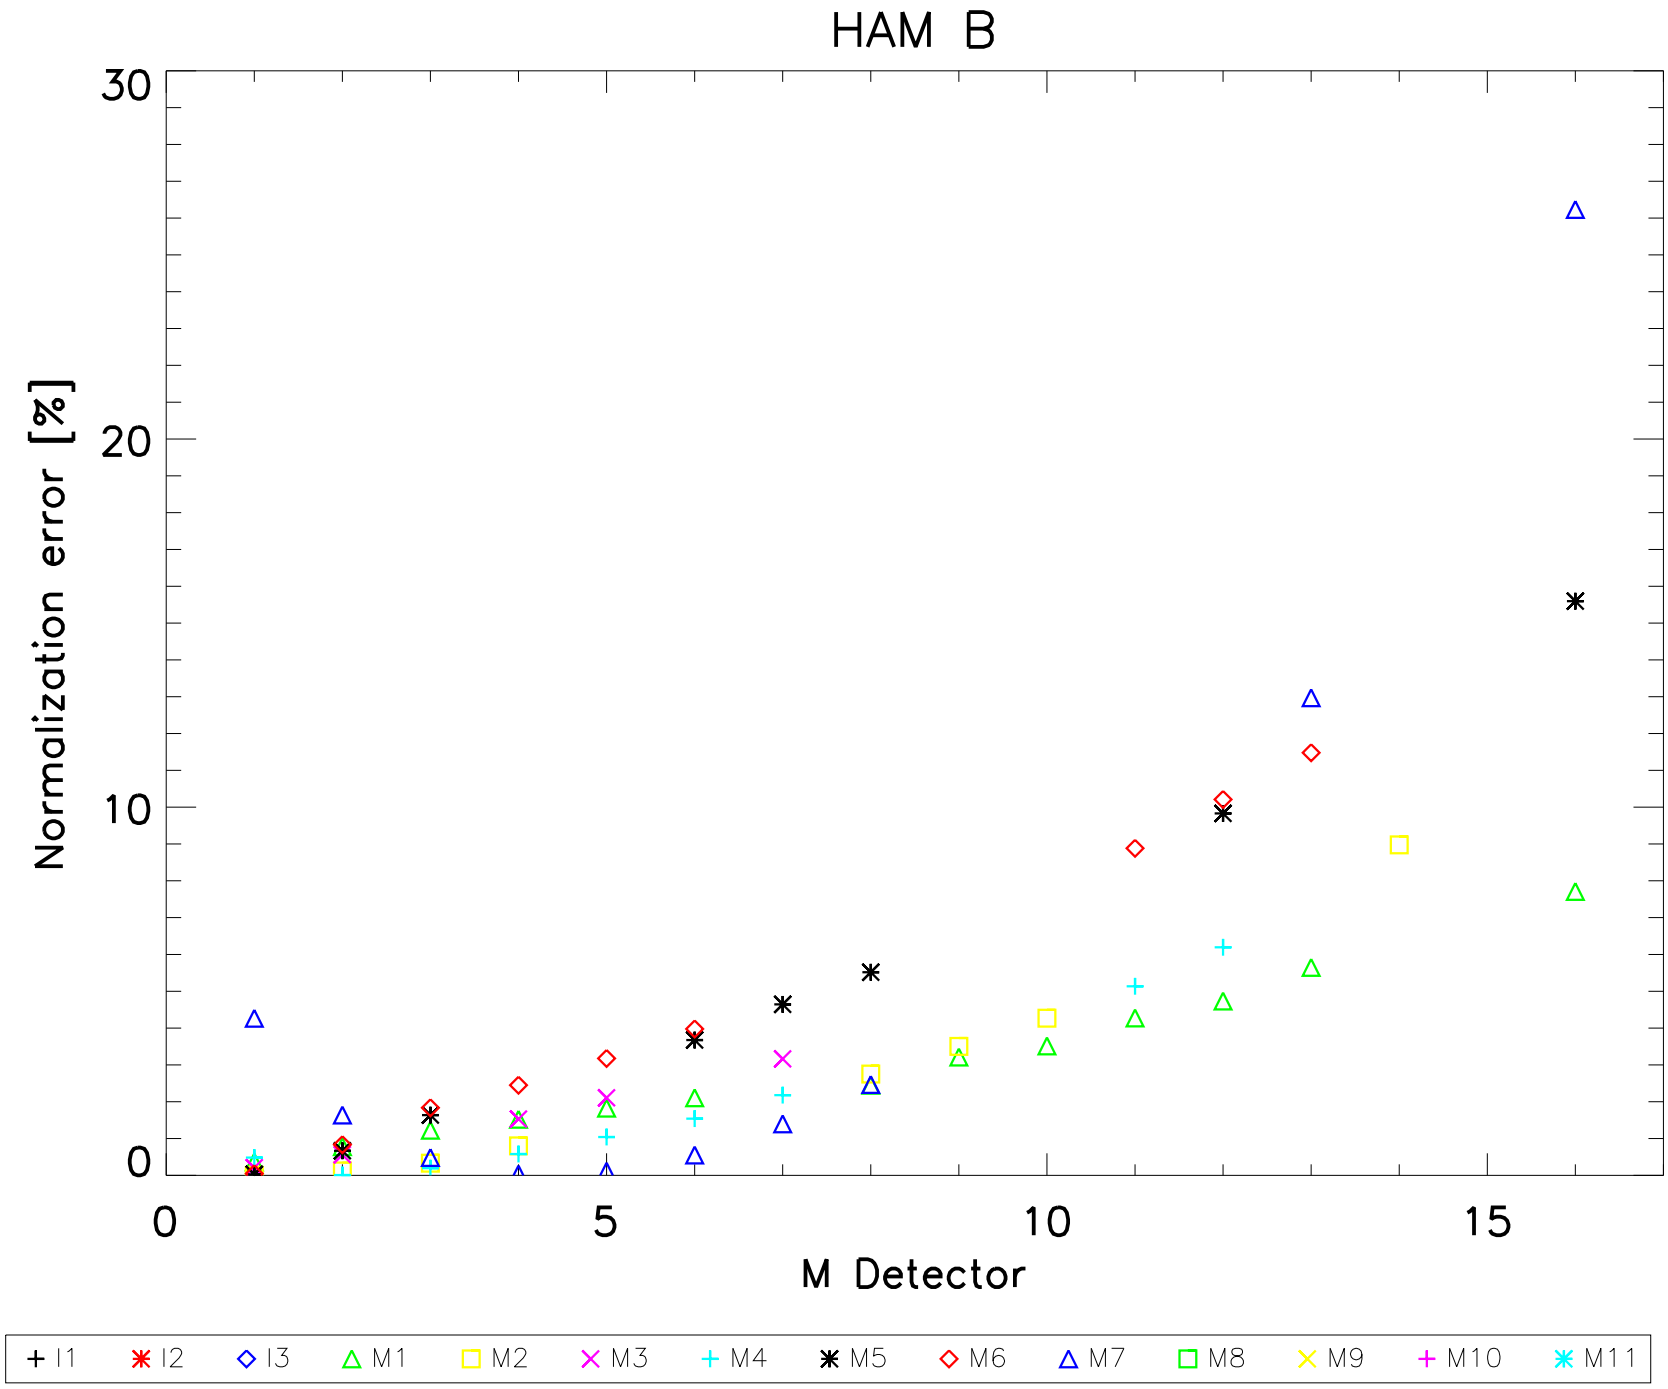
HAM B
Normalization error [%]
30
20
10
0
0
5
10
15
M Detector
I1
I2
I3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11